

監控點圖表


監控點: 602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(下)

時間區間: 2023-02-01 00:00 ~ 2023-02-28 23:59

最大值: 5.6 °C

最小值: 3.9 °C

平均值: 4.6 °C

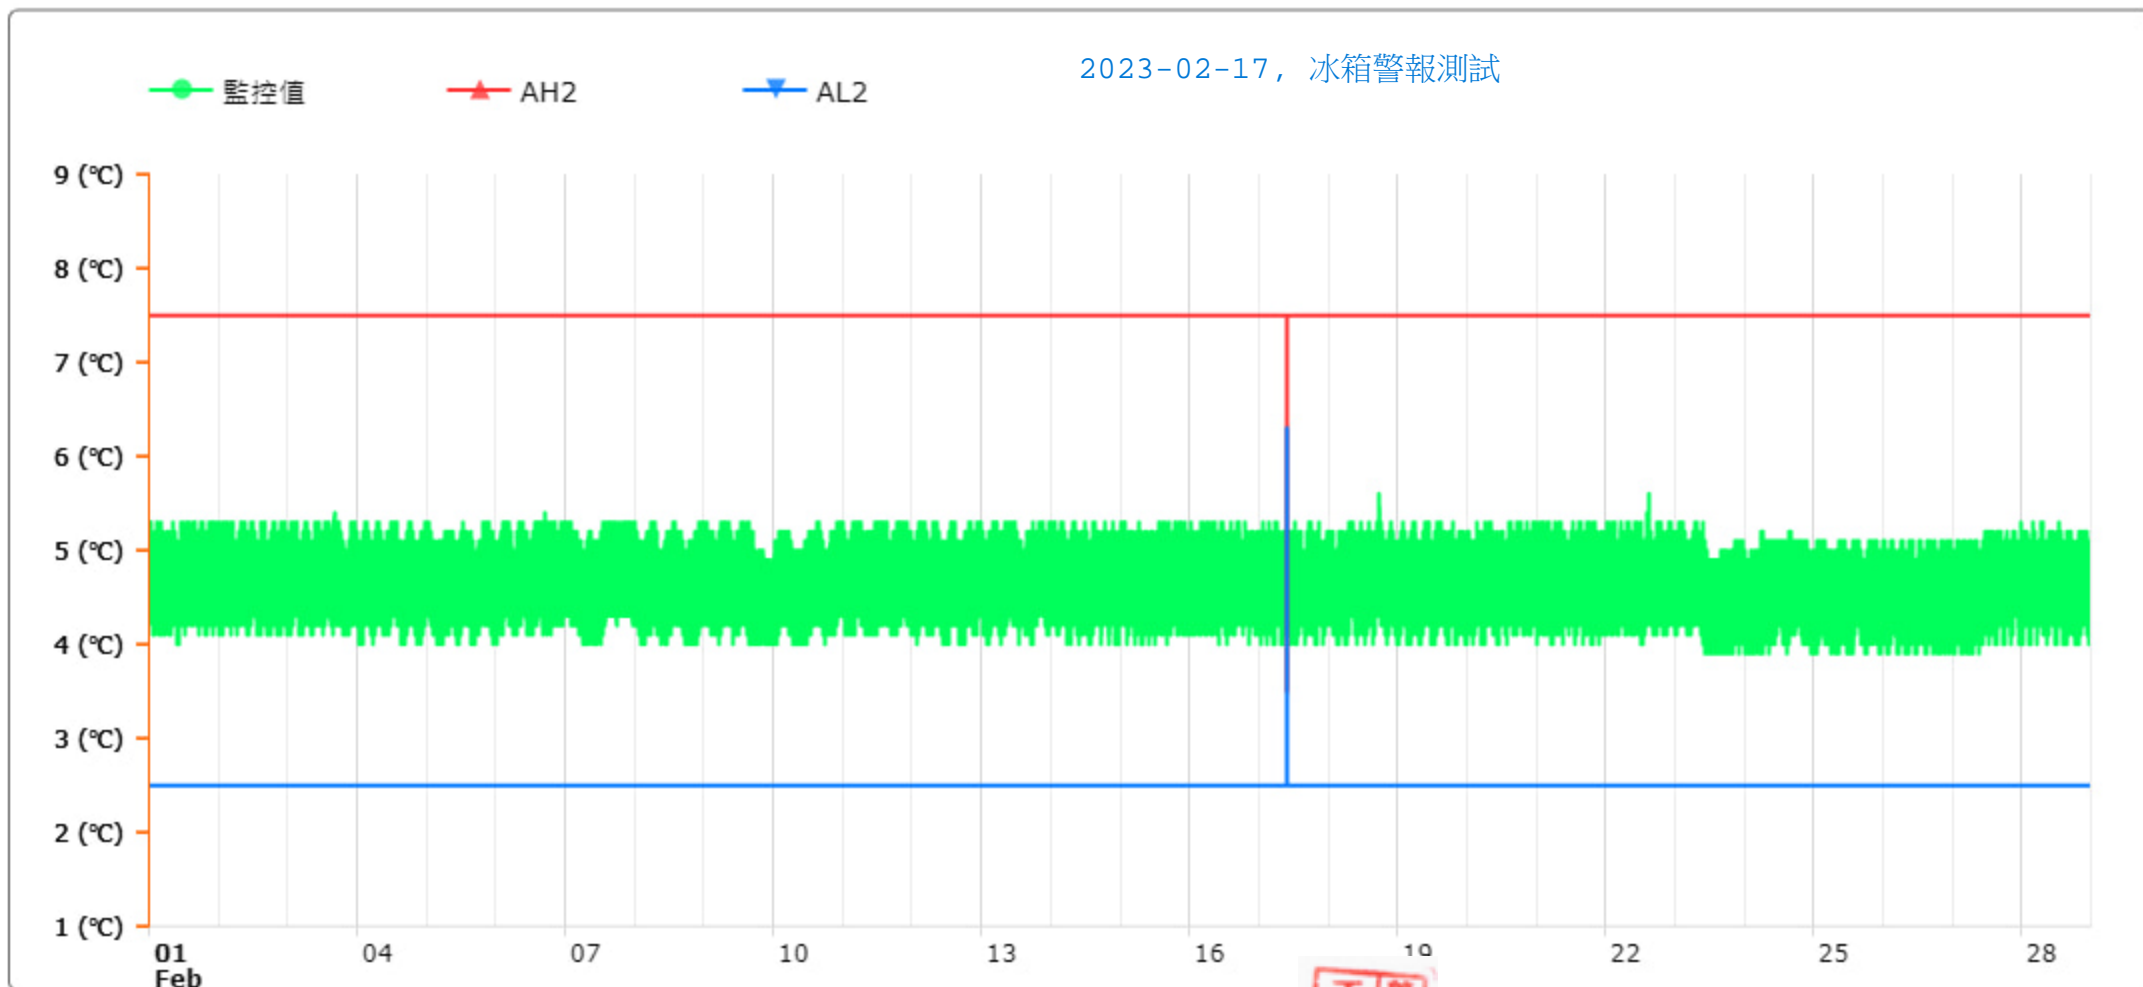

製表者: 王平宇

單位主管:

