


601-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(上)溫度紀錄表

月份: 2021/3

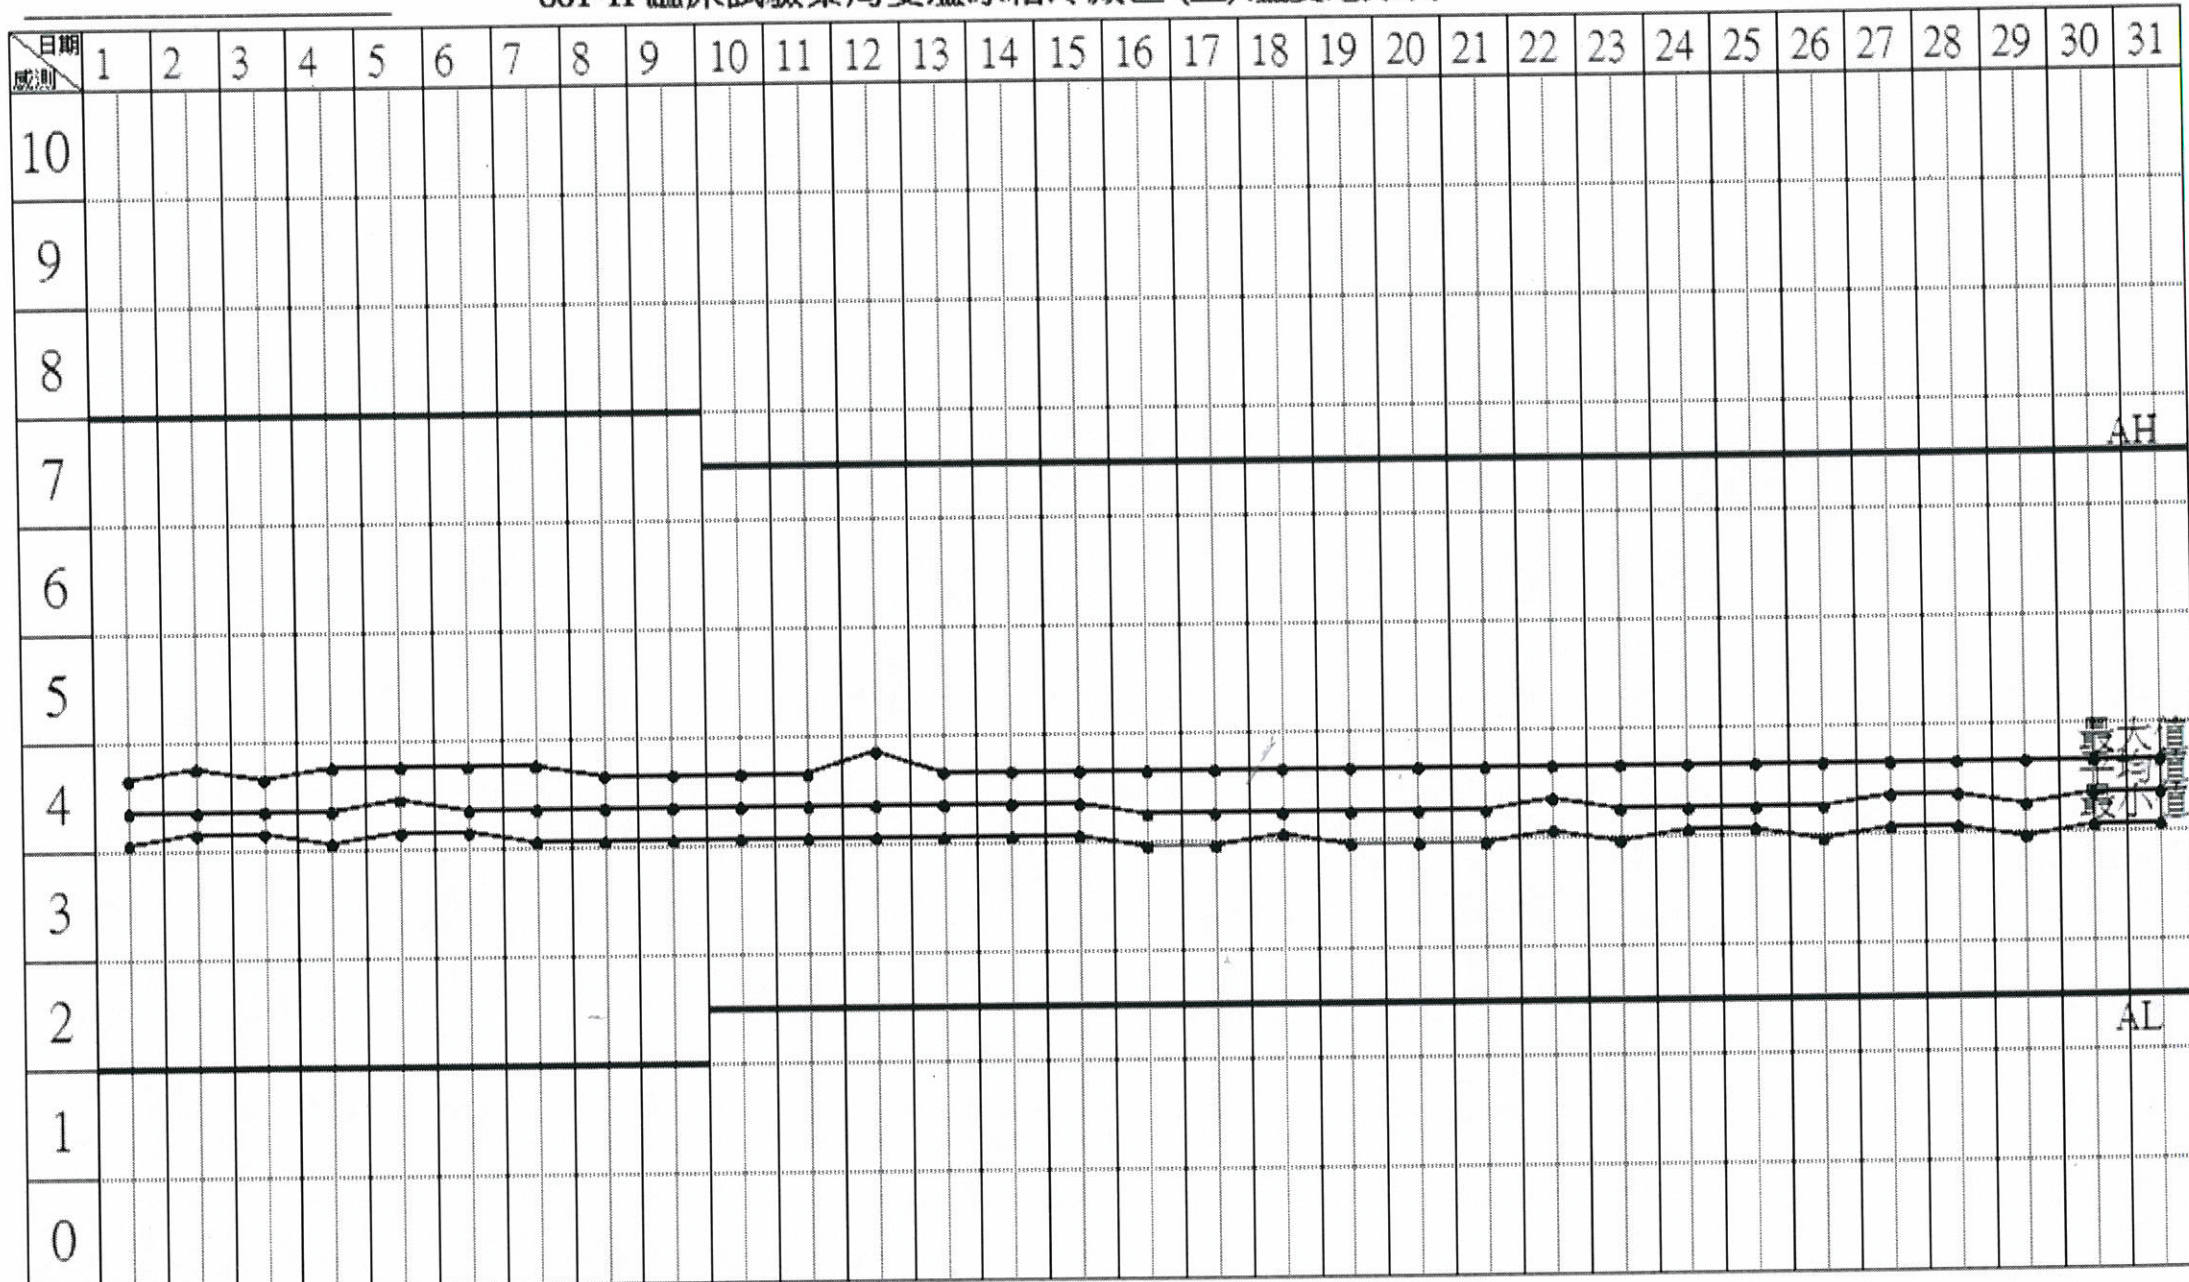

AH

AL

最大值  
平均值  
最小值

說明  
1. 感測單位:  
2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註  
2021.3.10 調整溫度監控 下限範圍