


601-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(上)溫度紀錄表

月份: 2021/4

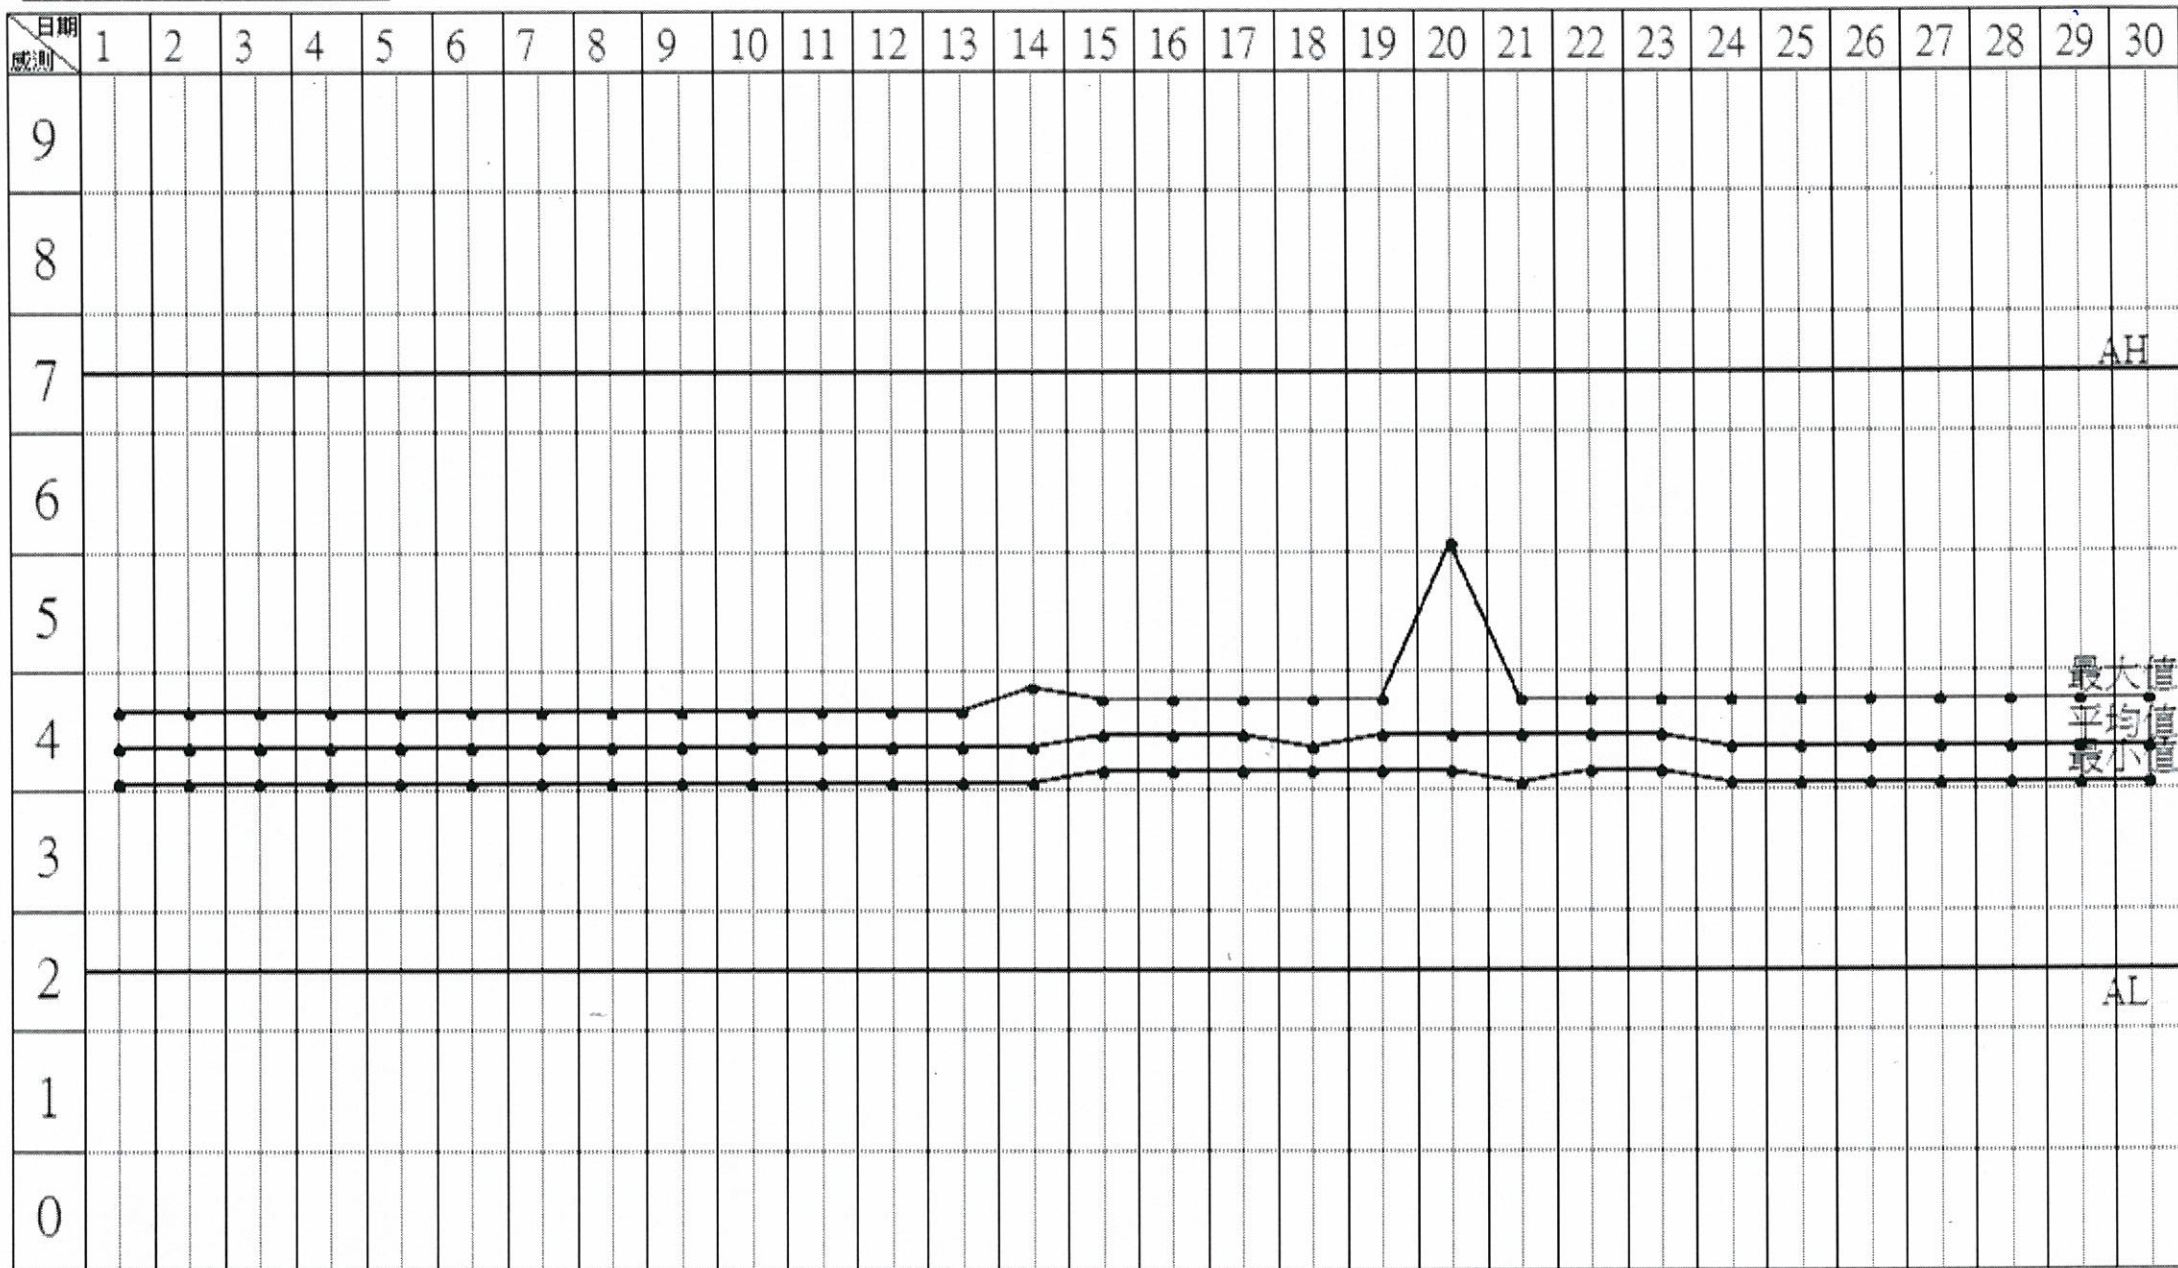

最大
平均
最小

AH

AL

說明
 1. 感測單位：
 2. 黑點：運作正常, 白點：異常警報, 灰點：超出顯示範圍

備註
 2021/04/20 公務室將一般插座更換成不斷電插座。