


601-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(上)溫度紀錄表

月份: 2022/1

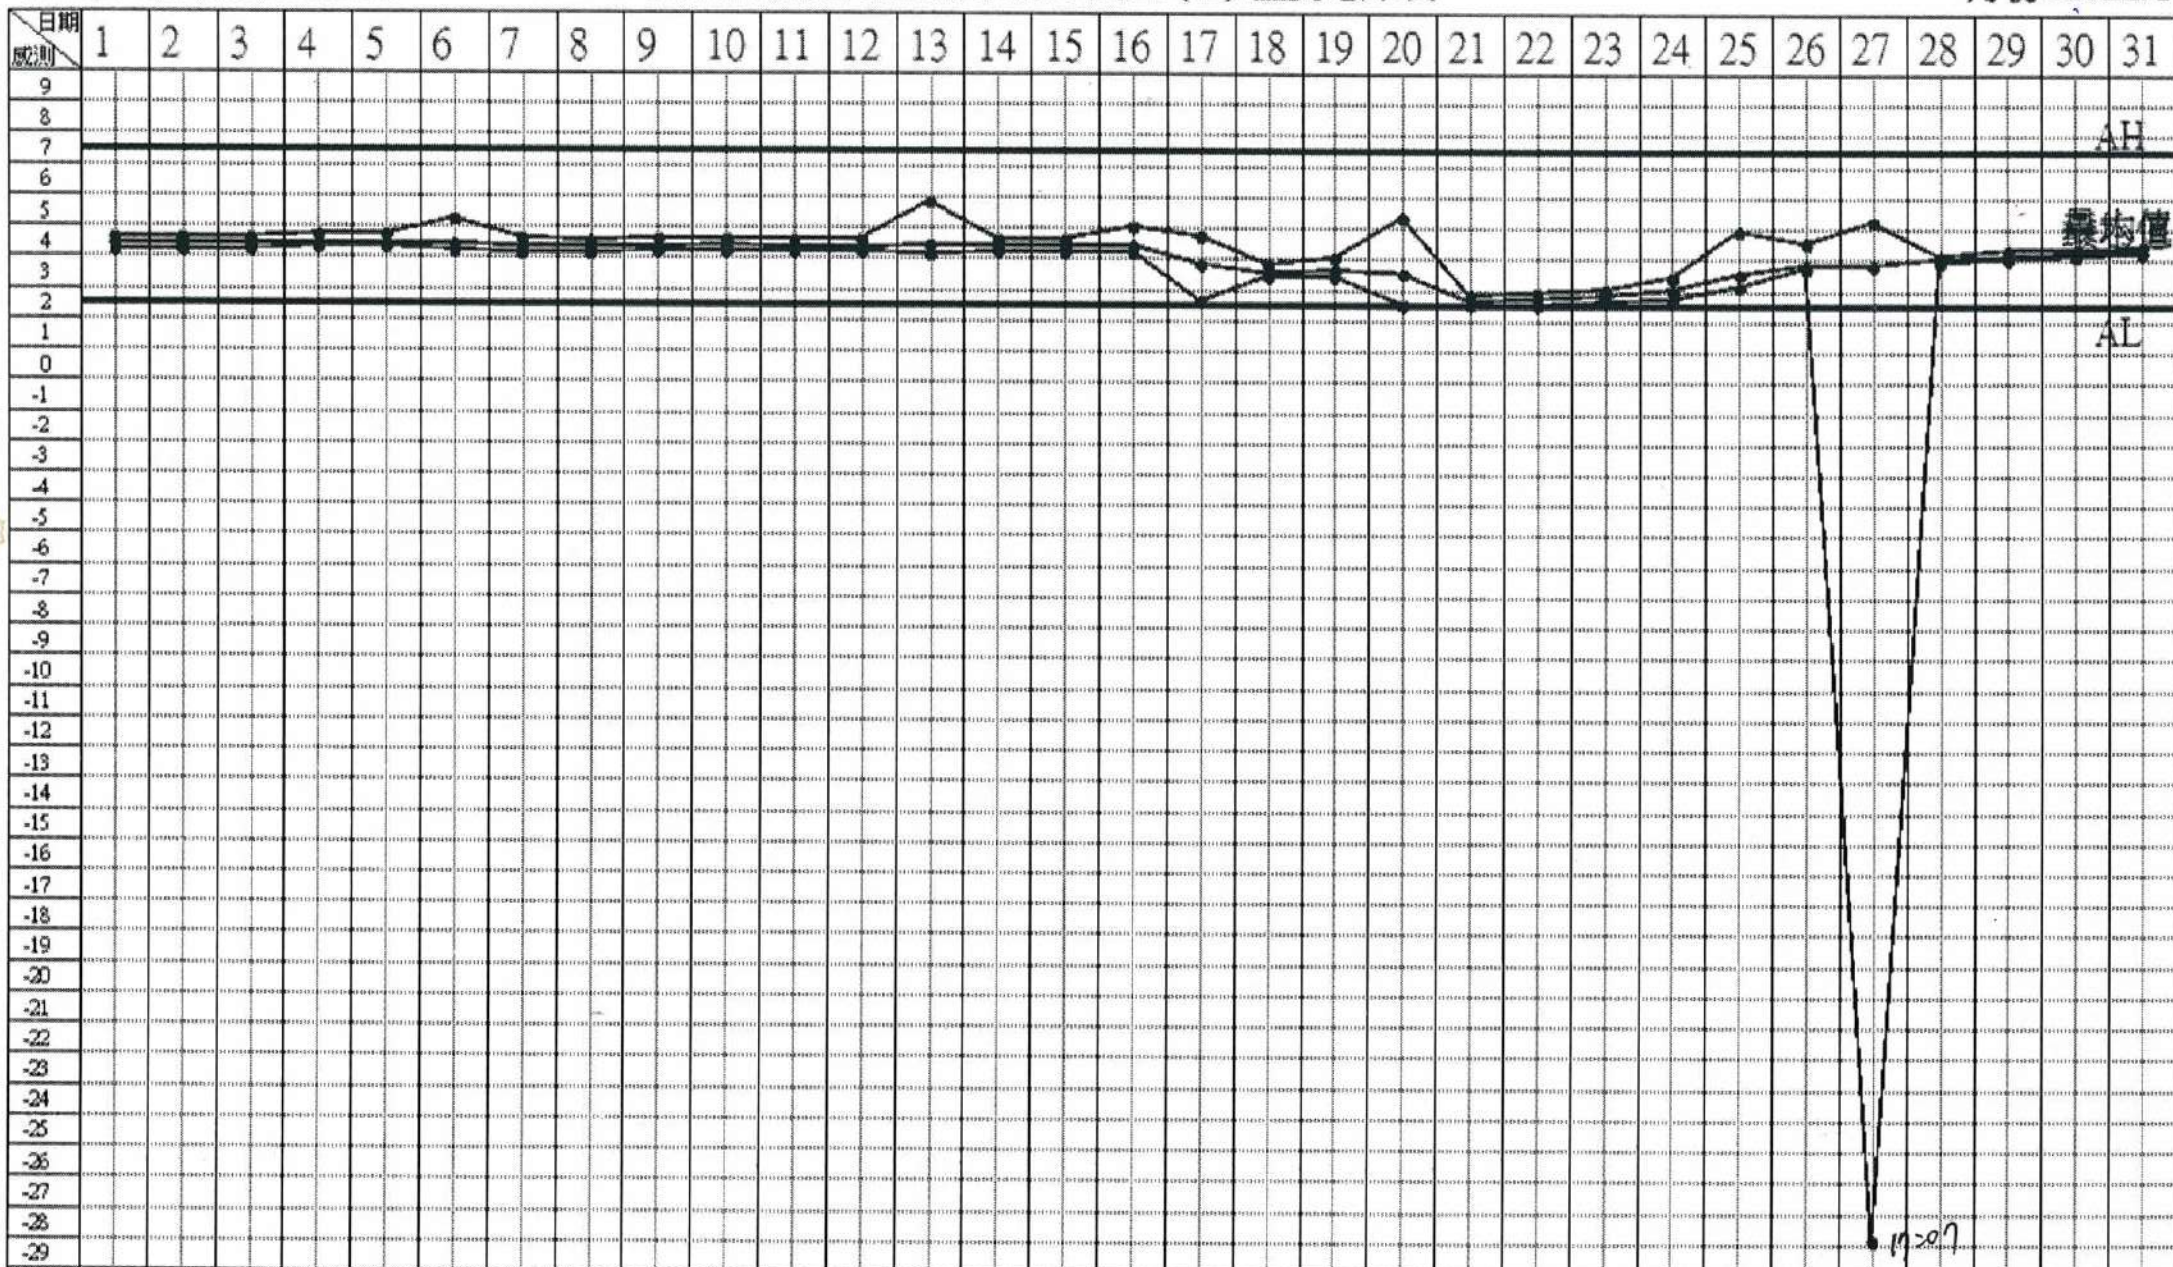


說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 1/27 廠商更換冰箱警報感應器, 短暫影響 60
 602
 王平宇 藥師 股長

感測器斷路或
 溫度低於可感測下限
 1/27 恢復正常
 藥師邱彥榕
 藥字033885號



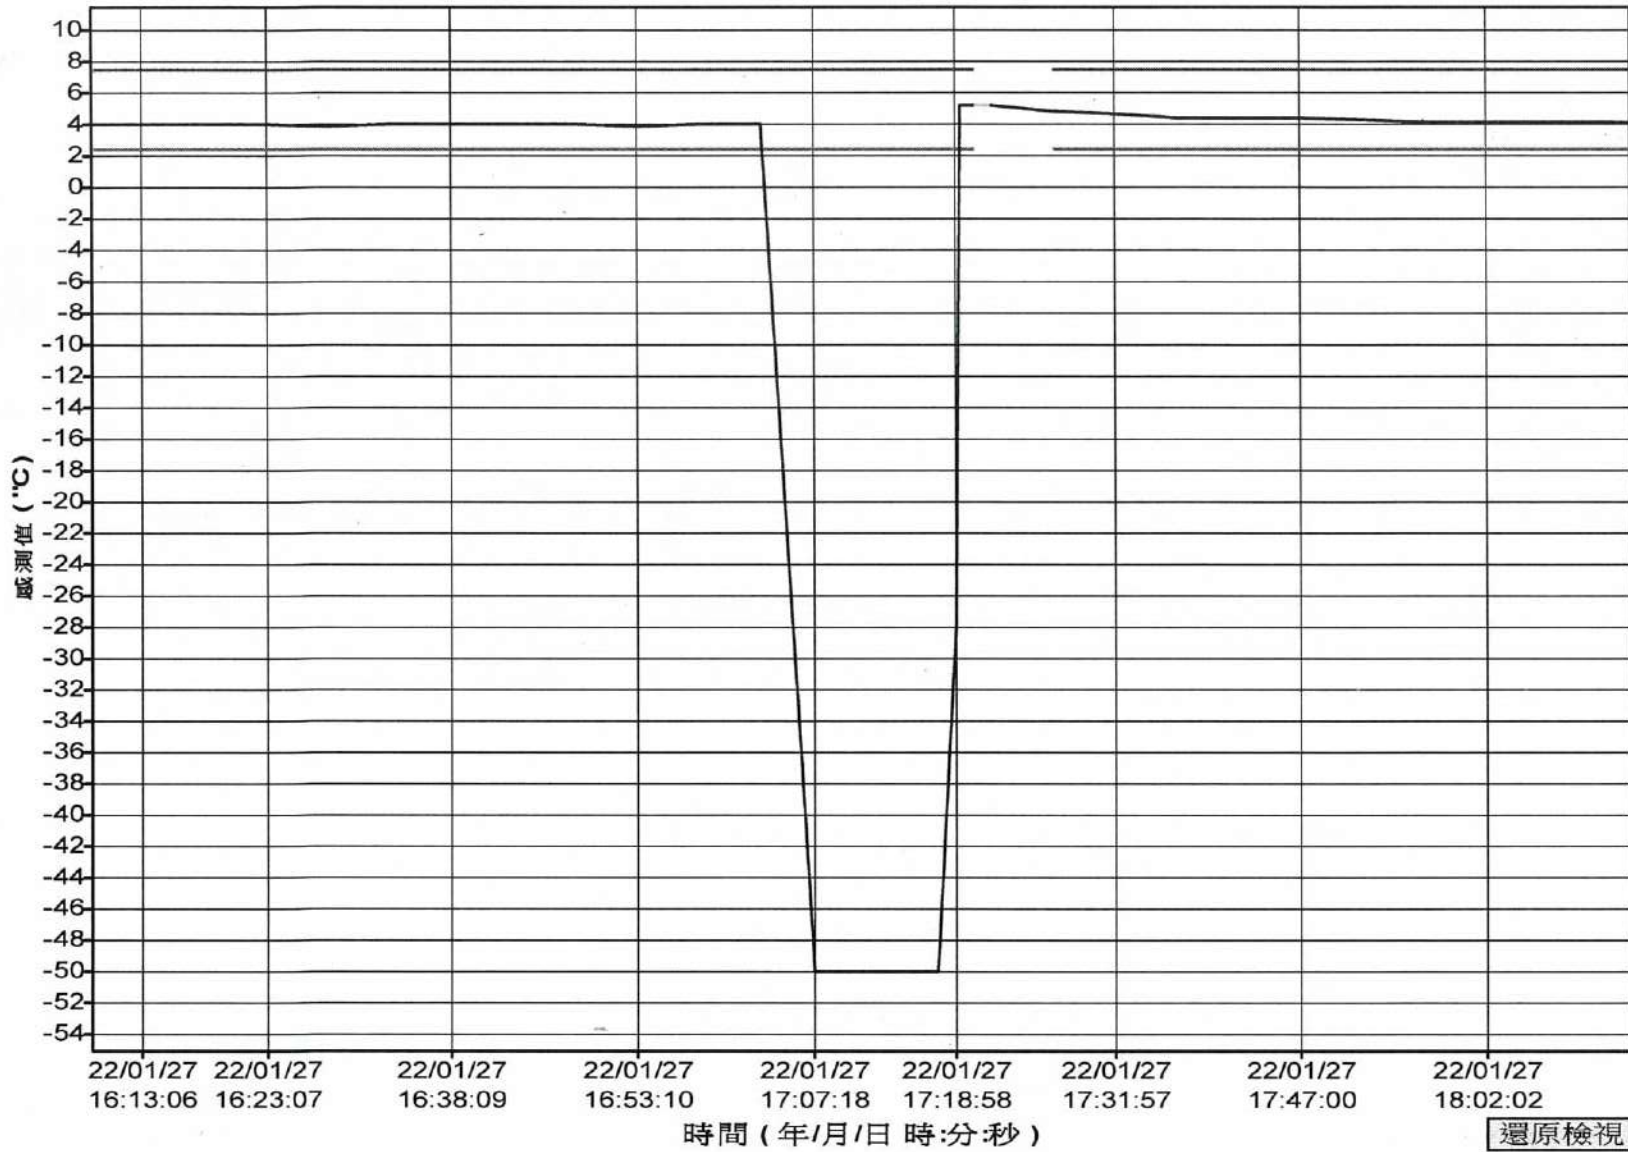

還原檢視

王平宇
藥學部股長

藥師邱彥榕
藥字033885號