


602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/5

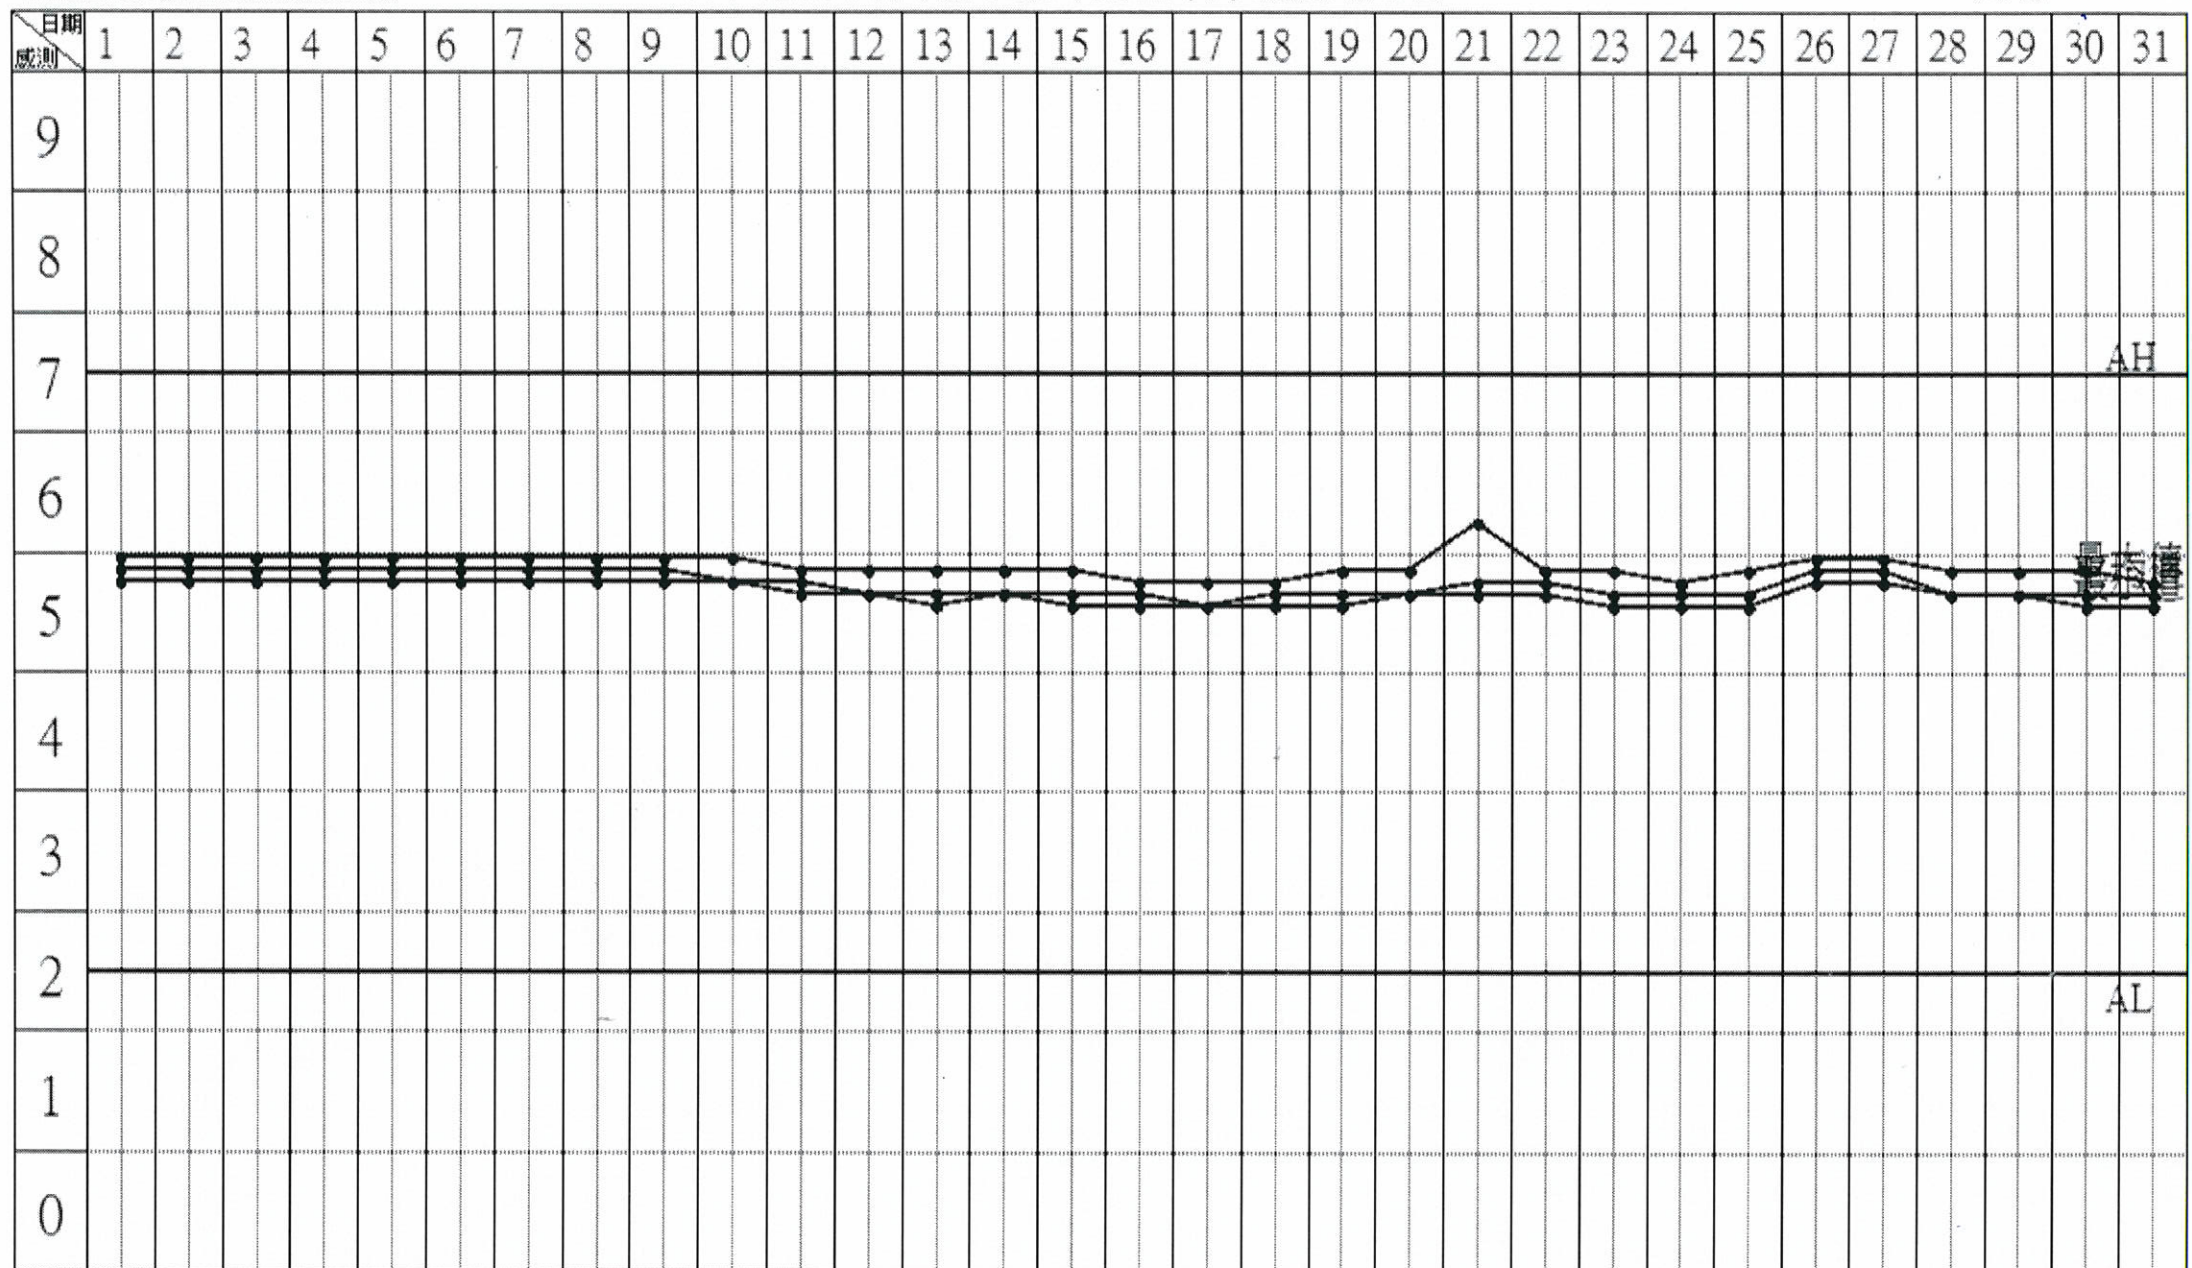

說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 2021/05/21 進行冰箱校正及測試。