


602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(下)溫度紀錄表

月份: 2022/1

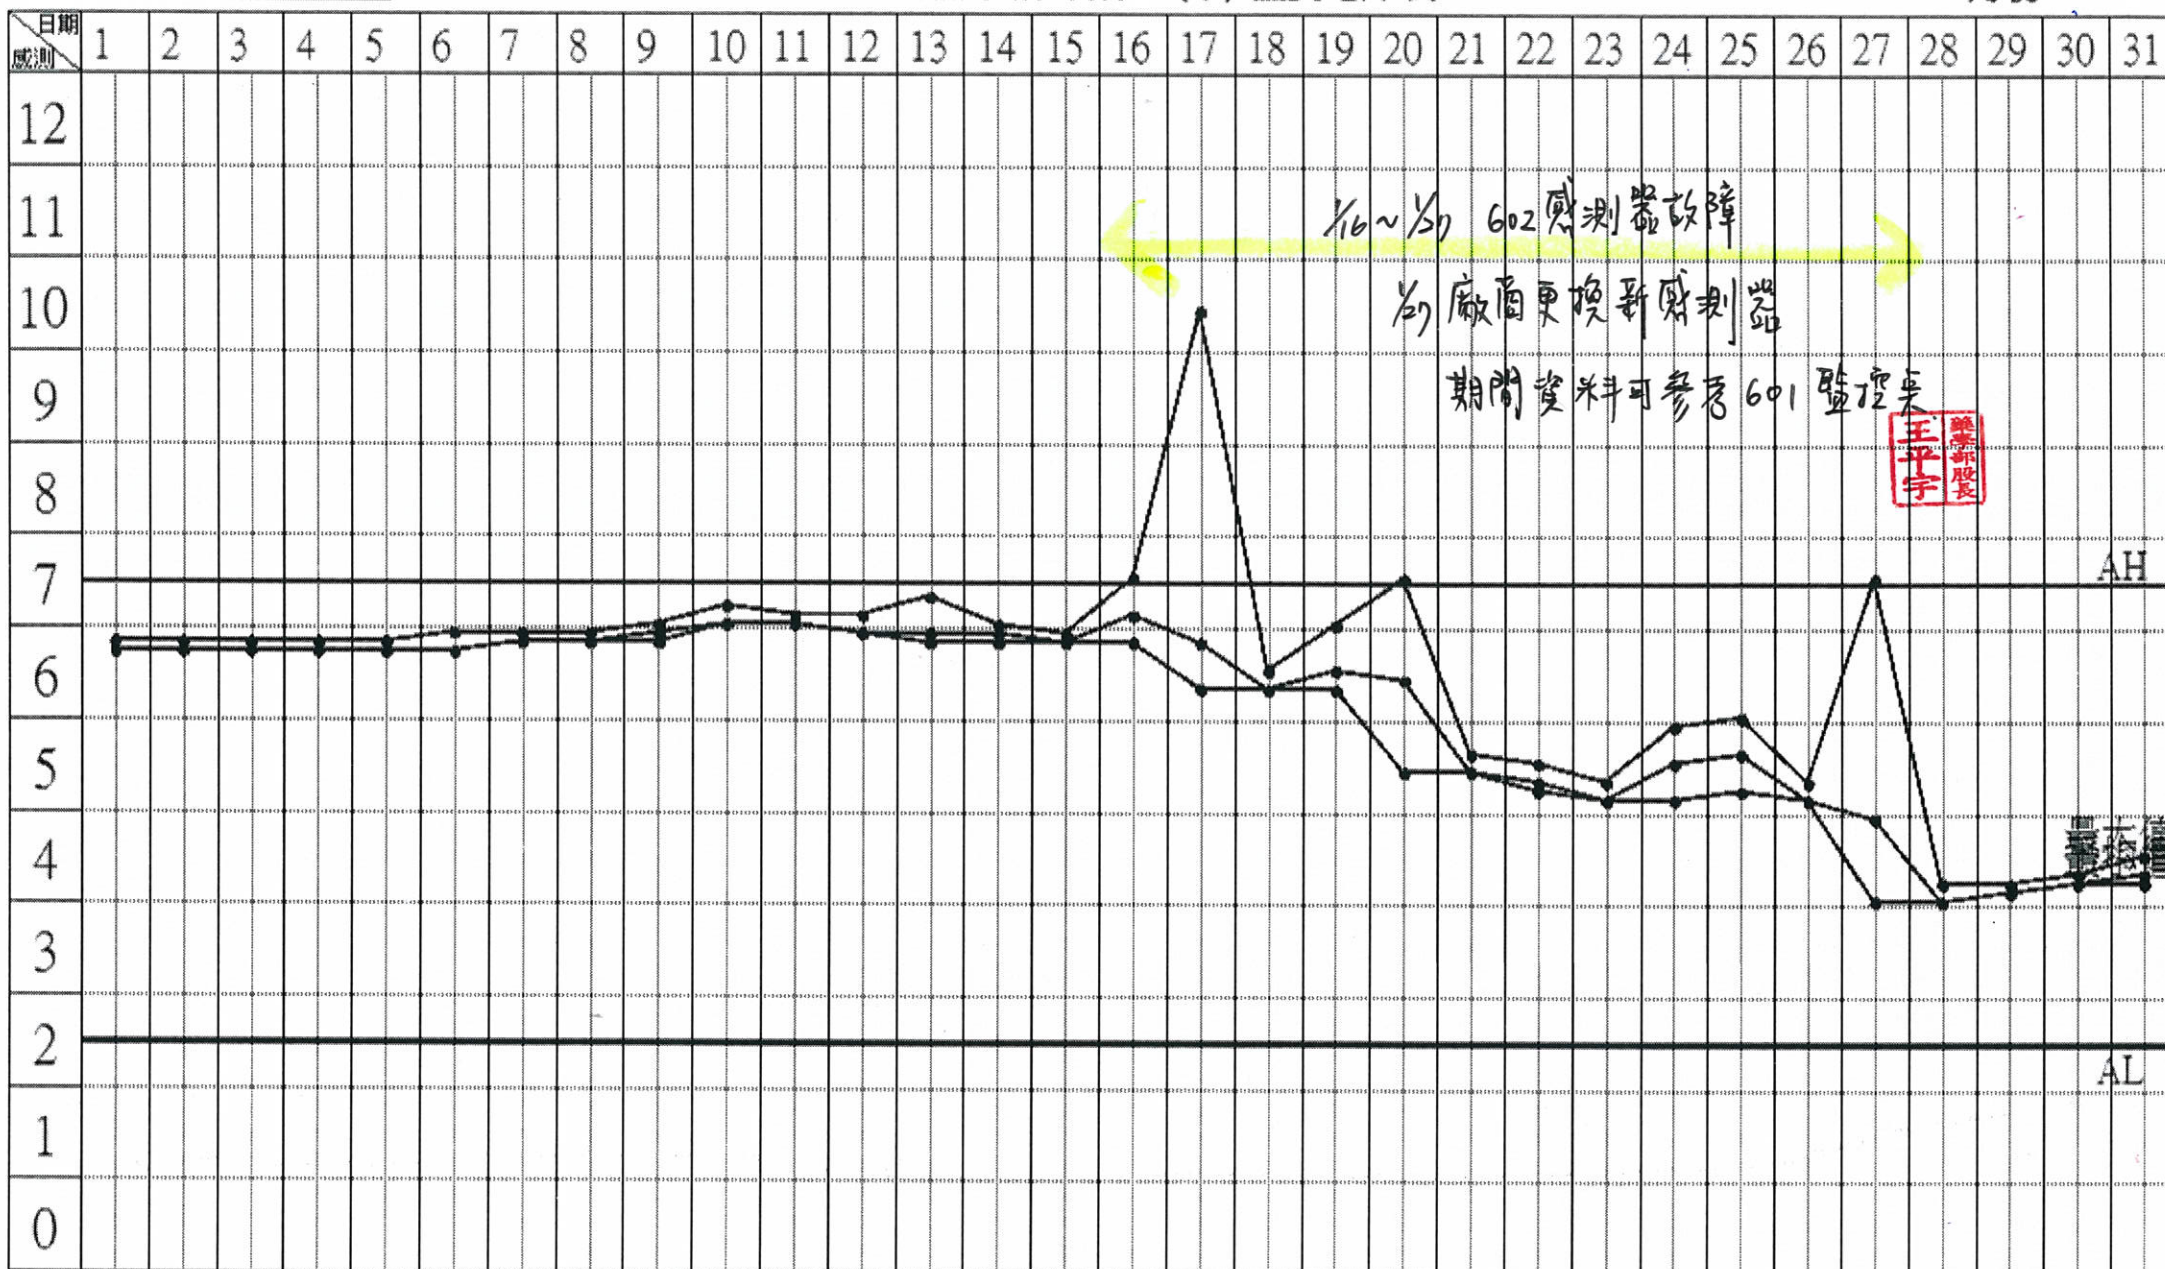

說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 1/17 602感應器顯示超溫, 但同時段其他溫度計均無問題, 冰箱廠商於1/27更換冰箱警報感應器。

