


602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區(下)溫度紀錄表

月份: 2022/2

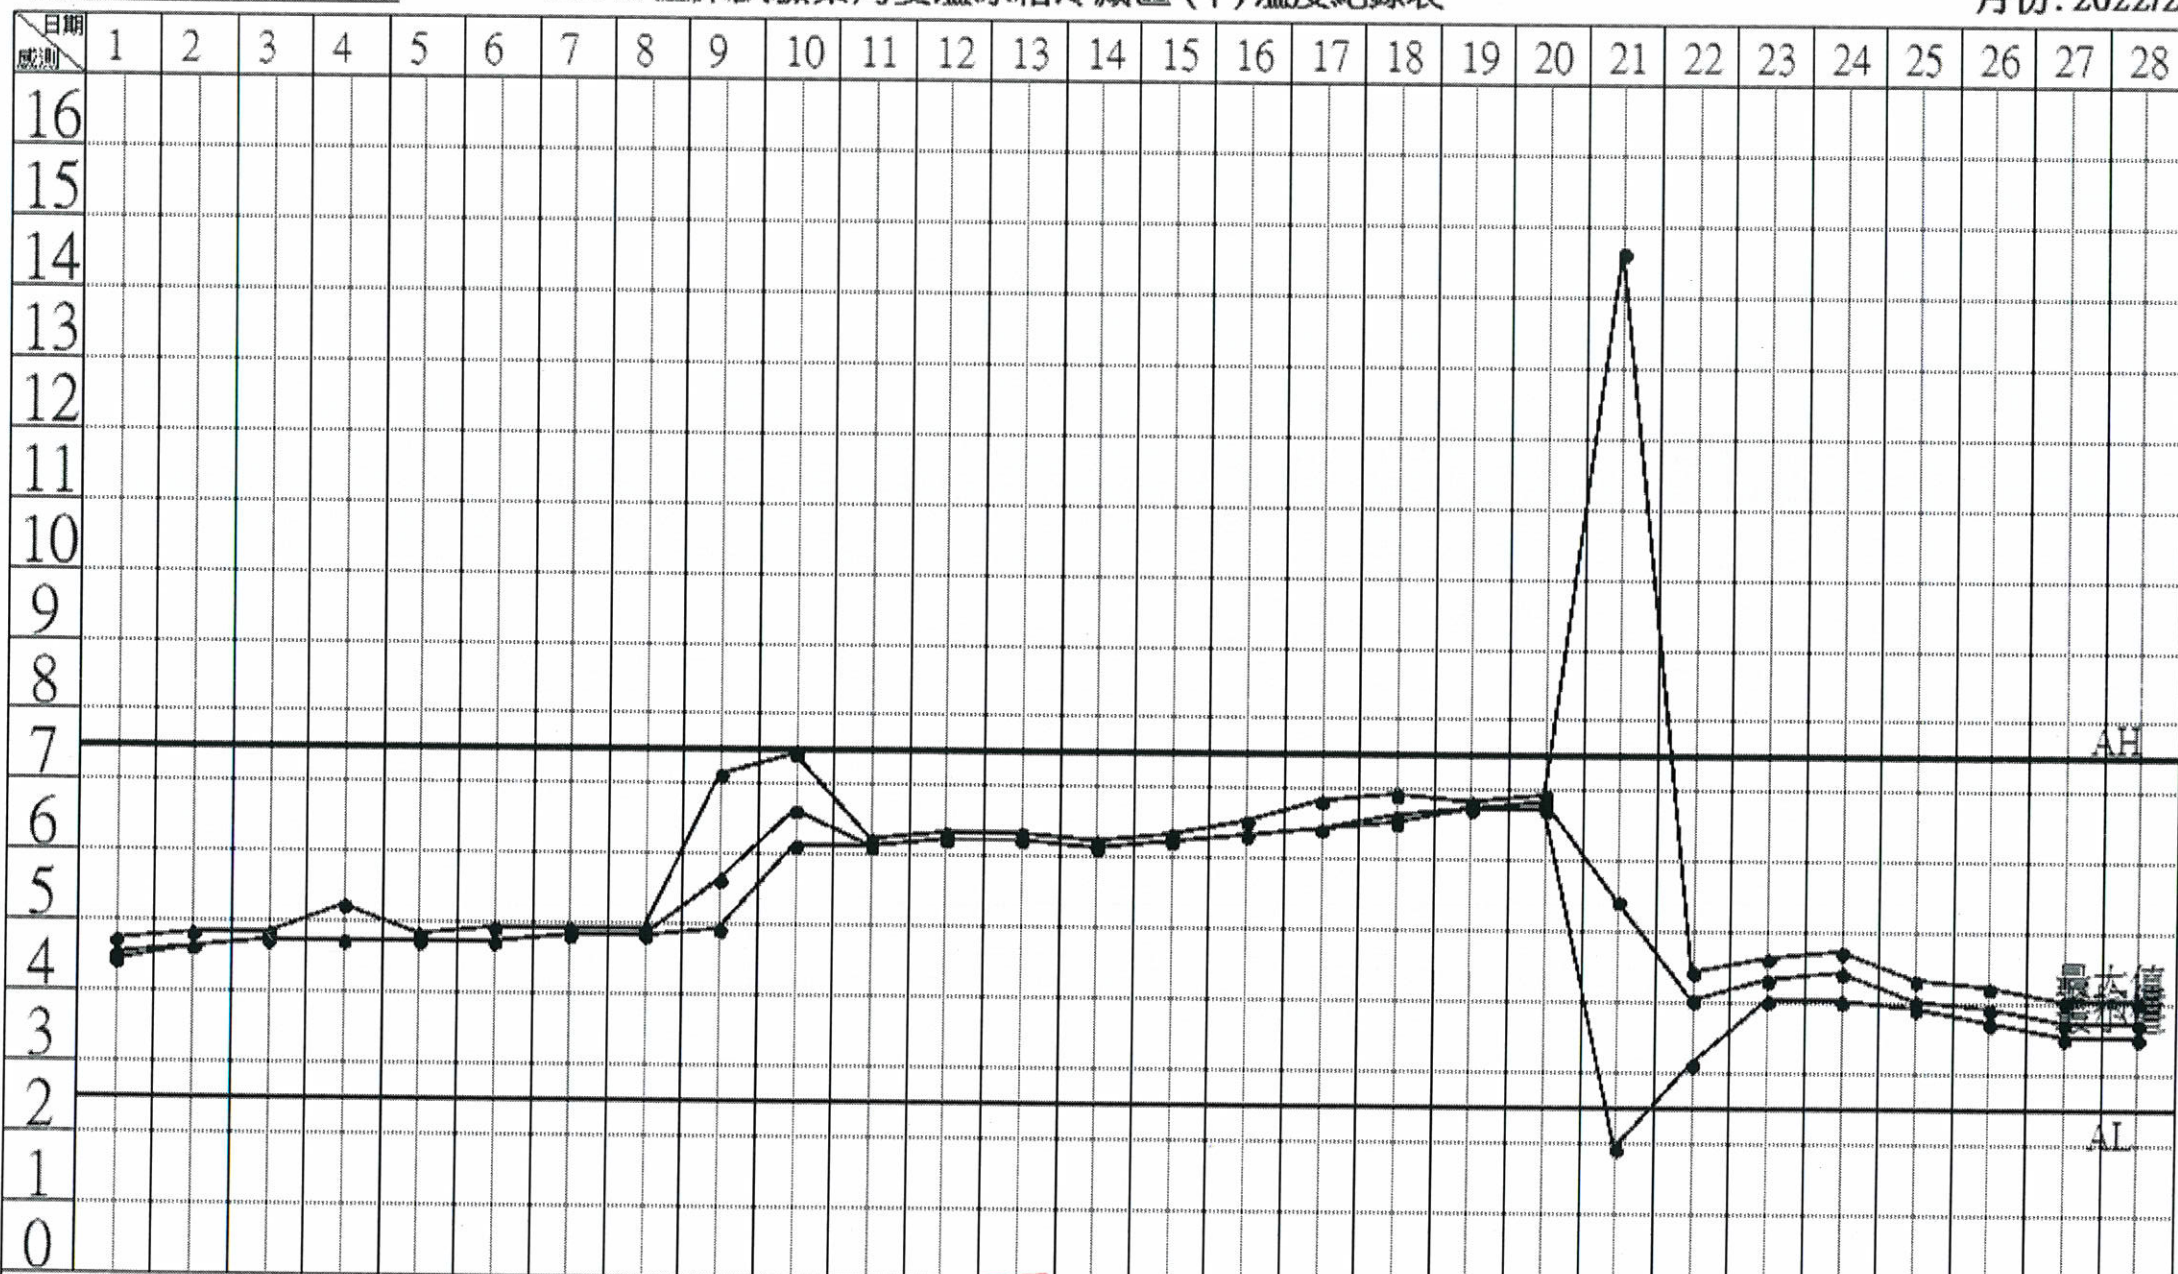


說明  
 1. 感測單位:  
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註  
 2/21 { 601. 王平宇 製器異常, 藥品移至 605.606 冰箱, 3/1 起更換冰箱警報系統  
 601.602 異常測試

曲線顏色說明 感測器 1 AH AL

602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區(下)

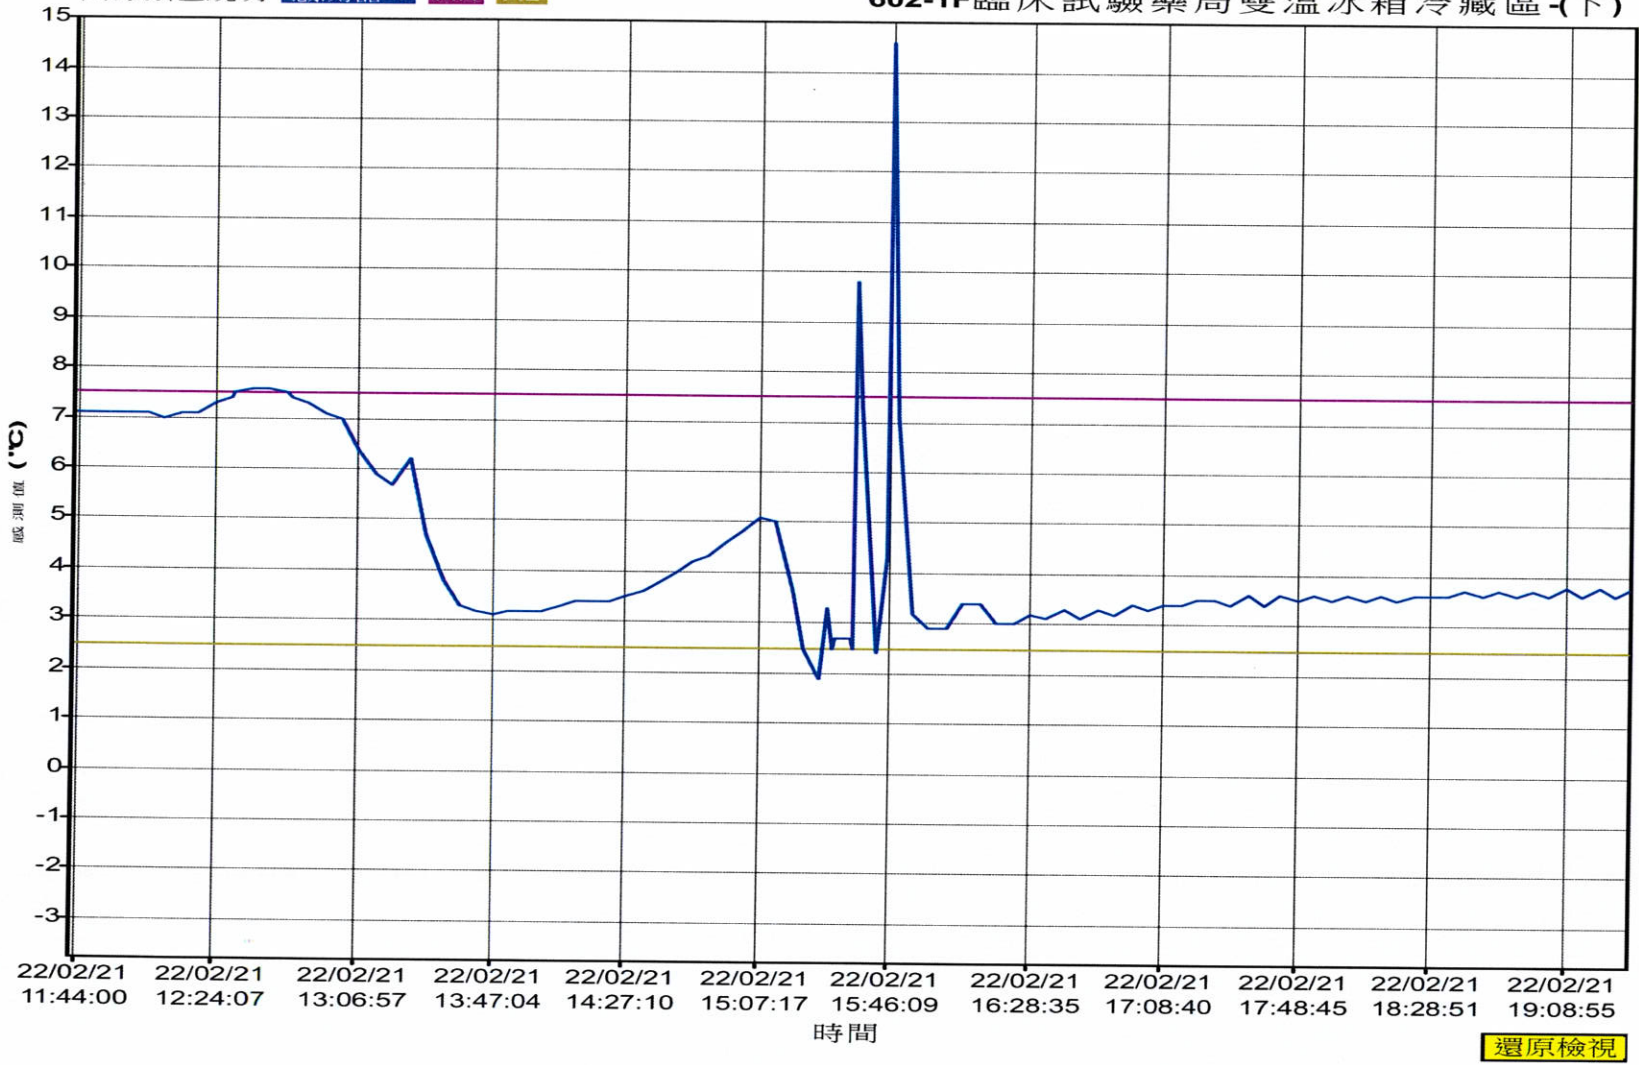

2/21 601 感測器異常  
 601. 602 進行異常測詞。



還原檢視