

# 監控點圖表


監控點: 602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(下)

時間區間: 2022-05-01 00:00 ~ 2022-05-31 23:59

最大值: 8.5 °C

最小值: 1.7 °C

平均值: 5.6 °C

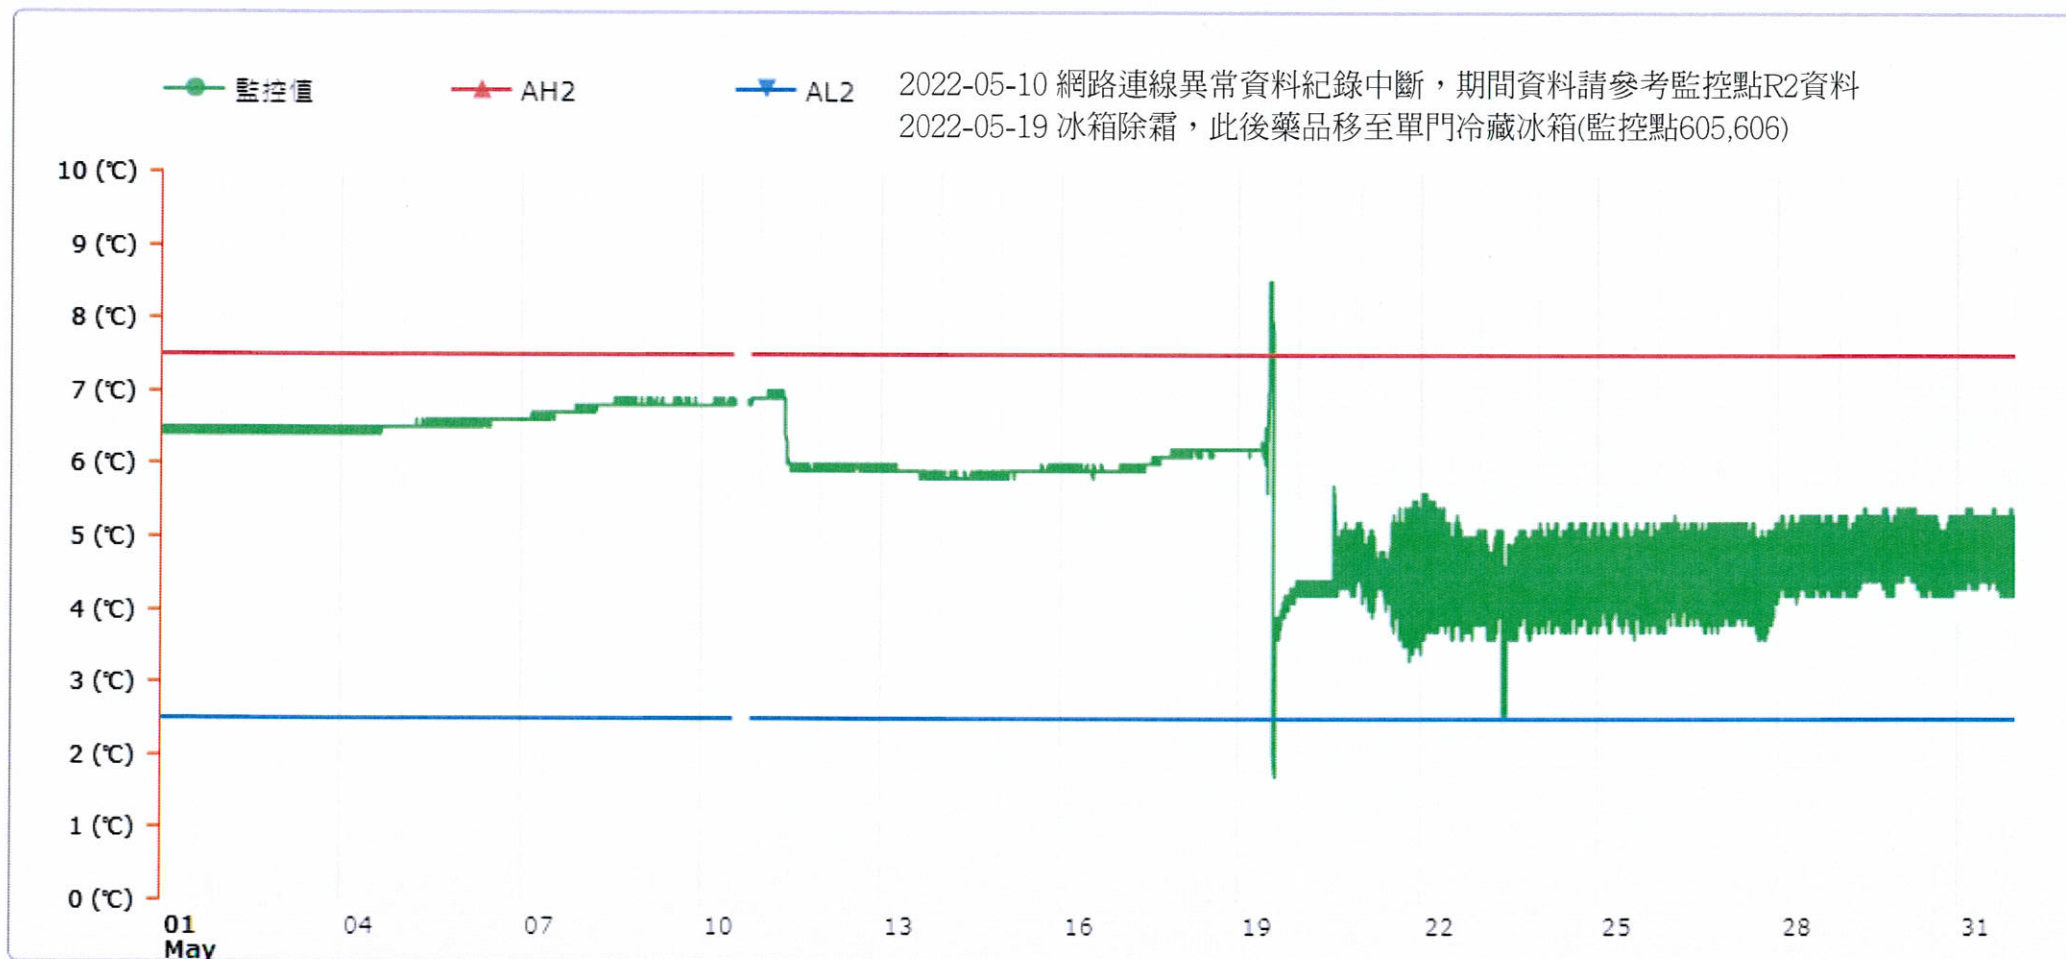

製表者: 邱彥榕



單位主管:

