

# 監控點圖表


監控點: 602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(下)

時間區間: 2022-06-01 00:00 ~ 2022-06-30 23:59

最大值: 5.6 °C

最小值: 4 °C

平均值: 4.8 °C

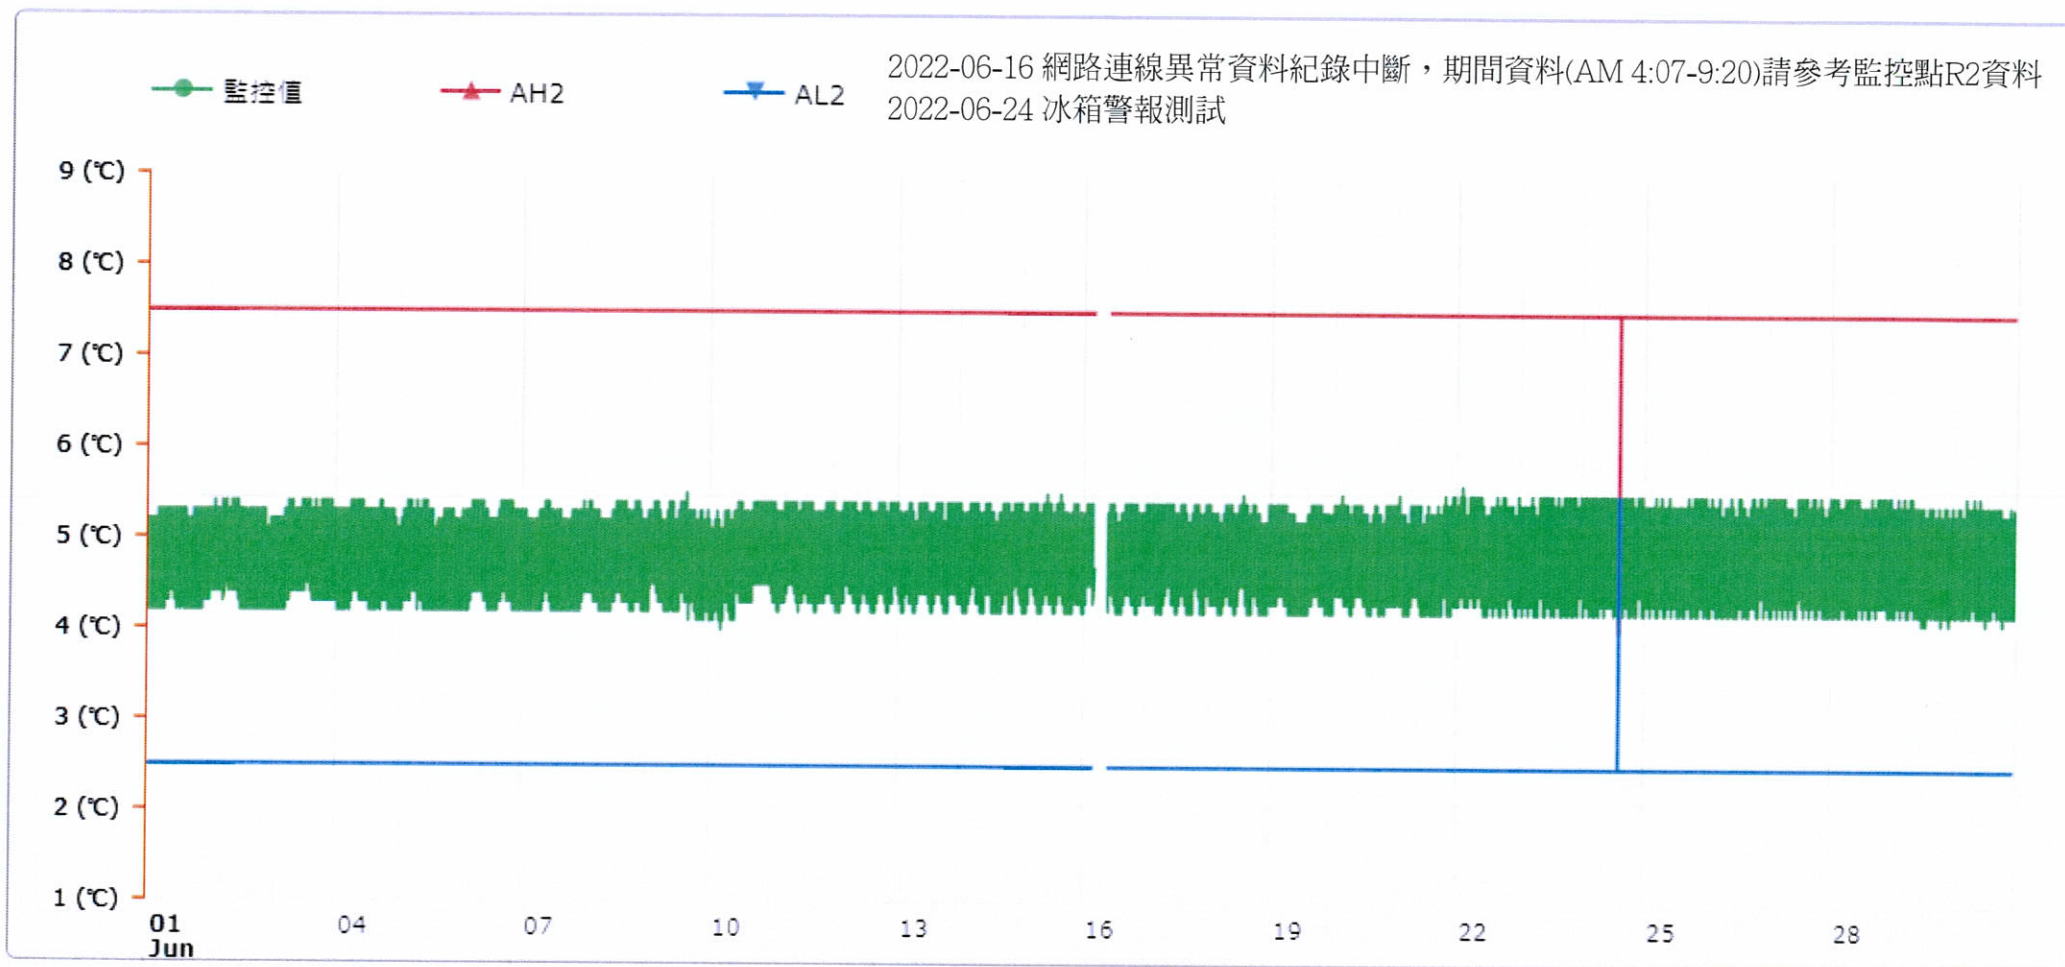

製表者: 邱彥榕

藥師 邱彥榕  
藥字 033885 號

單位主管:

王平宇  
藥學部長