

# 監控點圖表


監控點: 602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(下)

時間區間: 2022-11-01 00:00 ~ 2022-11-30 23:59

最大值: 5.6 °C

最小值: 0 °C

平均值: 4.8 °C

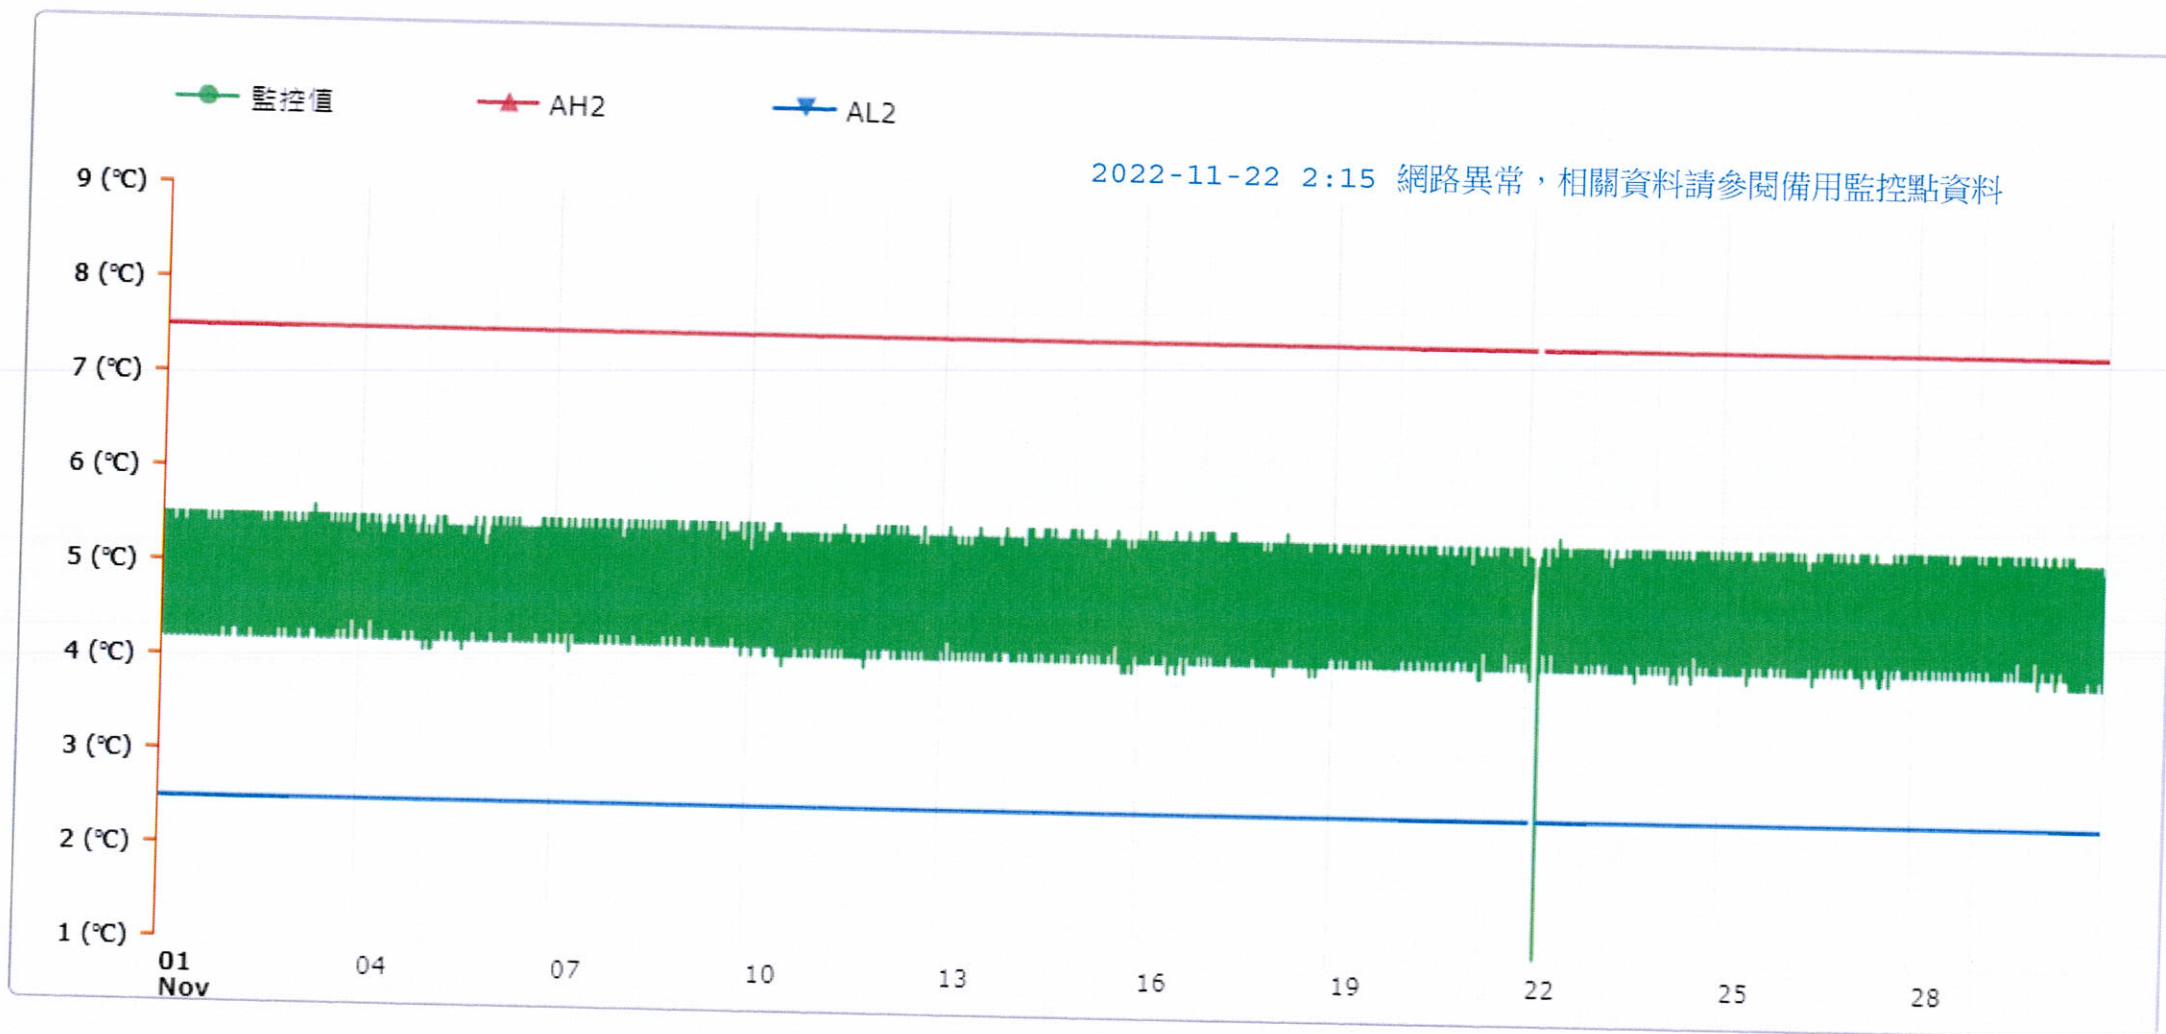

製表者: 王平宇

單位主管: 藥師 王平宇  
藥字第033057號