


603-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區(上)溫度紀錄表

月份: 2021/3

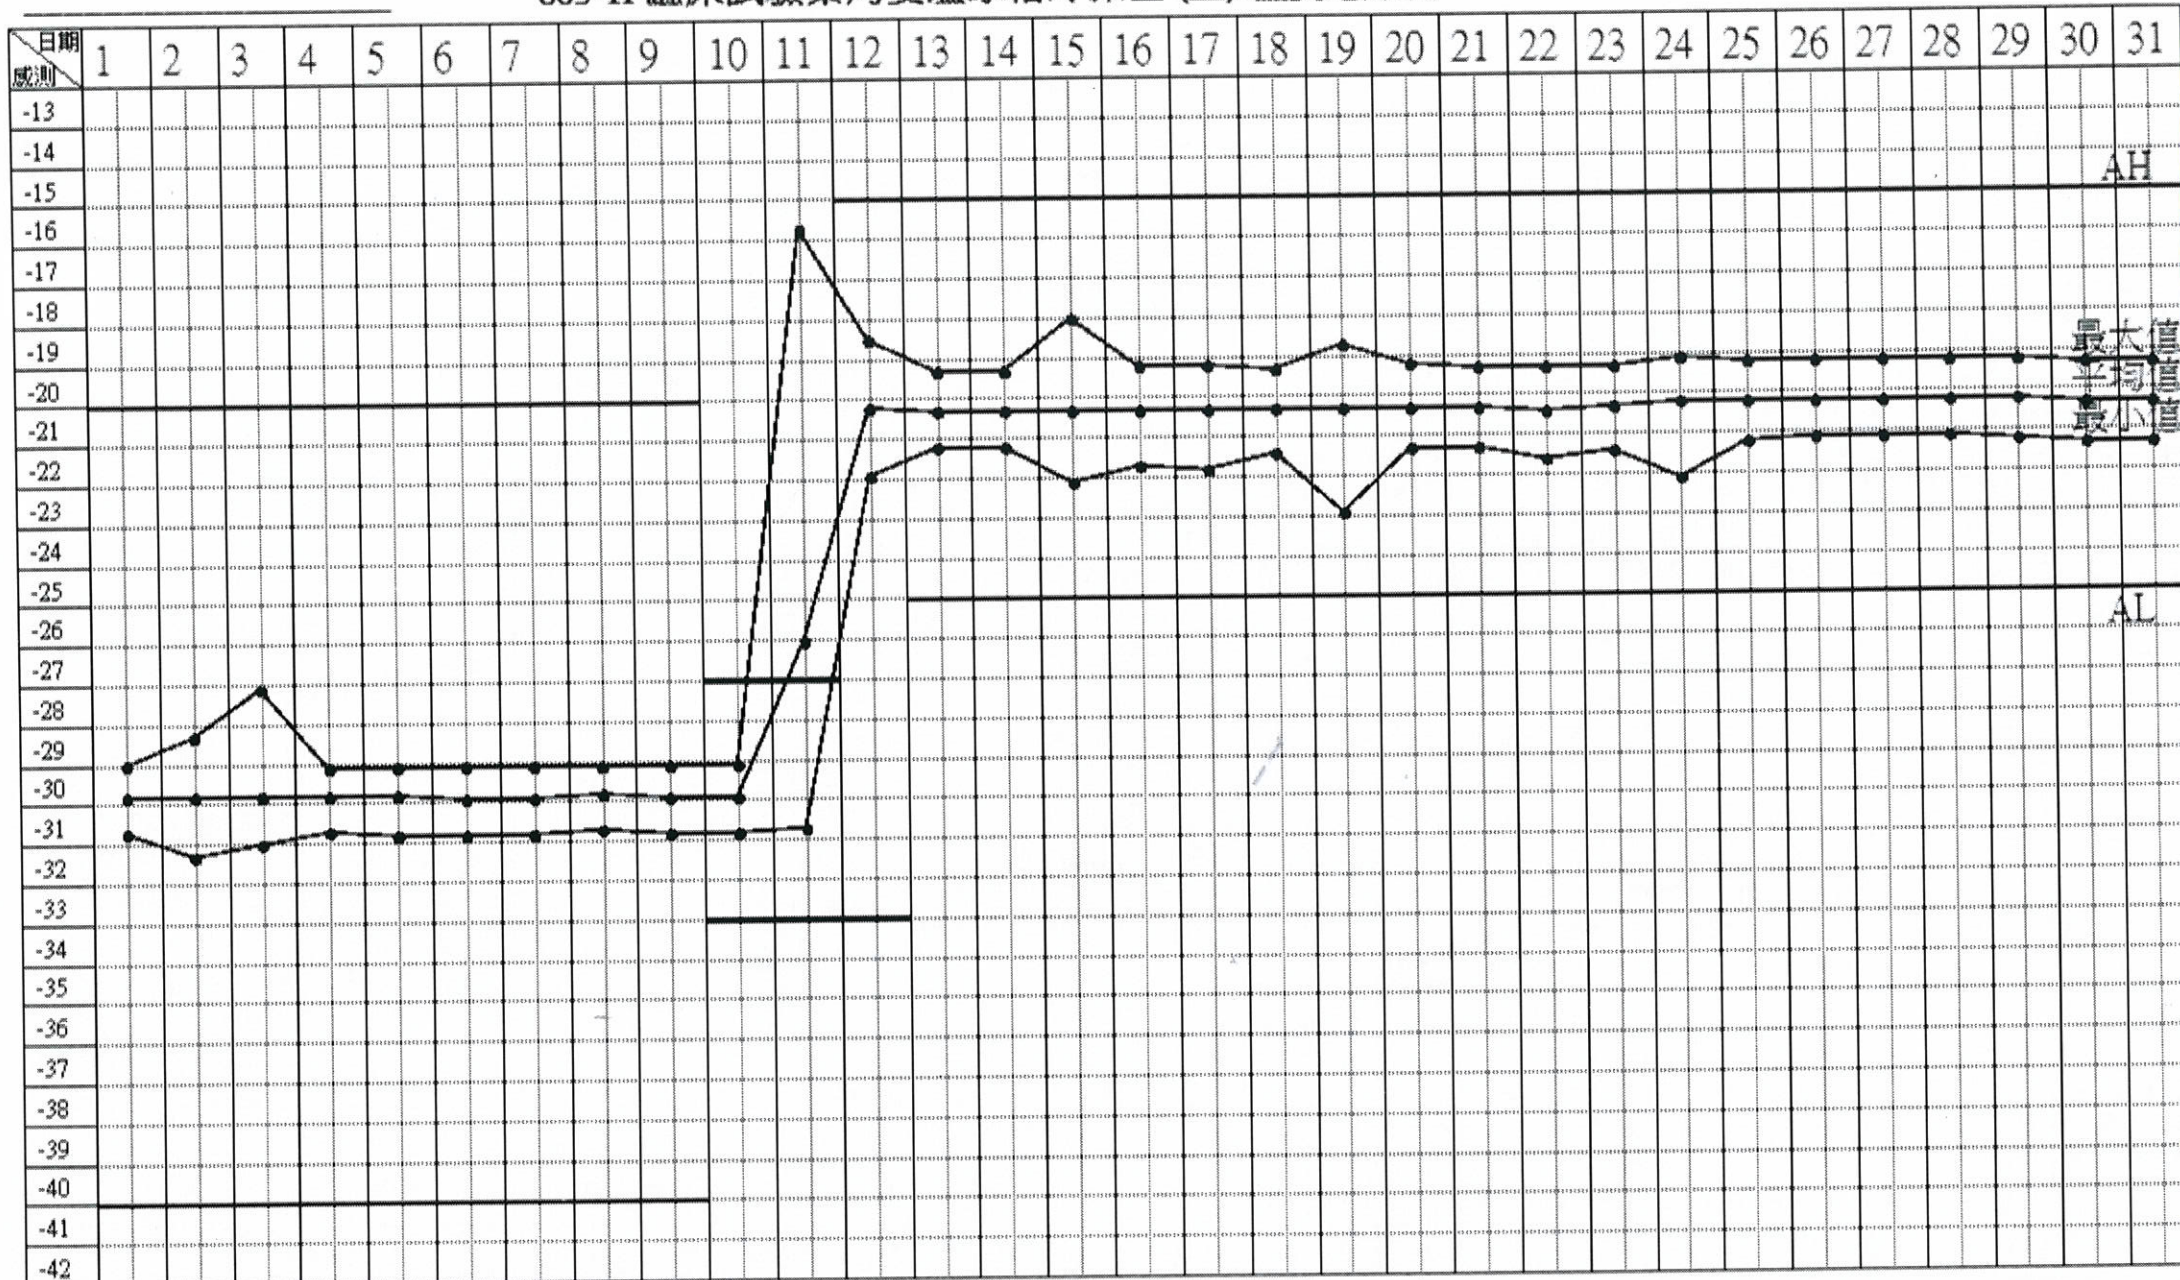

說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 2021. 3. 10 調整溫度監控上下限範圍
 2021. 3. 11 - 3. 12 將冰箱溫度由 -30°C 調整為 -20°C 並重新設定監控上下限範圍
 3/1 - 3/9 製作溫流圖關閉門頻繁

