


603-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(上)溫度紀錄表

月份: 2021/5

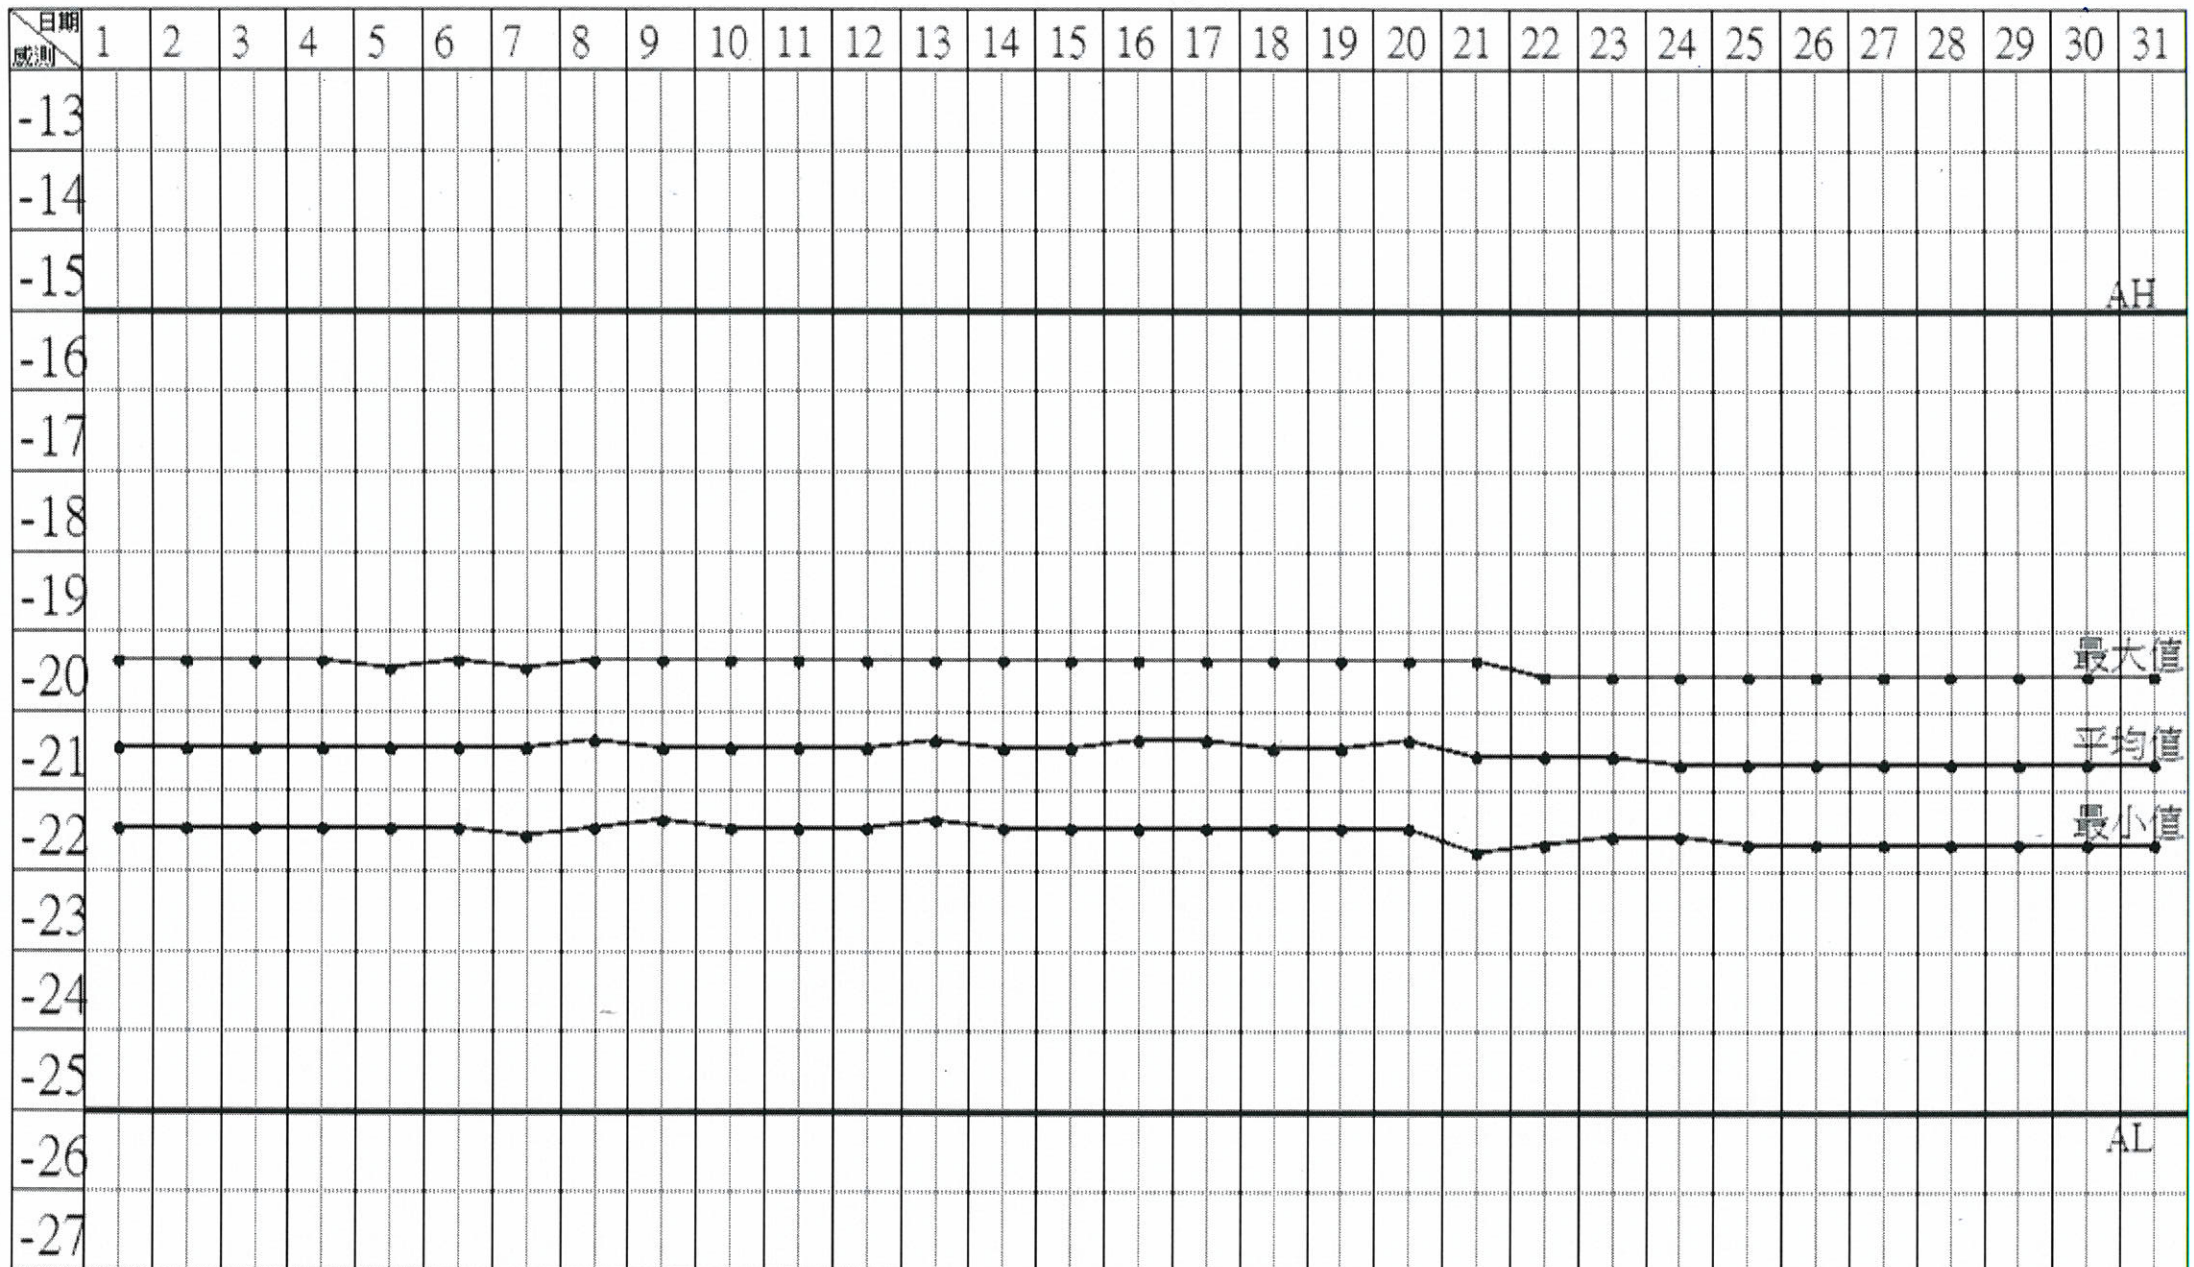

AH

最大值

平均值

最小值

AL

說明
 1. 感測單位：
 2. 黑點：運作正常, 白點：異常警報, 灰點：超出顯示範圍

備註
 2021/05/21 進行冰箱校正及測試。

藥師
 王平宇
 藥字第033857號

藥師邱彥榕
 藥字033885號