


603-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(上)溫度紀錄表

月份: 2021/12

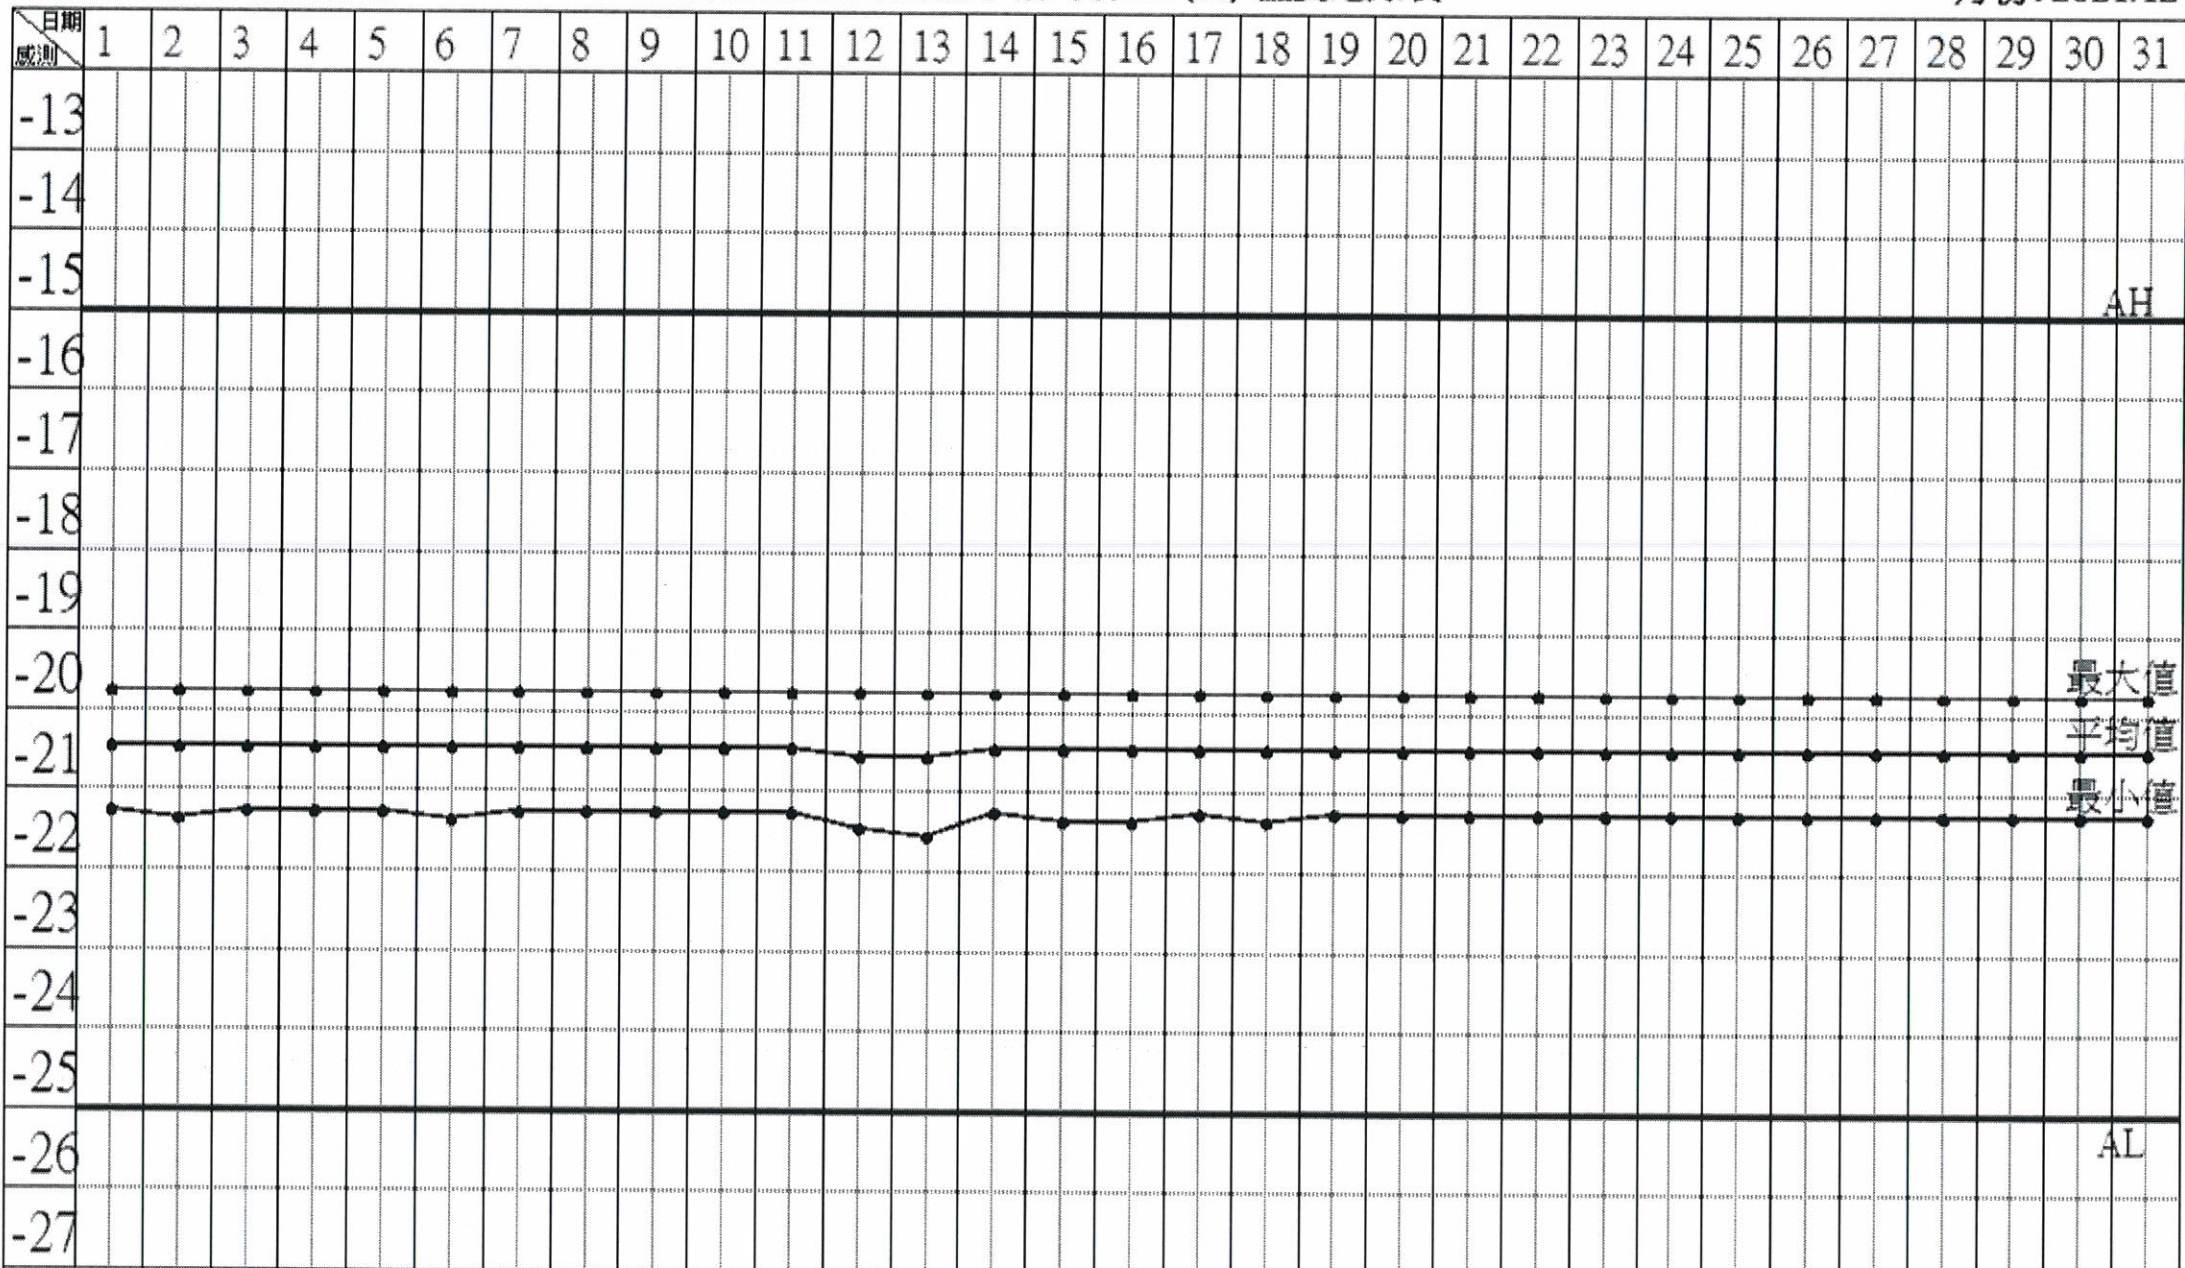

AH

最大值
平均值
最小值

AL

說明
 1. 感測單位：
 2. 黑點：運作正常, 白點：異常警報, 灰點：超出顯示範圍

備註