


603-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(上)溫度紀錄表

月份: 2022/2

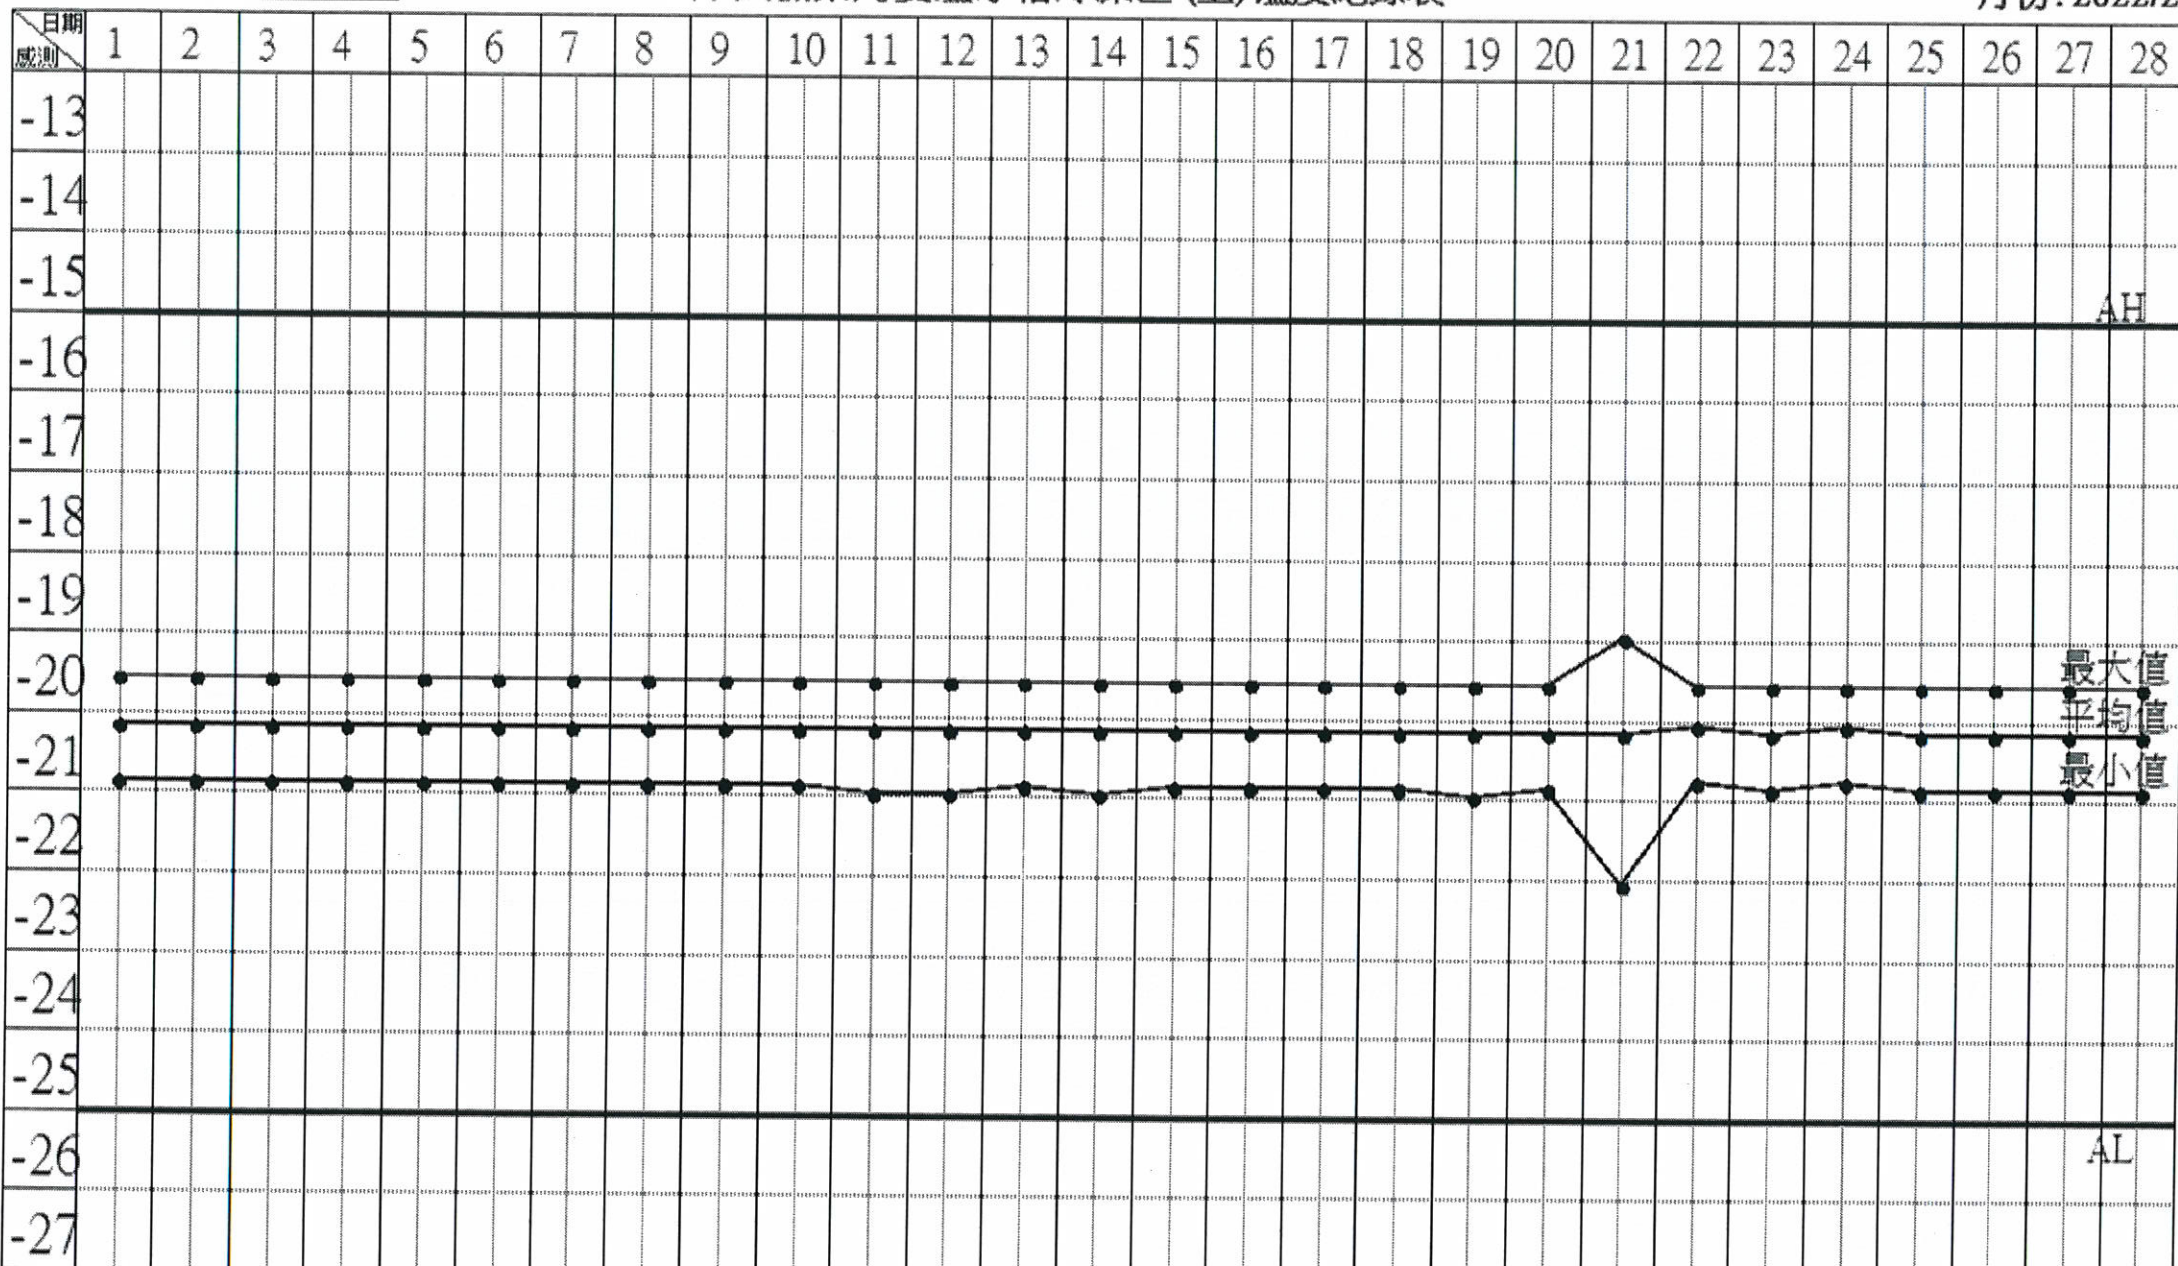

說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 2/21 601.602 控制器異常, 把原置於603.604 的冰袋移至601.602 穩定溫度.

