


604-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/5

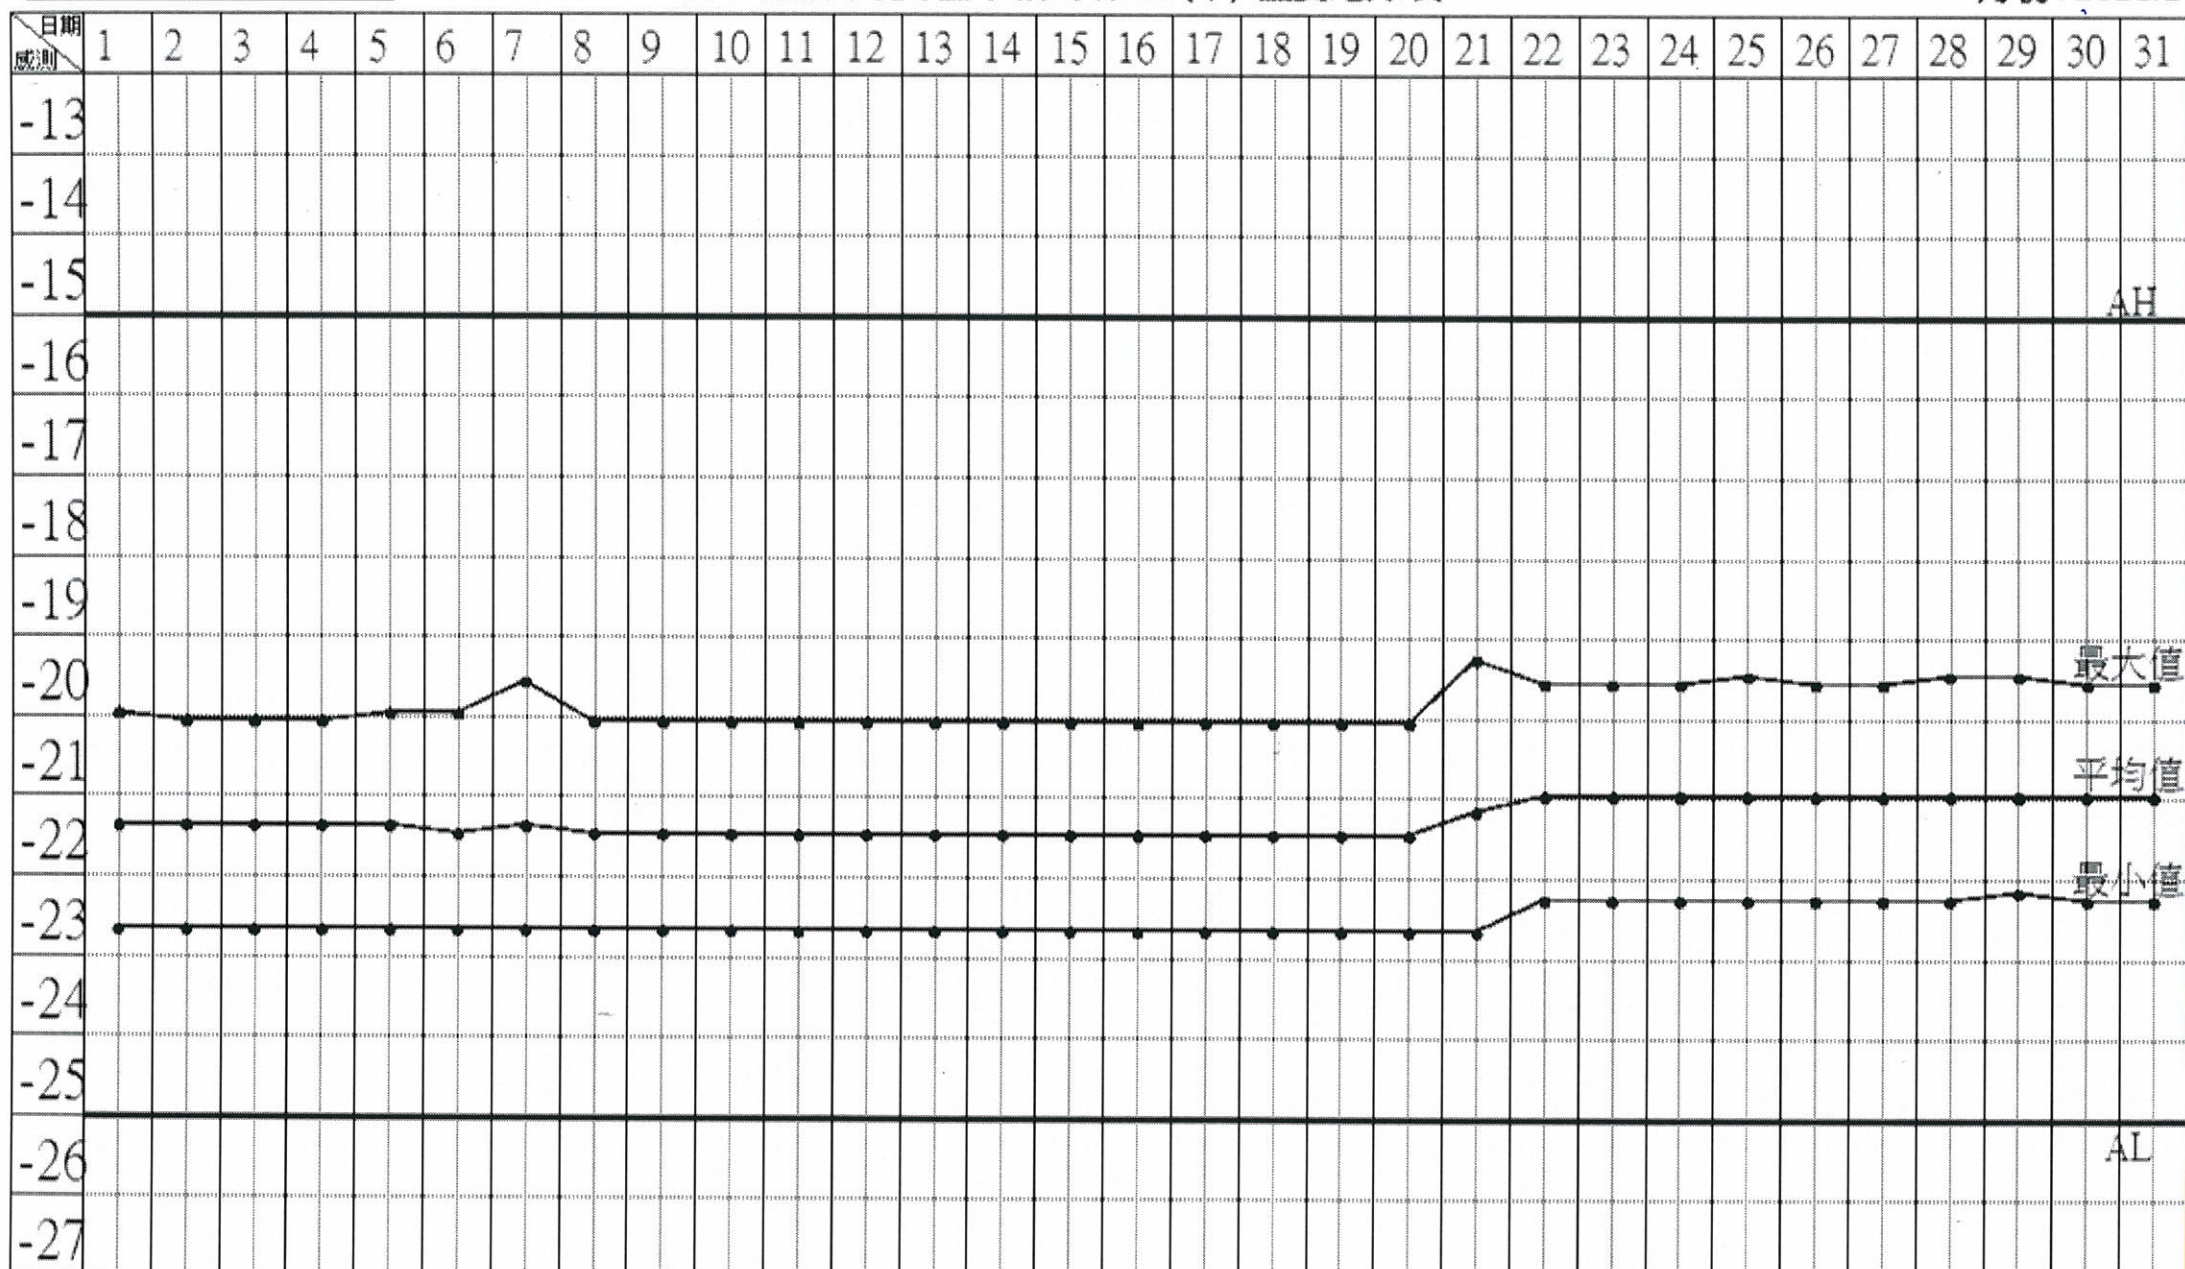

說明  
 1. 感測單位：  
 2. 黑點：運作正常, 白點：異常警報, 灰點：超出顯示範圍

備註  
 2021/05/21 進行冰箱校正及測試。