


604-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(下)溫度紀錄表

月份: 2022/2

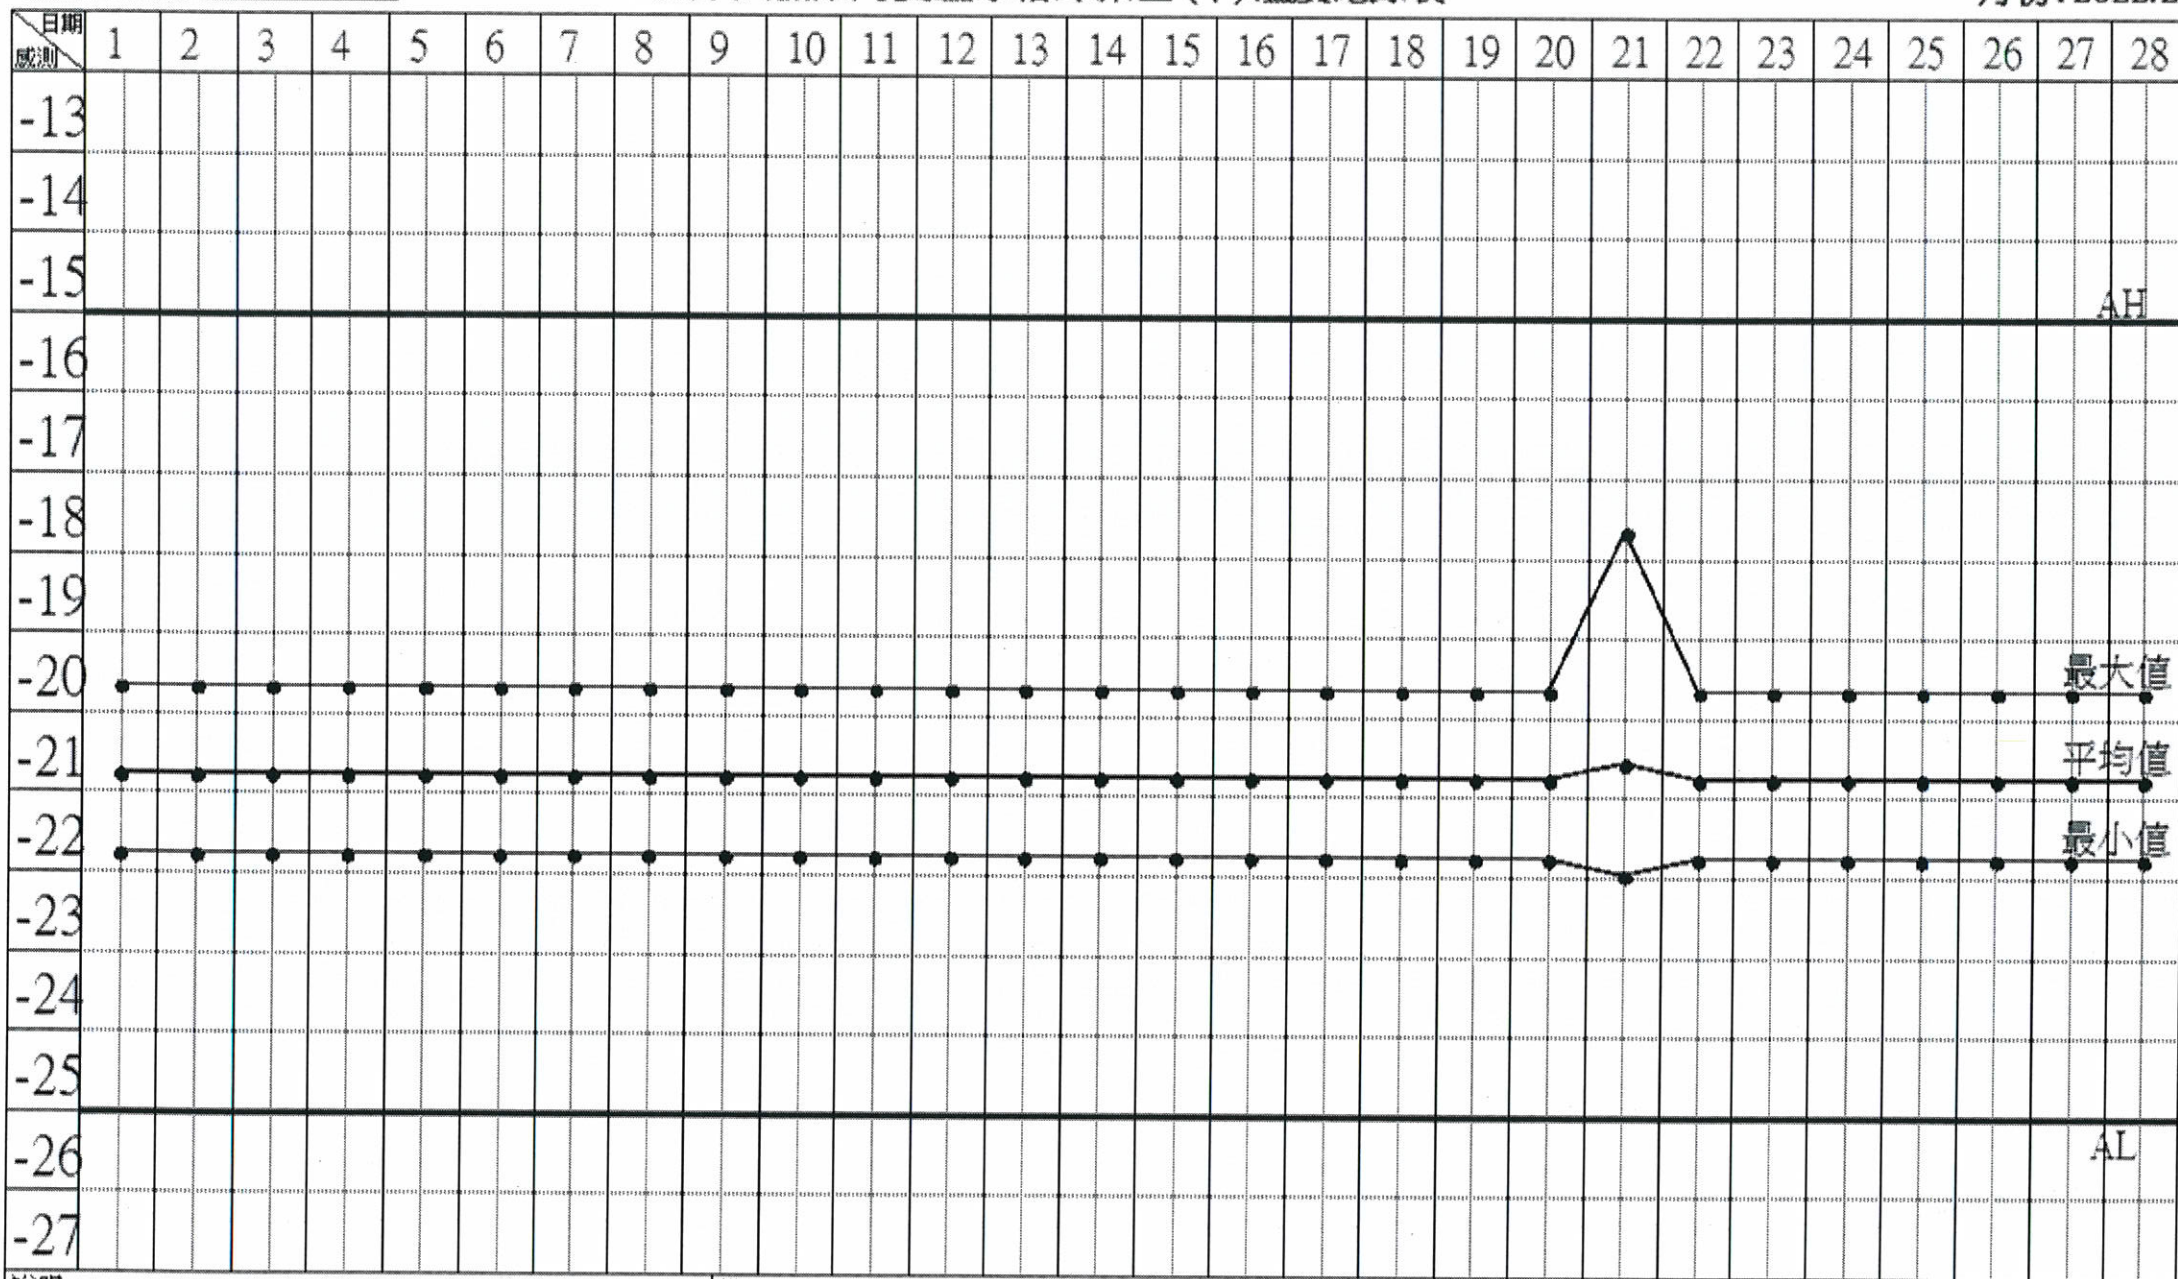

說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 7/21 601, 602 控制器異常, 把原置於603, 604 的冰塊移至601, 602 穩定溫度.

