

# 監控點圖表


監控點: 604-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(下)

時間區間: 2022-08-01 00:00 ~ 2022-08-31 23:59

最大值: -19.4 °C

最小值: -21.5 °C

平均值: -20.7 °C

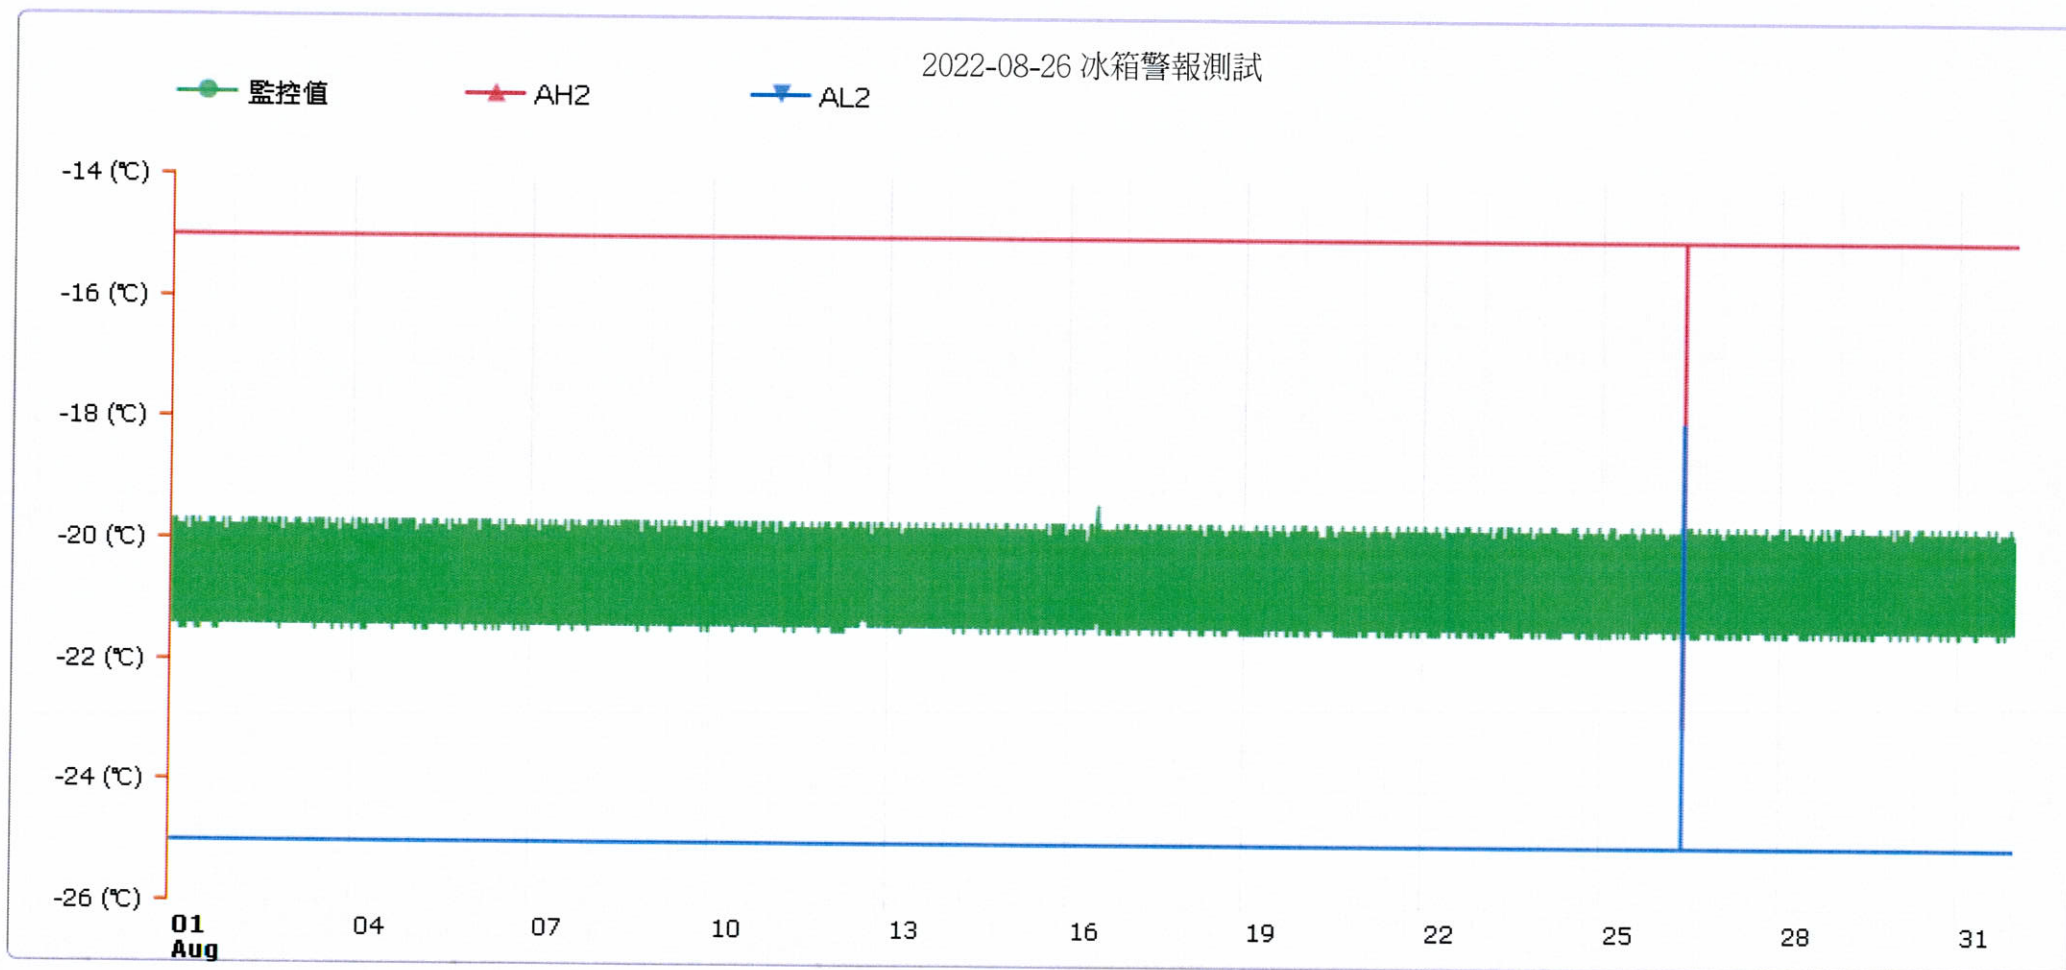

製表者: 邱彥榕

藥師邱彥榕  
藥字033885號

單位主管:

王平宇  
藥學部股長