


605-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(上)溫度紀錄表

月份: 2021/8

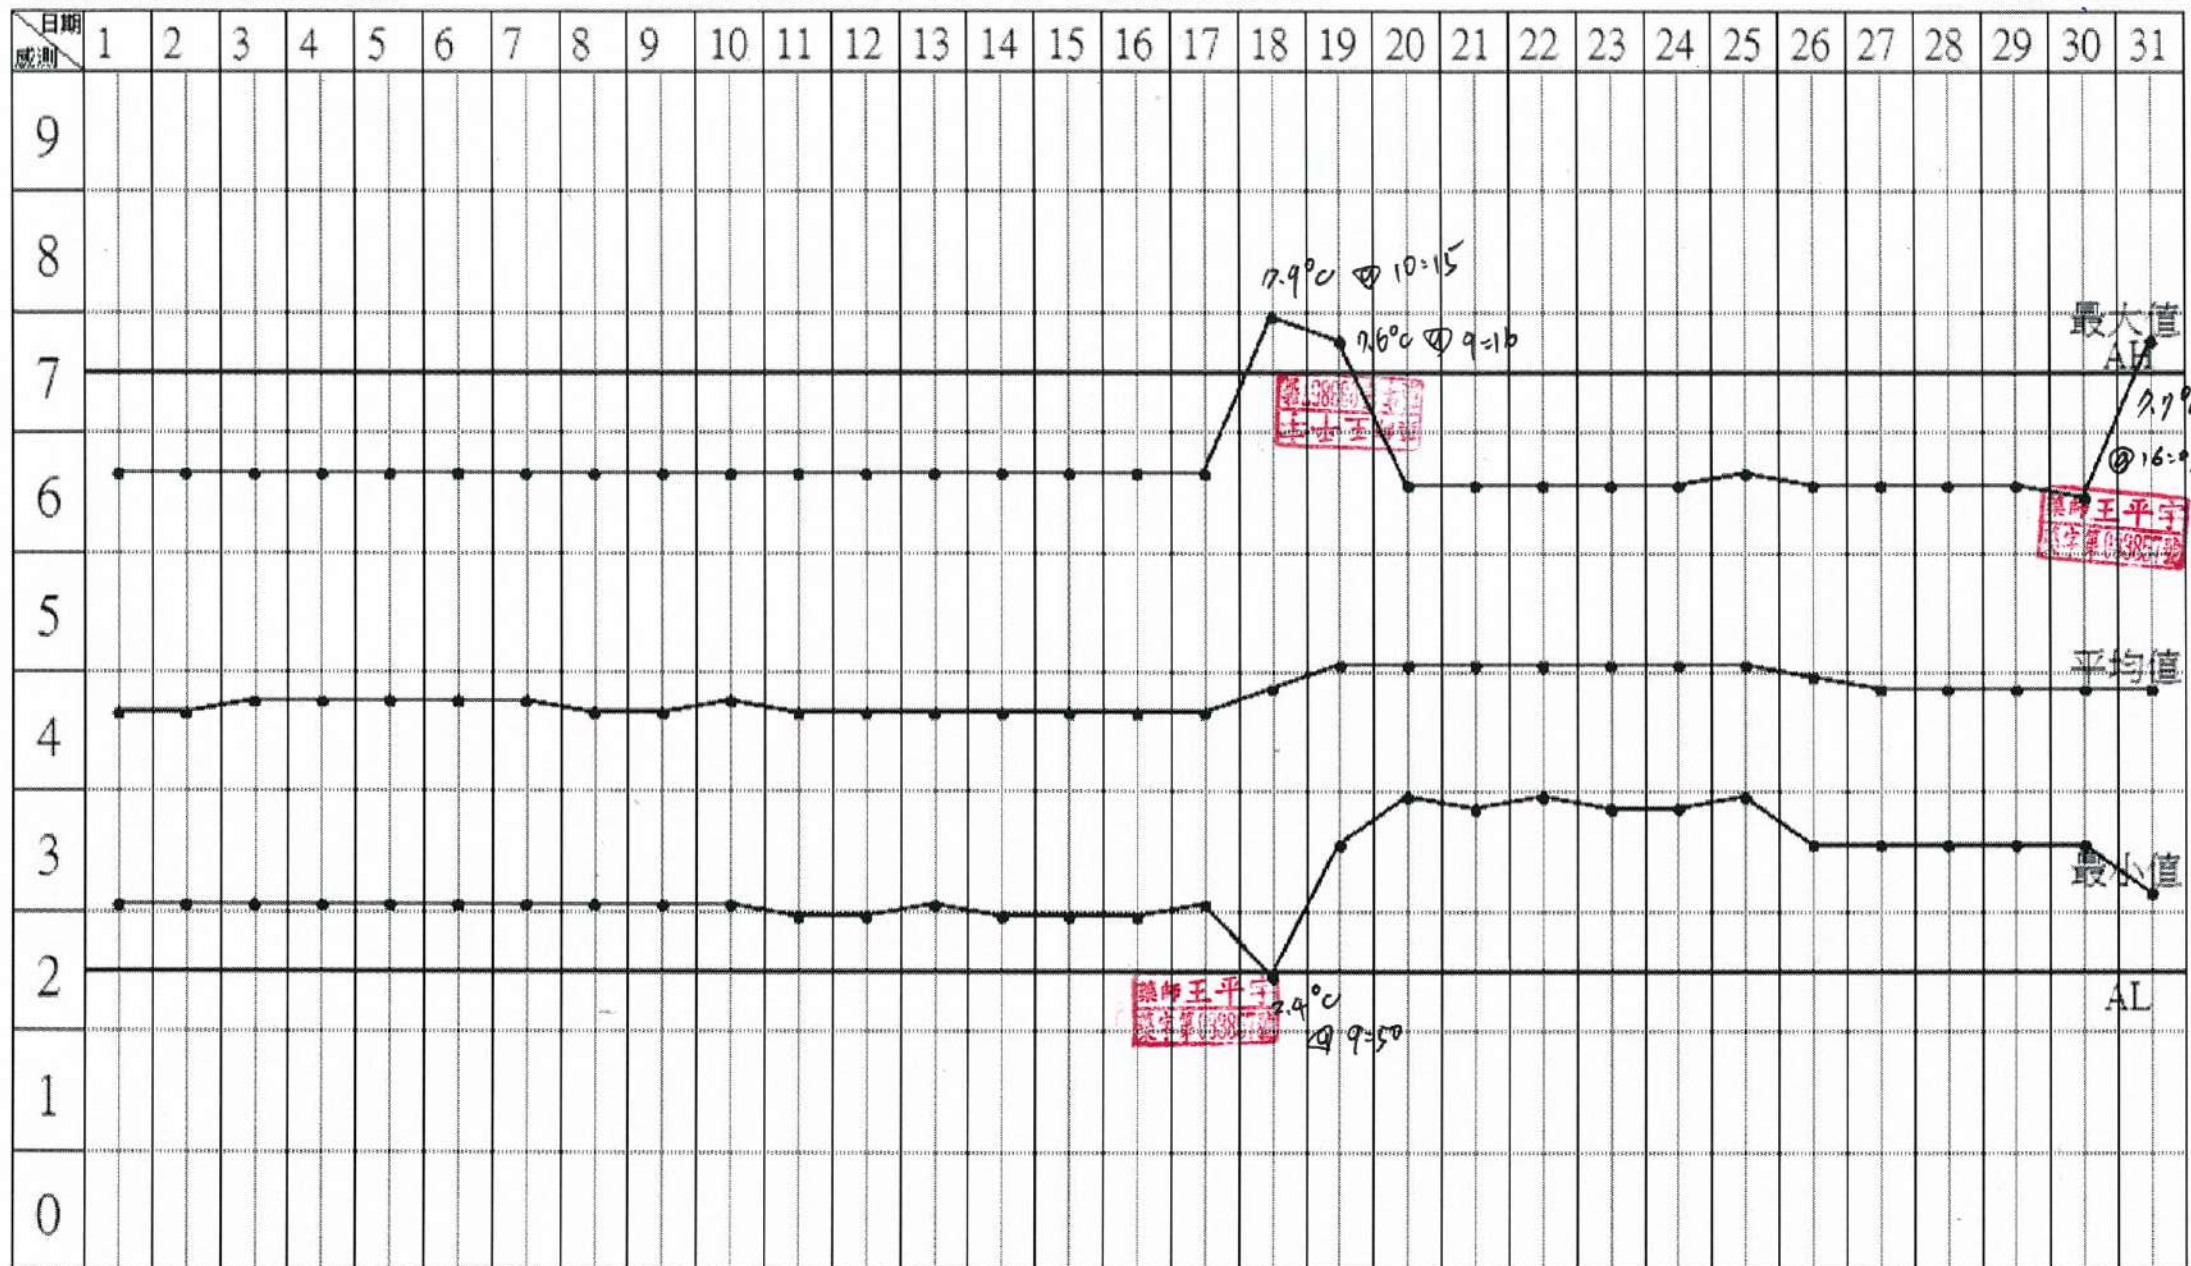


說明
 1. 感測單位：
 2. 黑點：運作正常，白點：異常警報，灰點：超出顯示範圍

備註
 2021/8/18 廠商裝設新的冰箱警報感應器
 2021/8/19 試驗藥品發藥
 2021/8/31 調整冰箱內試驗藥品位置

曲線顏色說明 感測器 1 AH AL

605-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(上)

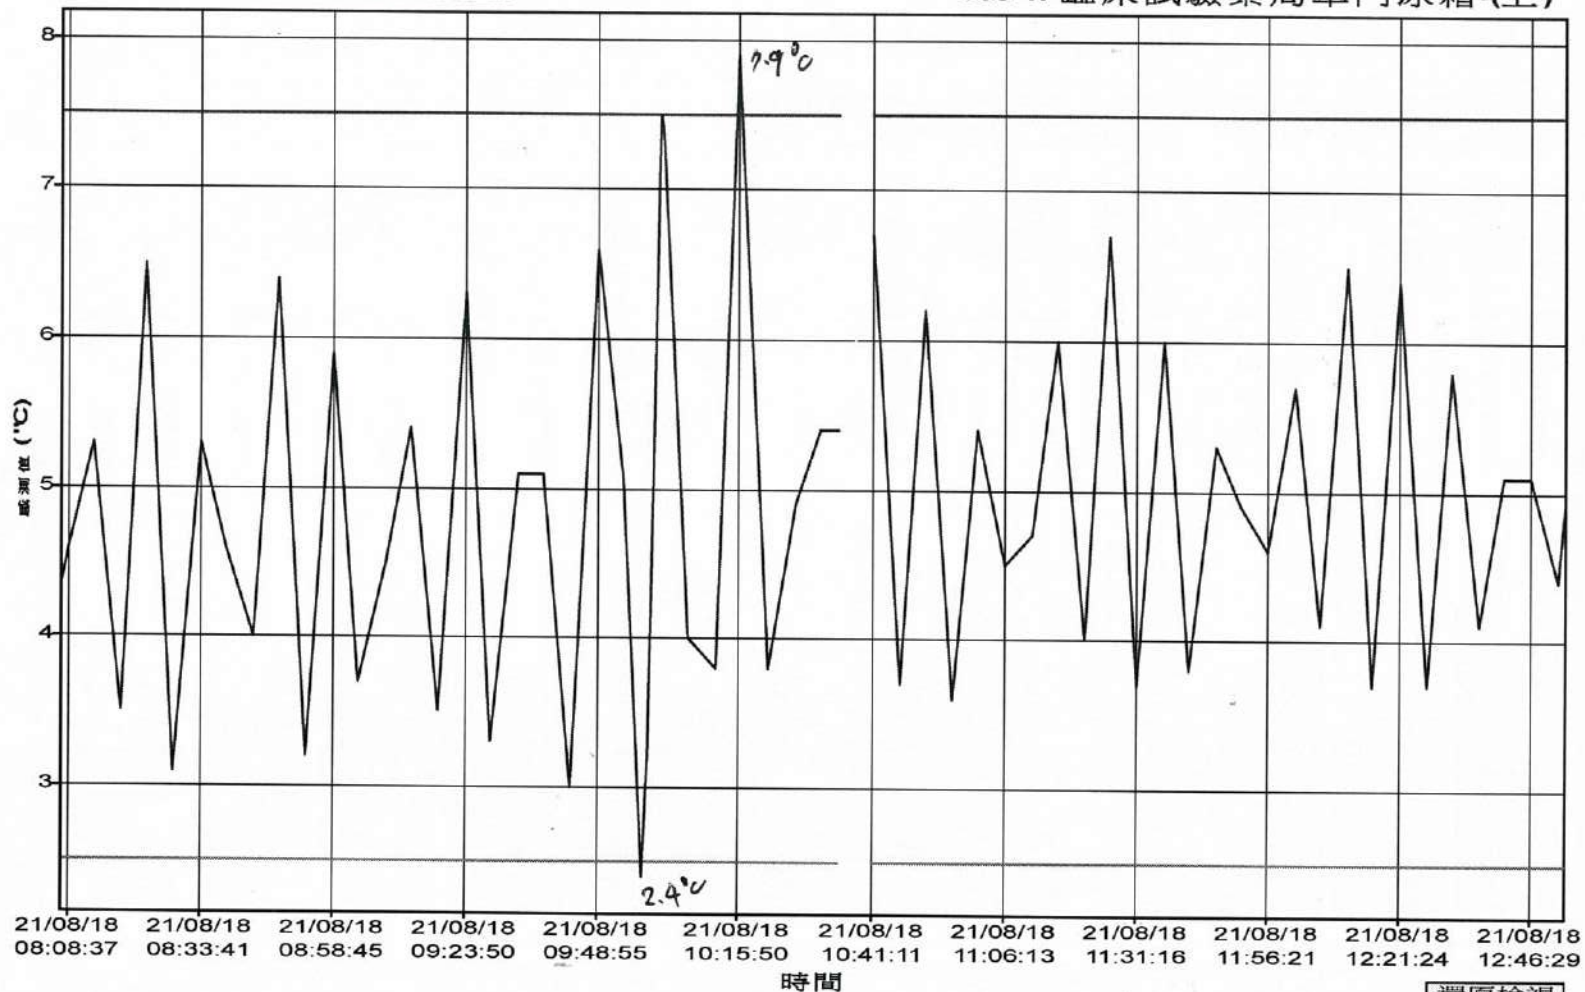


還原檢視



備註 無

曲線顏色說明 感測器 1 AH AL

605-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(上)

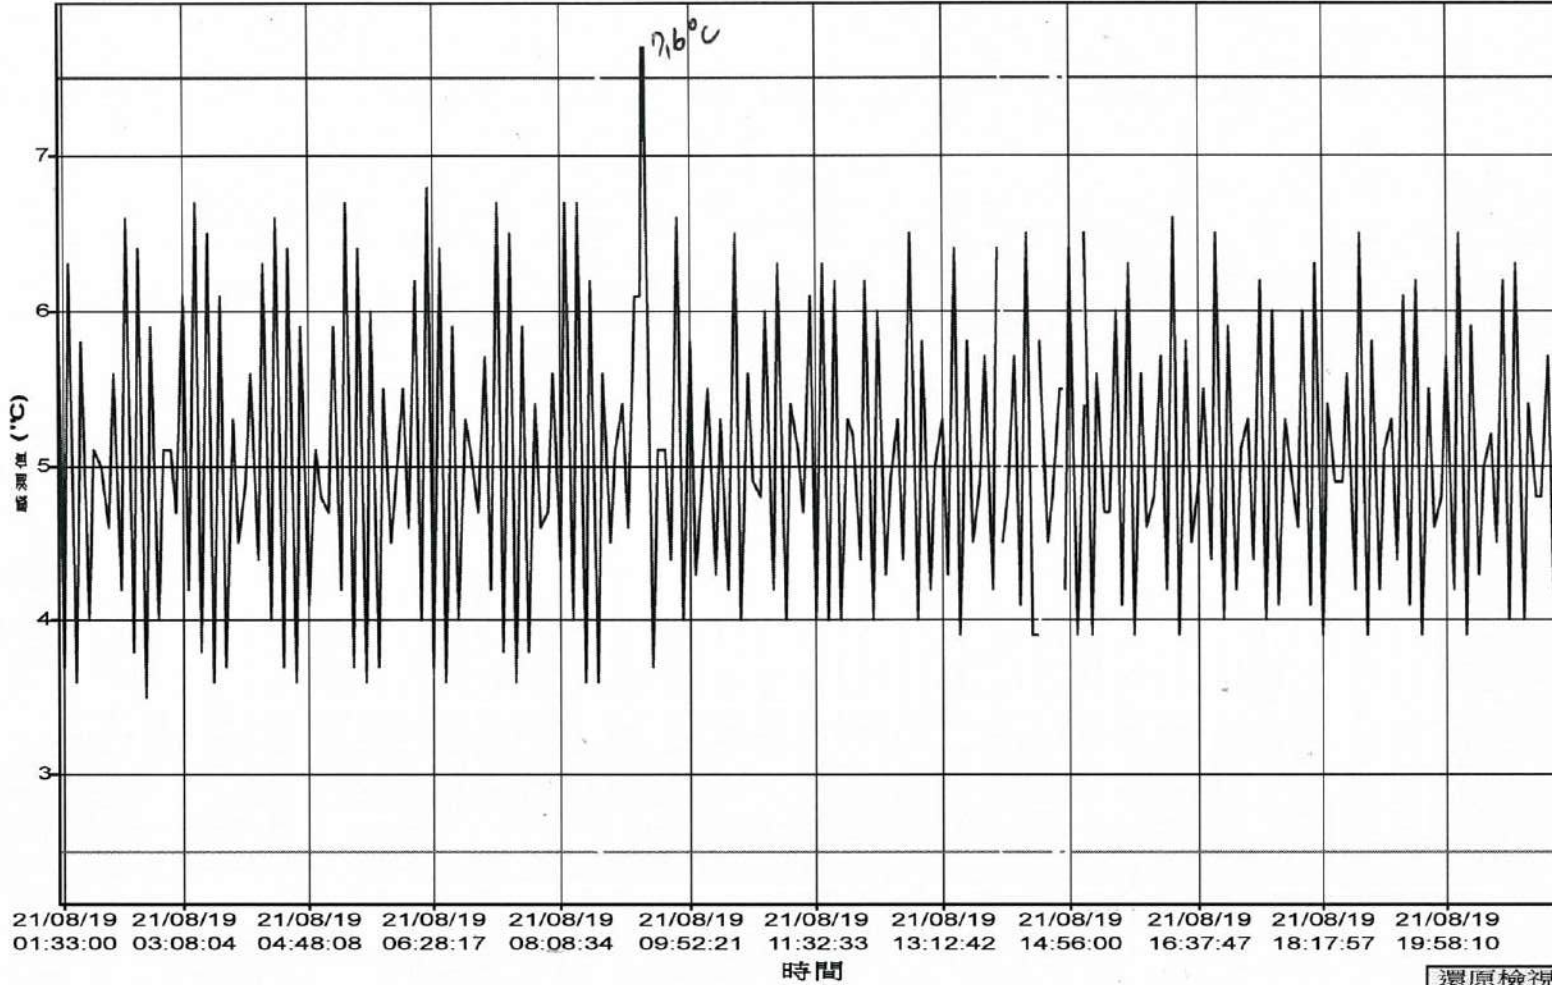


備註
無



曲線顏色說明 感測器 1 AH AL

605-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(上)

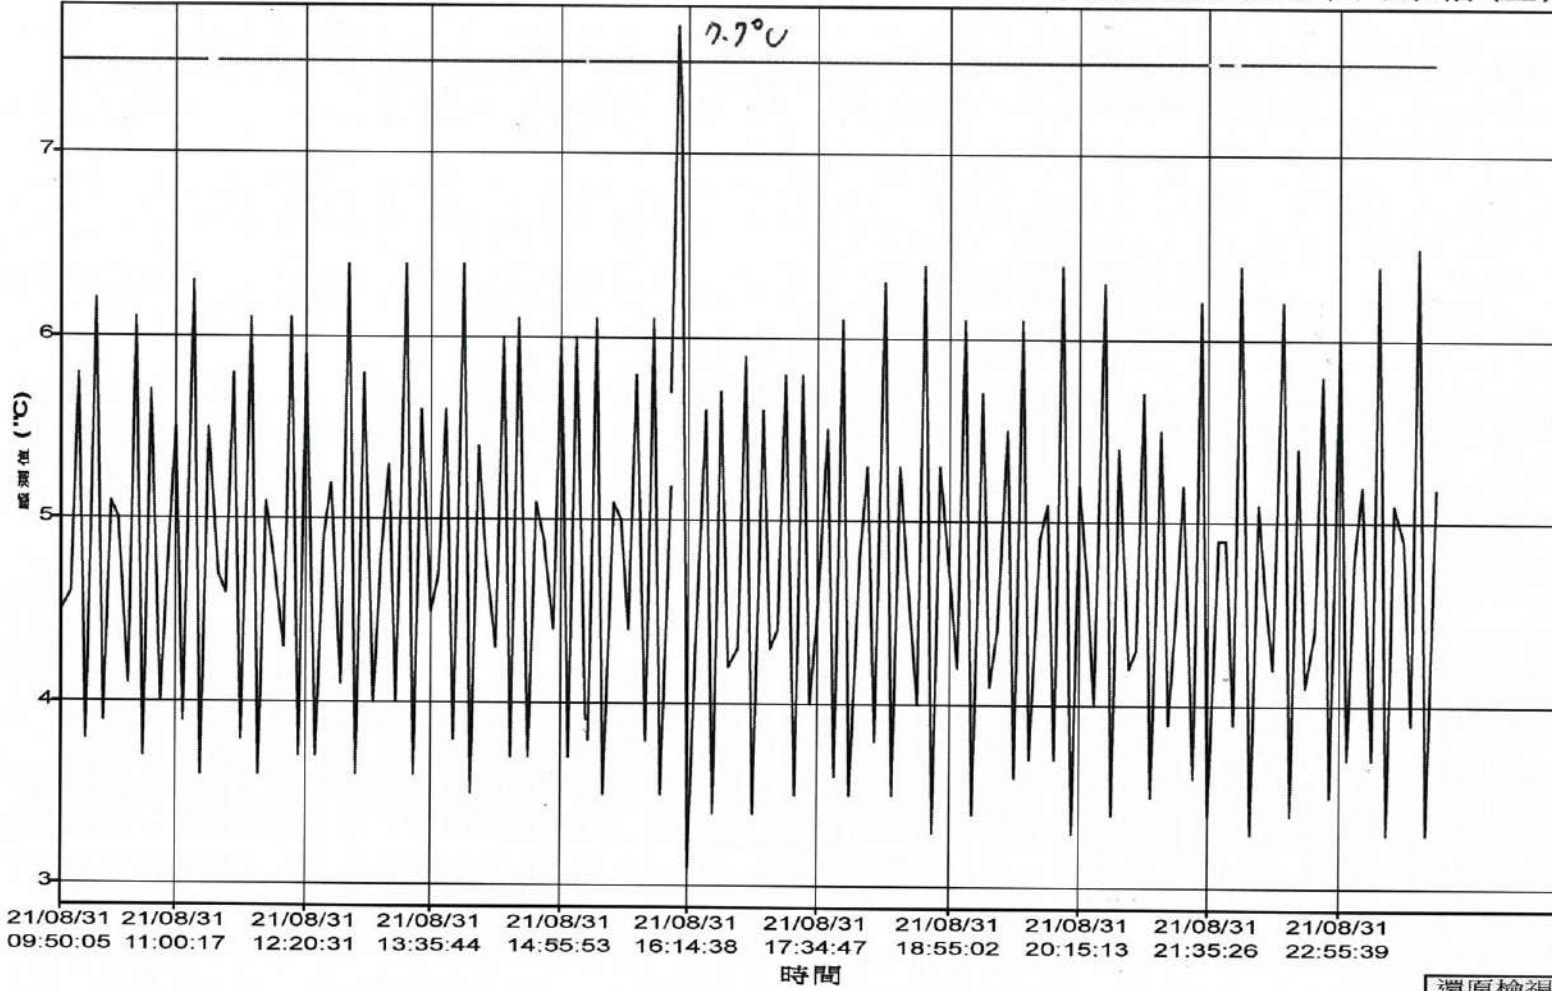

還原檢視

備註
無

藥師王平宇
藥師 133035

藥師
邱彥榕
字 133035