


606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/4

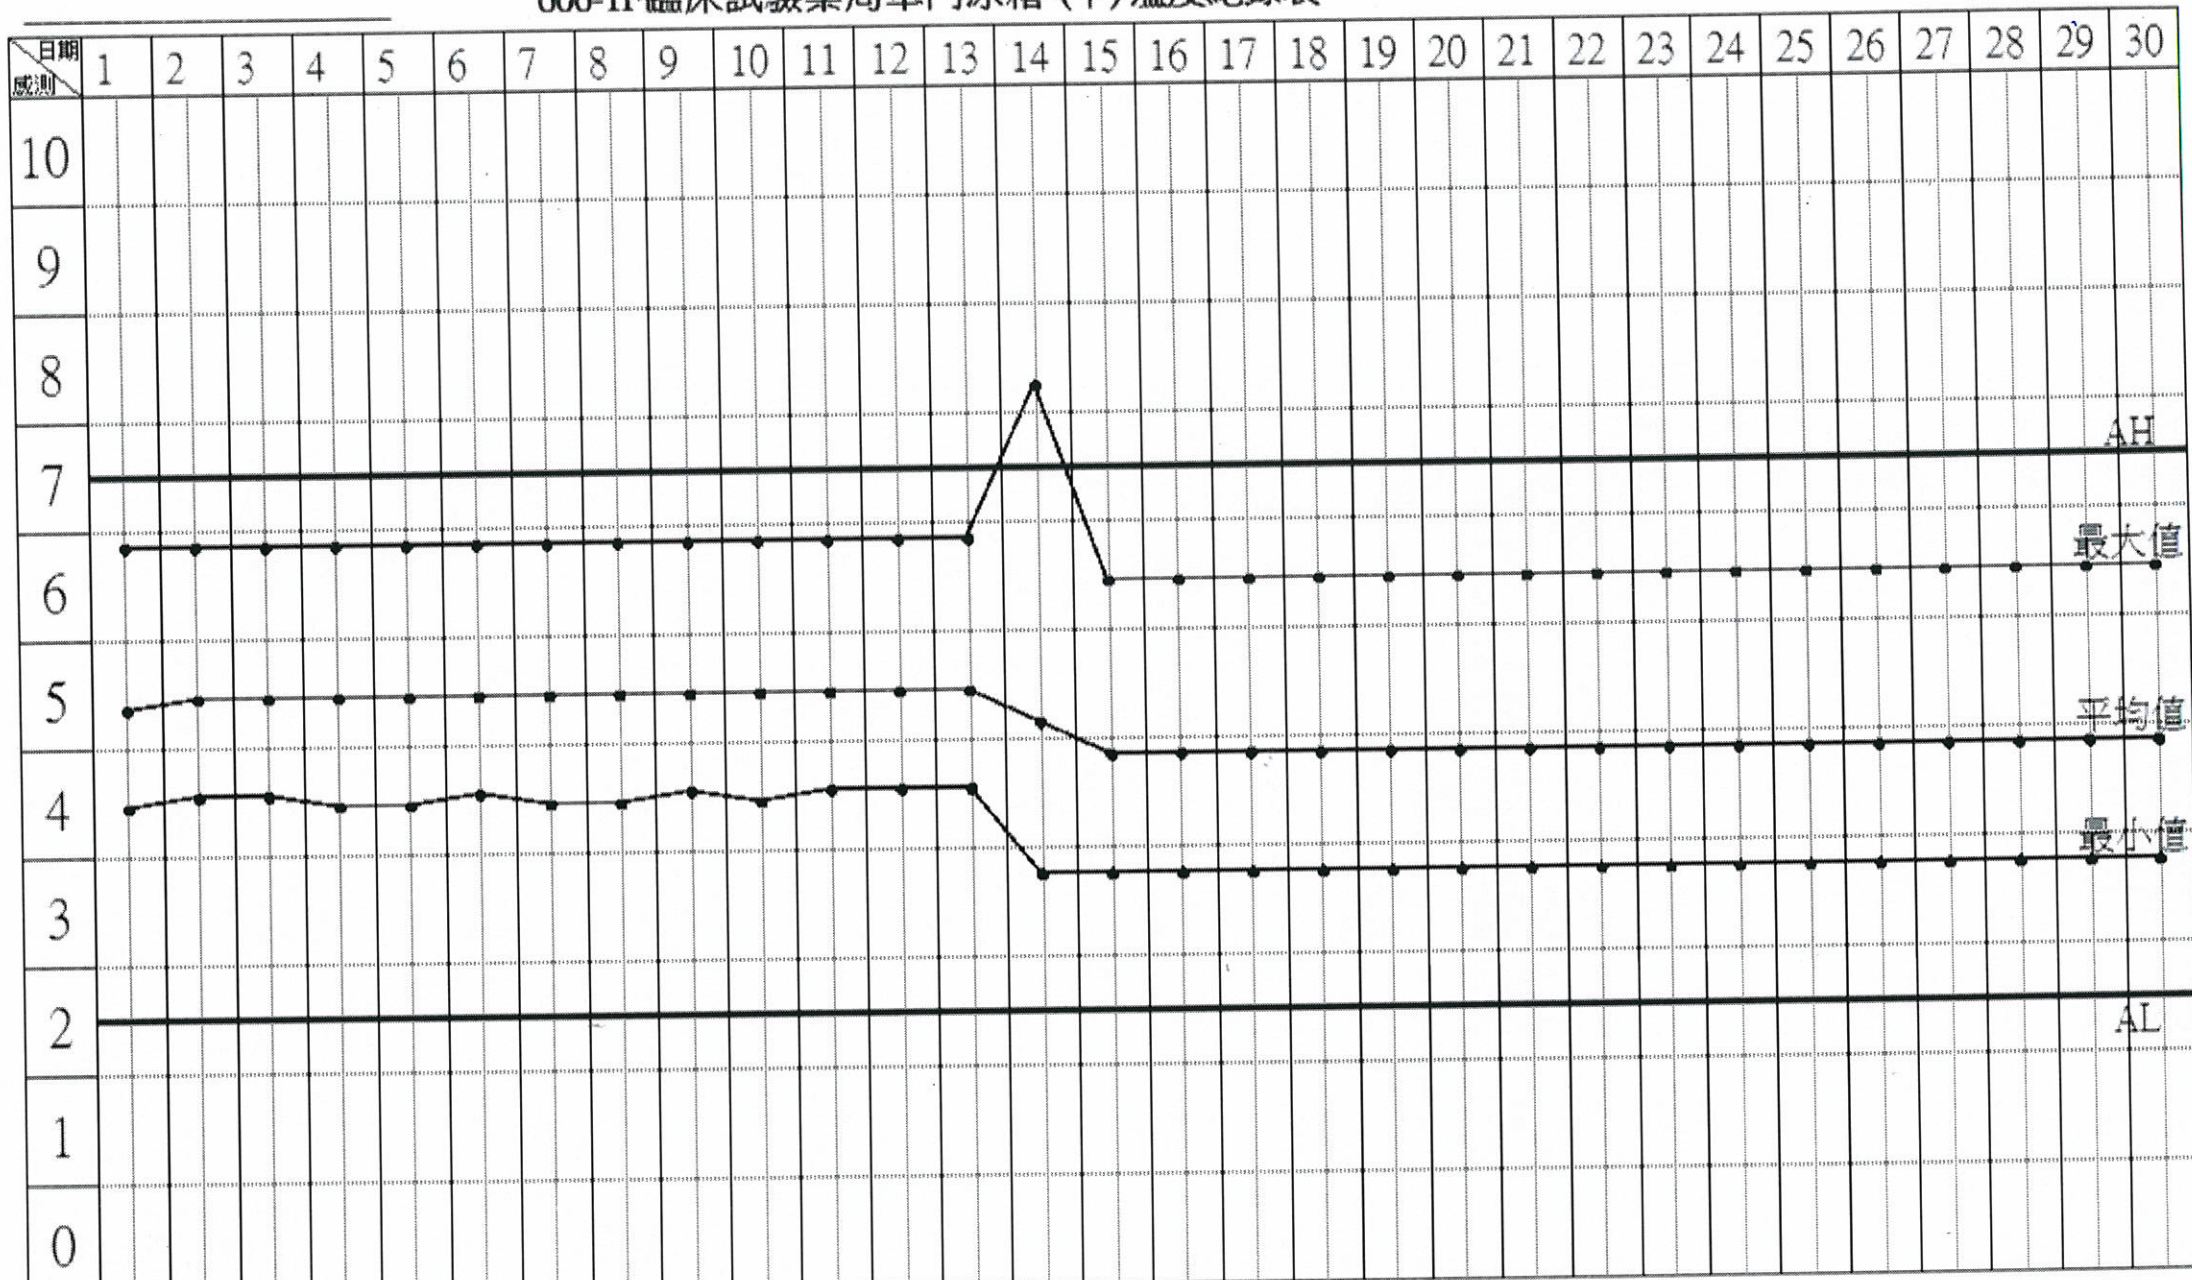

說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 2021/04/14 安裝-80°C冰箱, 短暫拔除插頭, 調整壓縮機啟動時間。