


606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/5

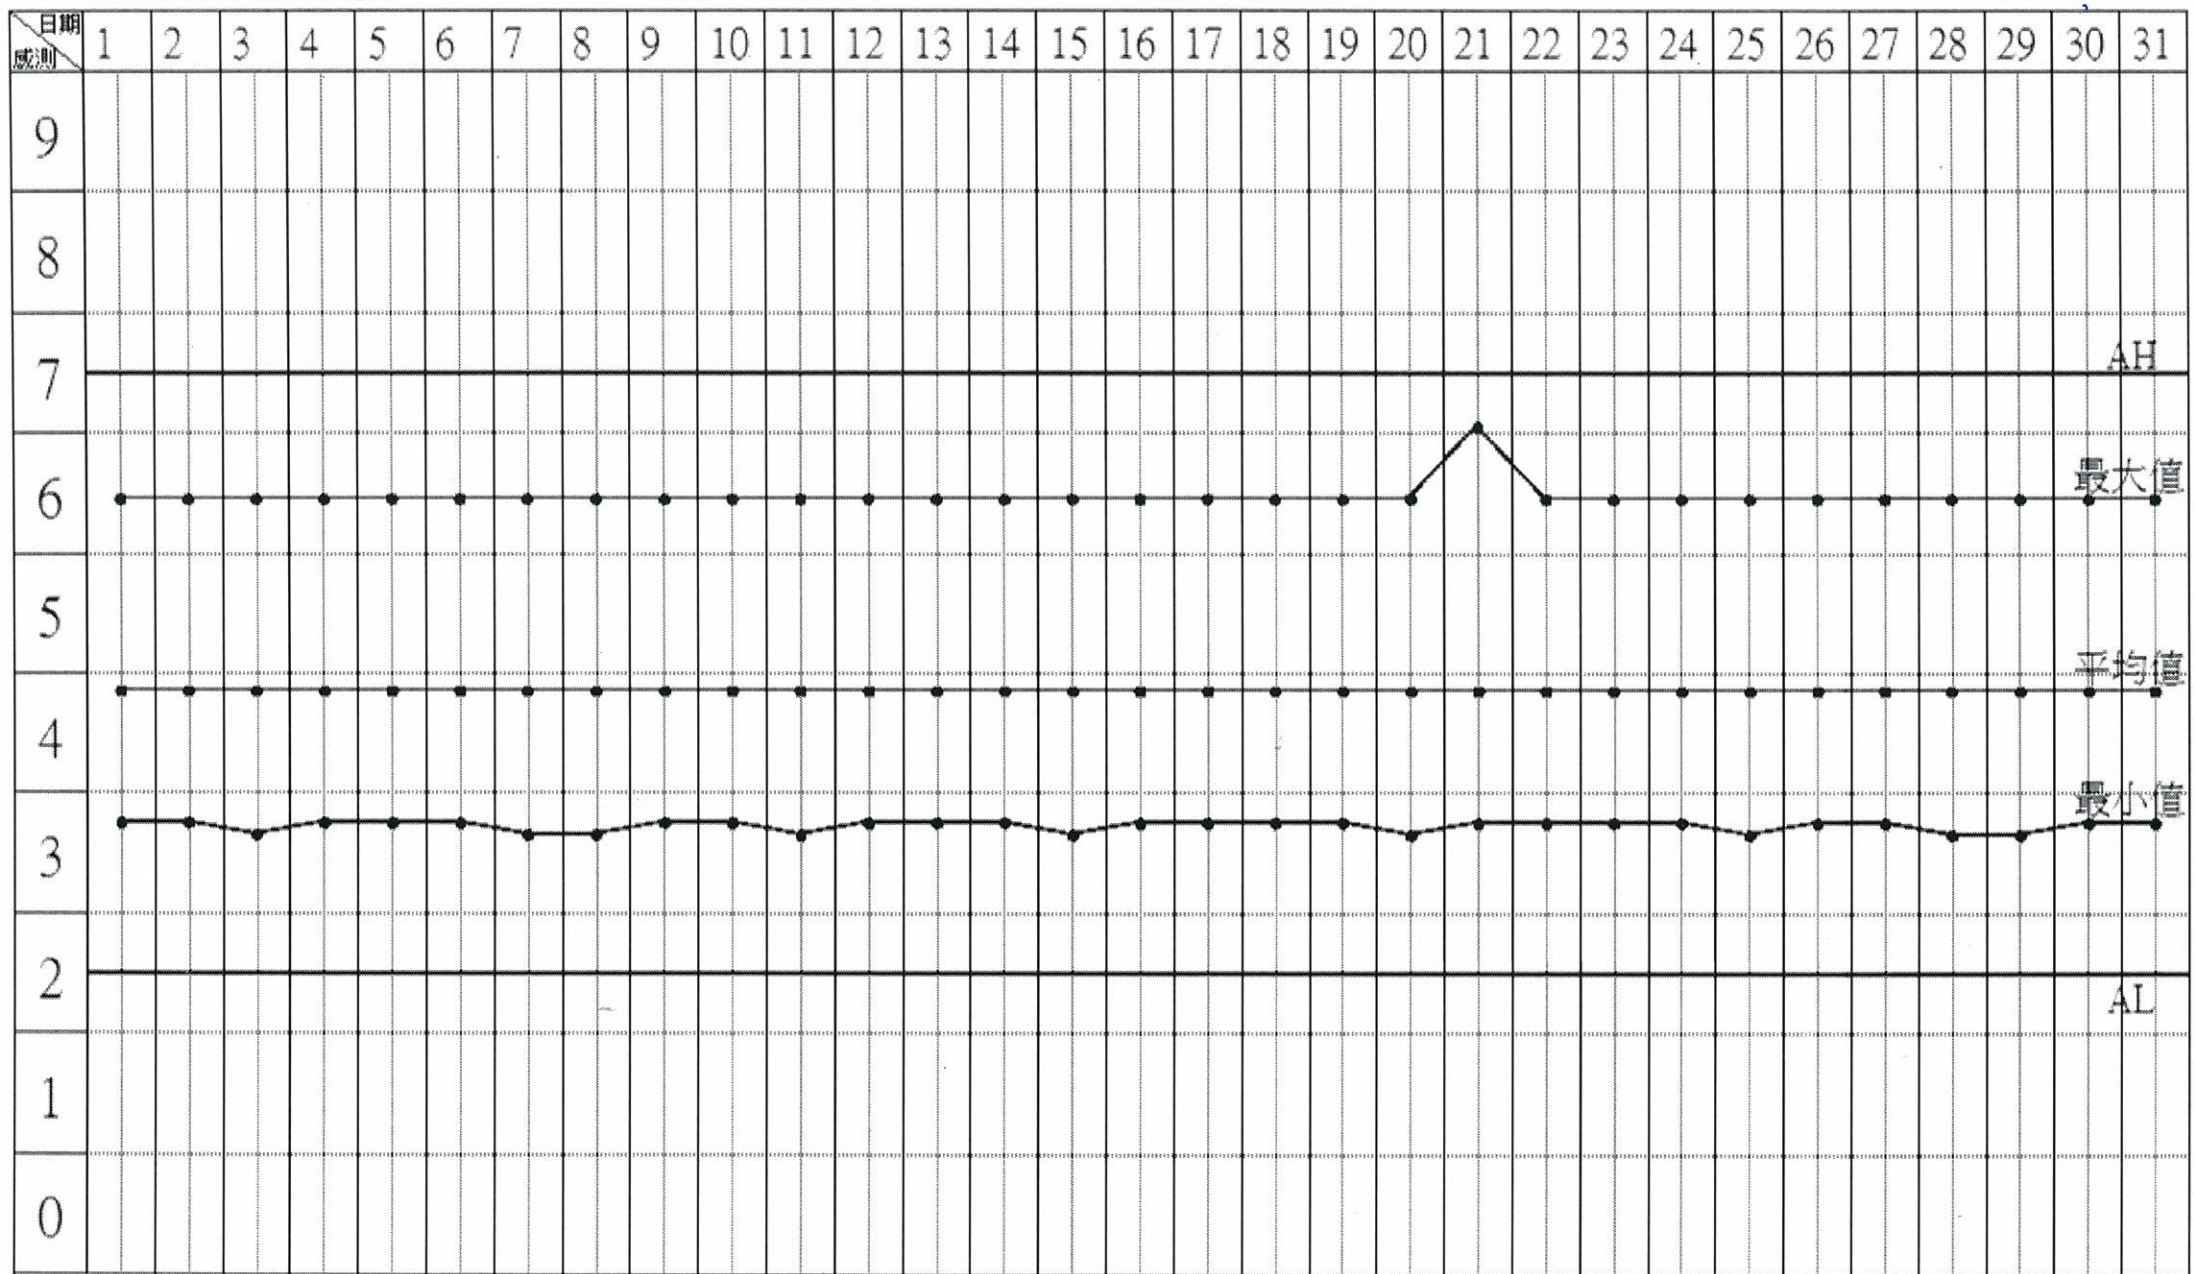

AH

最大值

平均值

最小值

AL

說明  
 1. 感測單位:  
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註  
 2021/05/21 進行冰箱校正及測試。