


606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/8

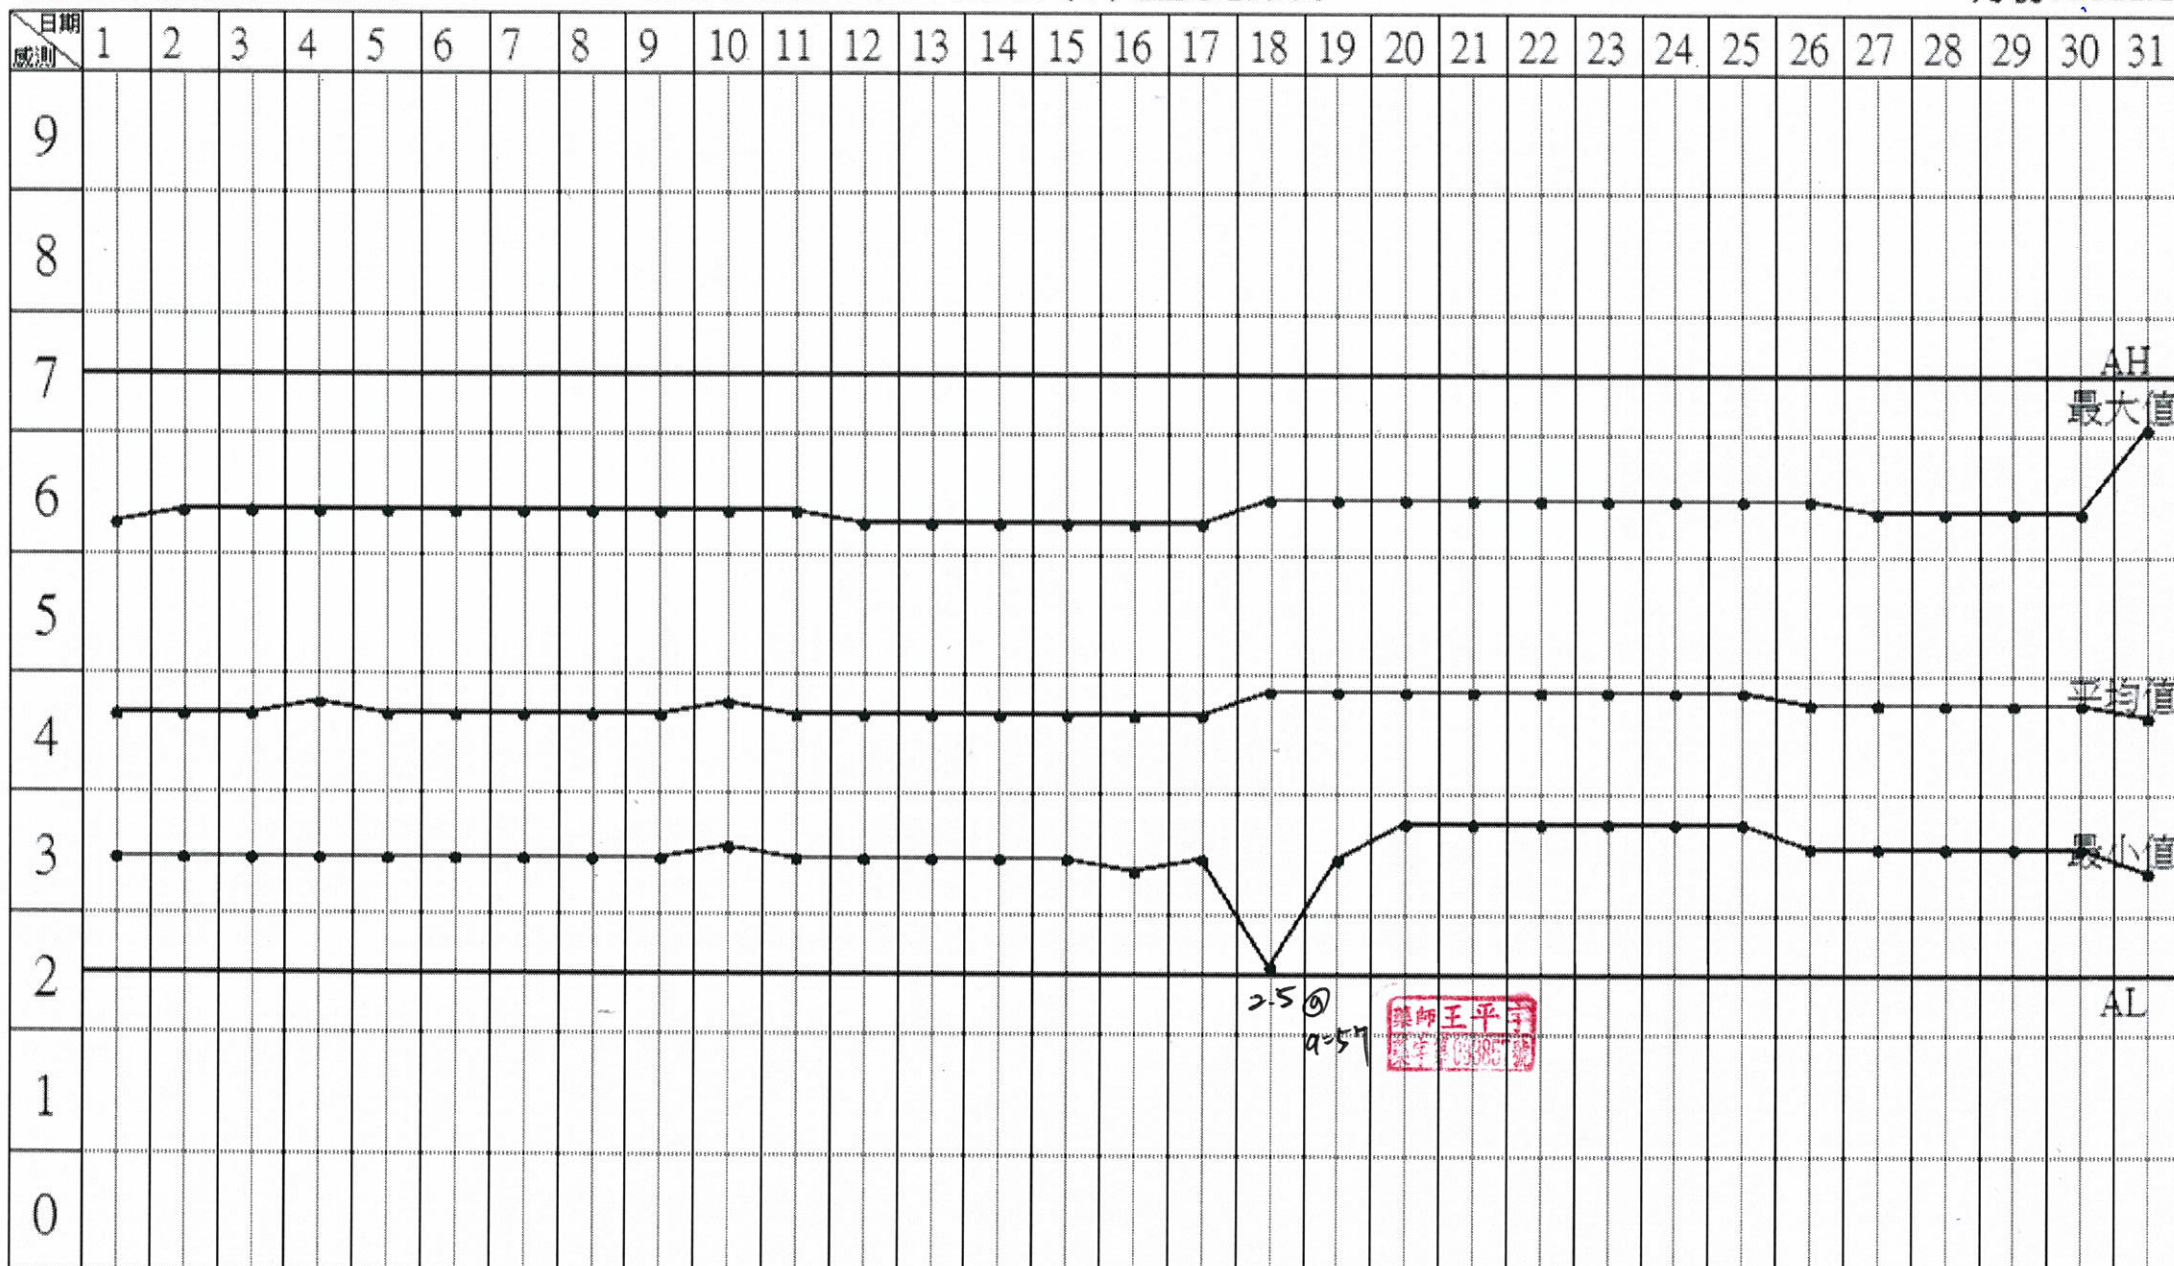


說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 2021/8/18 廠商裝設新的冰箱警報感應器
 2021/8/31 調整冰箱內試驗藥品位置

曲線顏色說明 感測器 1 AH AL

606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)

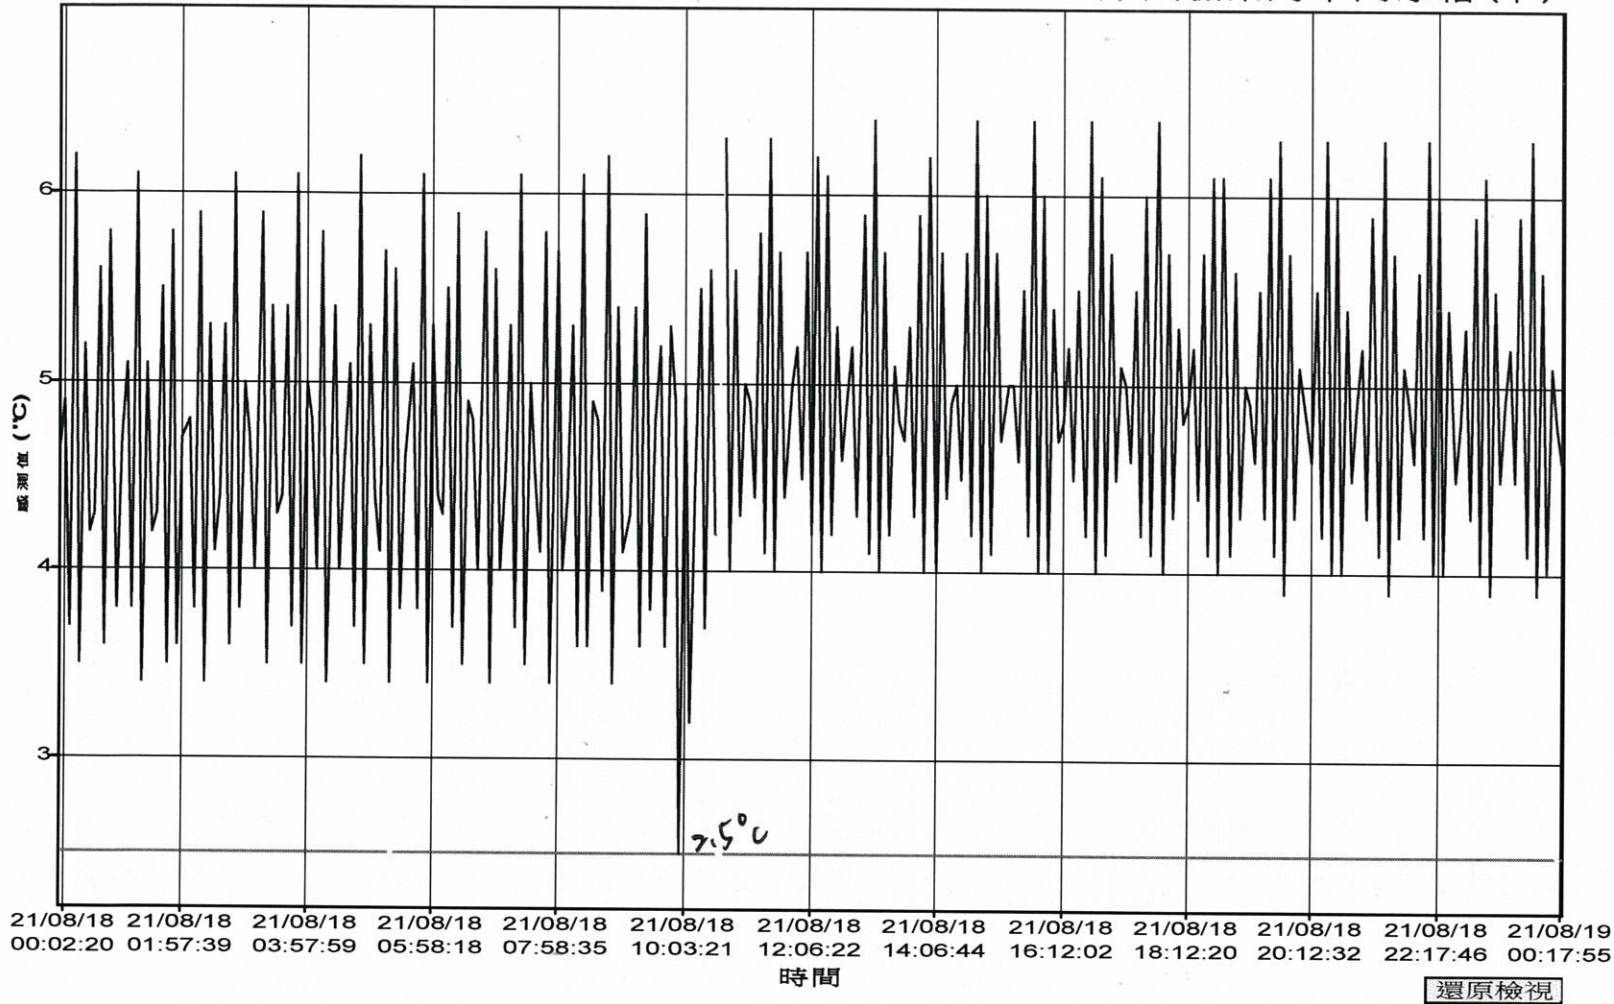

備註
無

藥師王平宇
探字第030019

藥師
邱彥榕
字10838058