

監控點圖表


監控點: 606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)

時間區間: 2022-04-01 00:00 ~ 2022-04-30 23:59

最大值: 5.1 °C

最小值: 3.7 °C

平均值: 4.3 °C

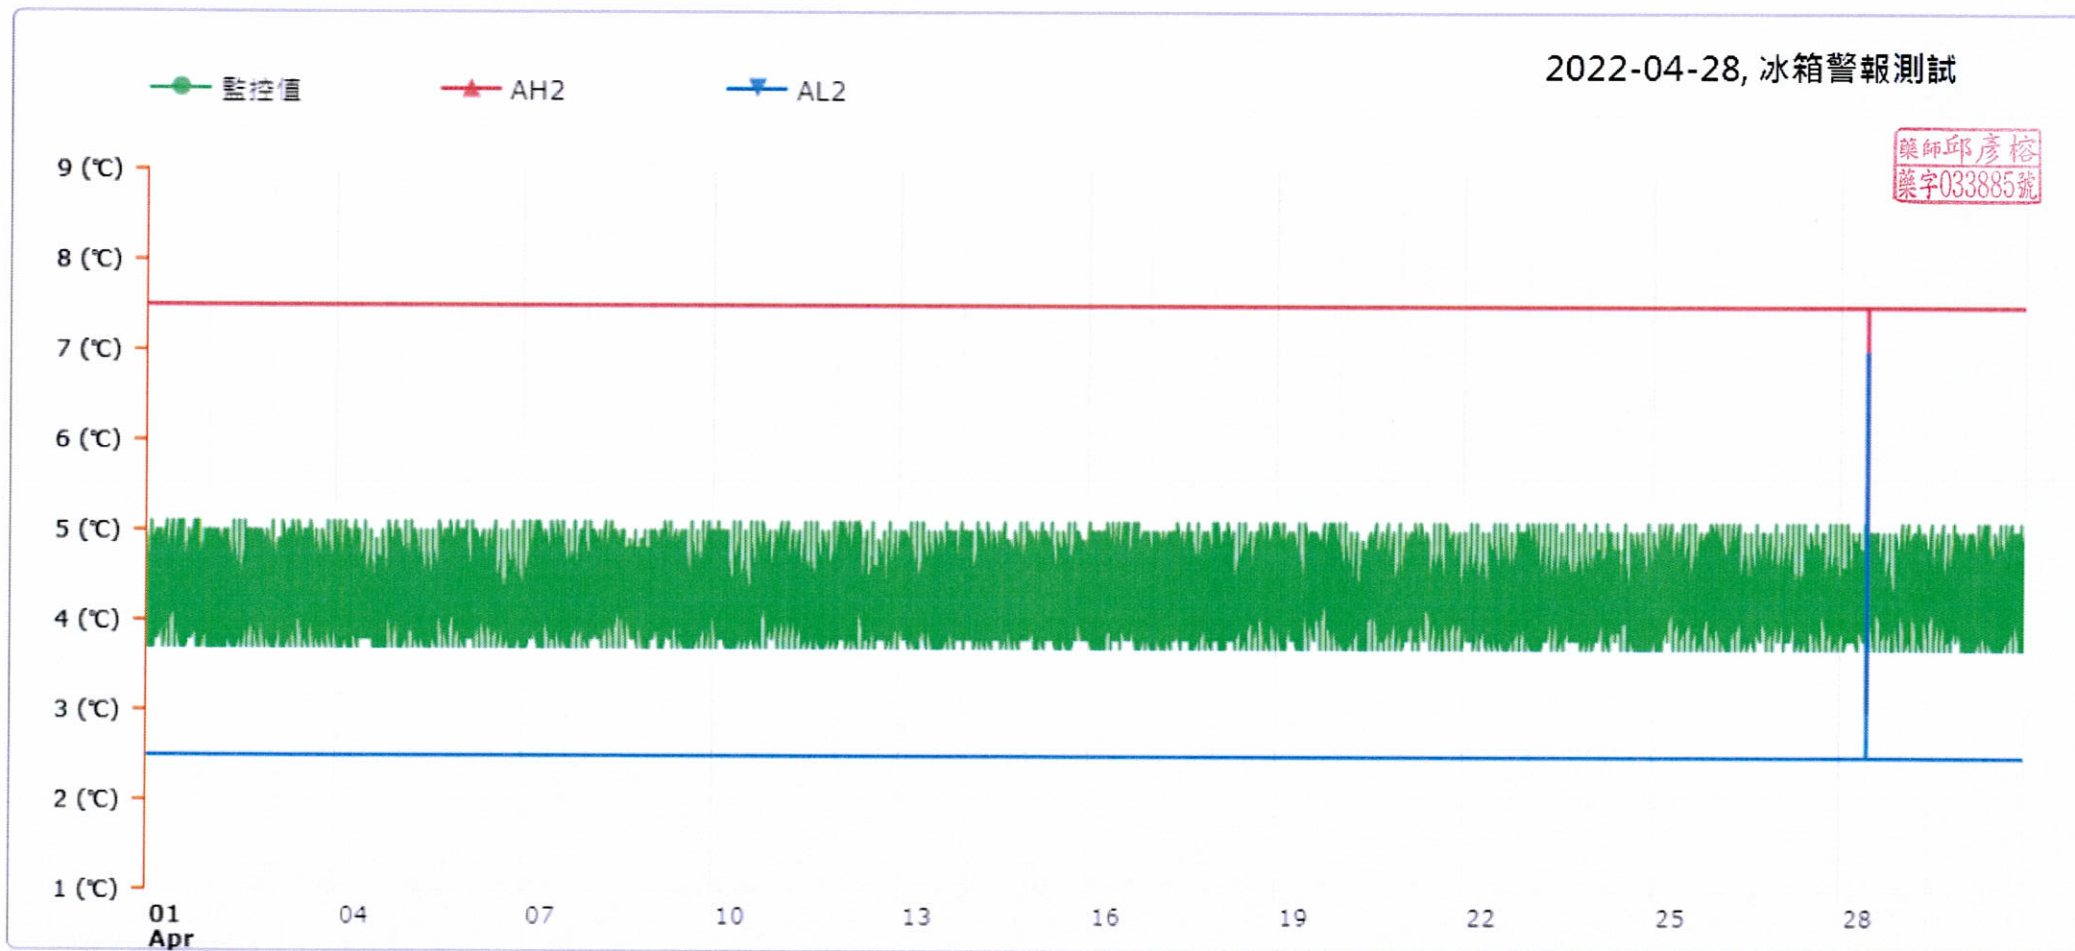

製表者: 邱彥榕

藥師邱彥榕
藥字033885號

單位主管: 王平宇

藥學部股長
王平宇