

監控點圖表


監控點: 606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)

時間區間: 2022-05-01 00:00 ~ 2022-05-31 23:59

最大值: 8.6 °C

最小值: 3.1 °C

平均值: 4.2 °C

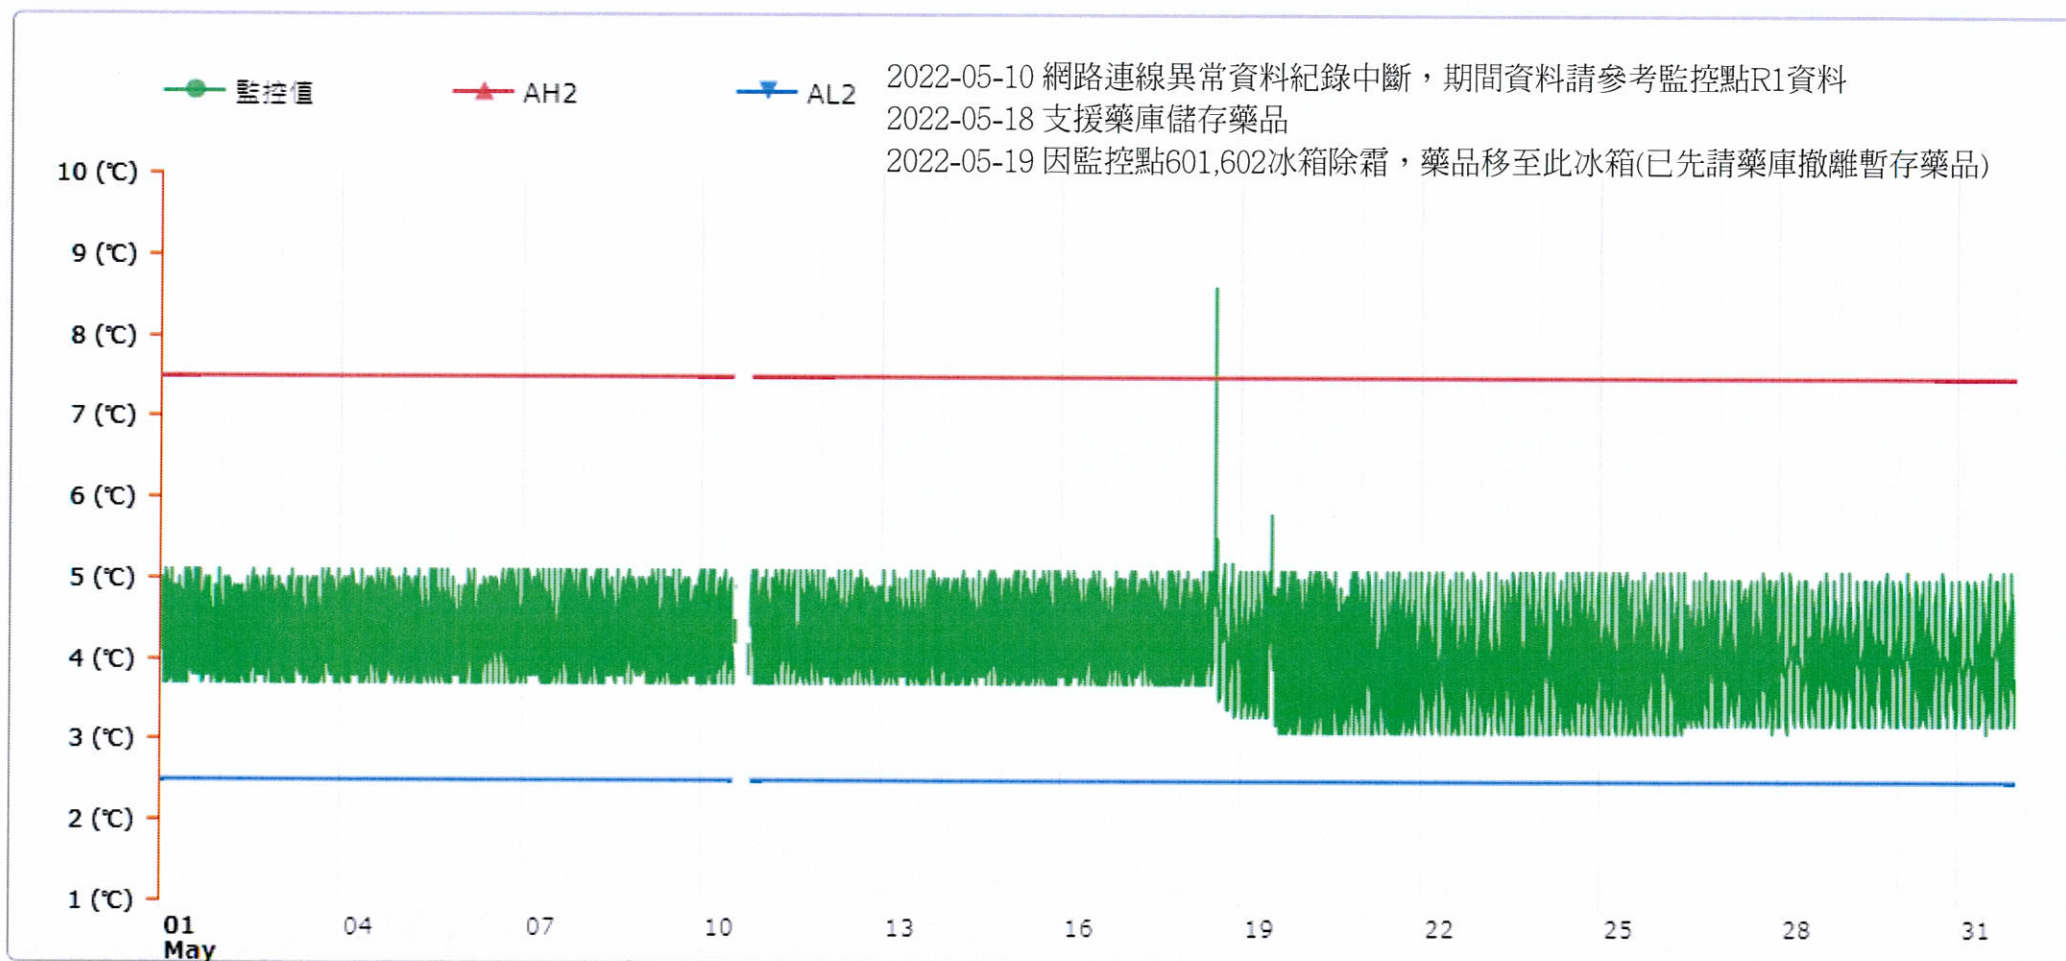

製表者: 邱彥榕

藥師邱彥榕
藥字033885號

單位主管:

王平宇
藥學部股長