



607-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱(上)溫度紀錄表

月份: 2021/4

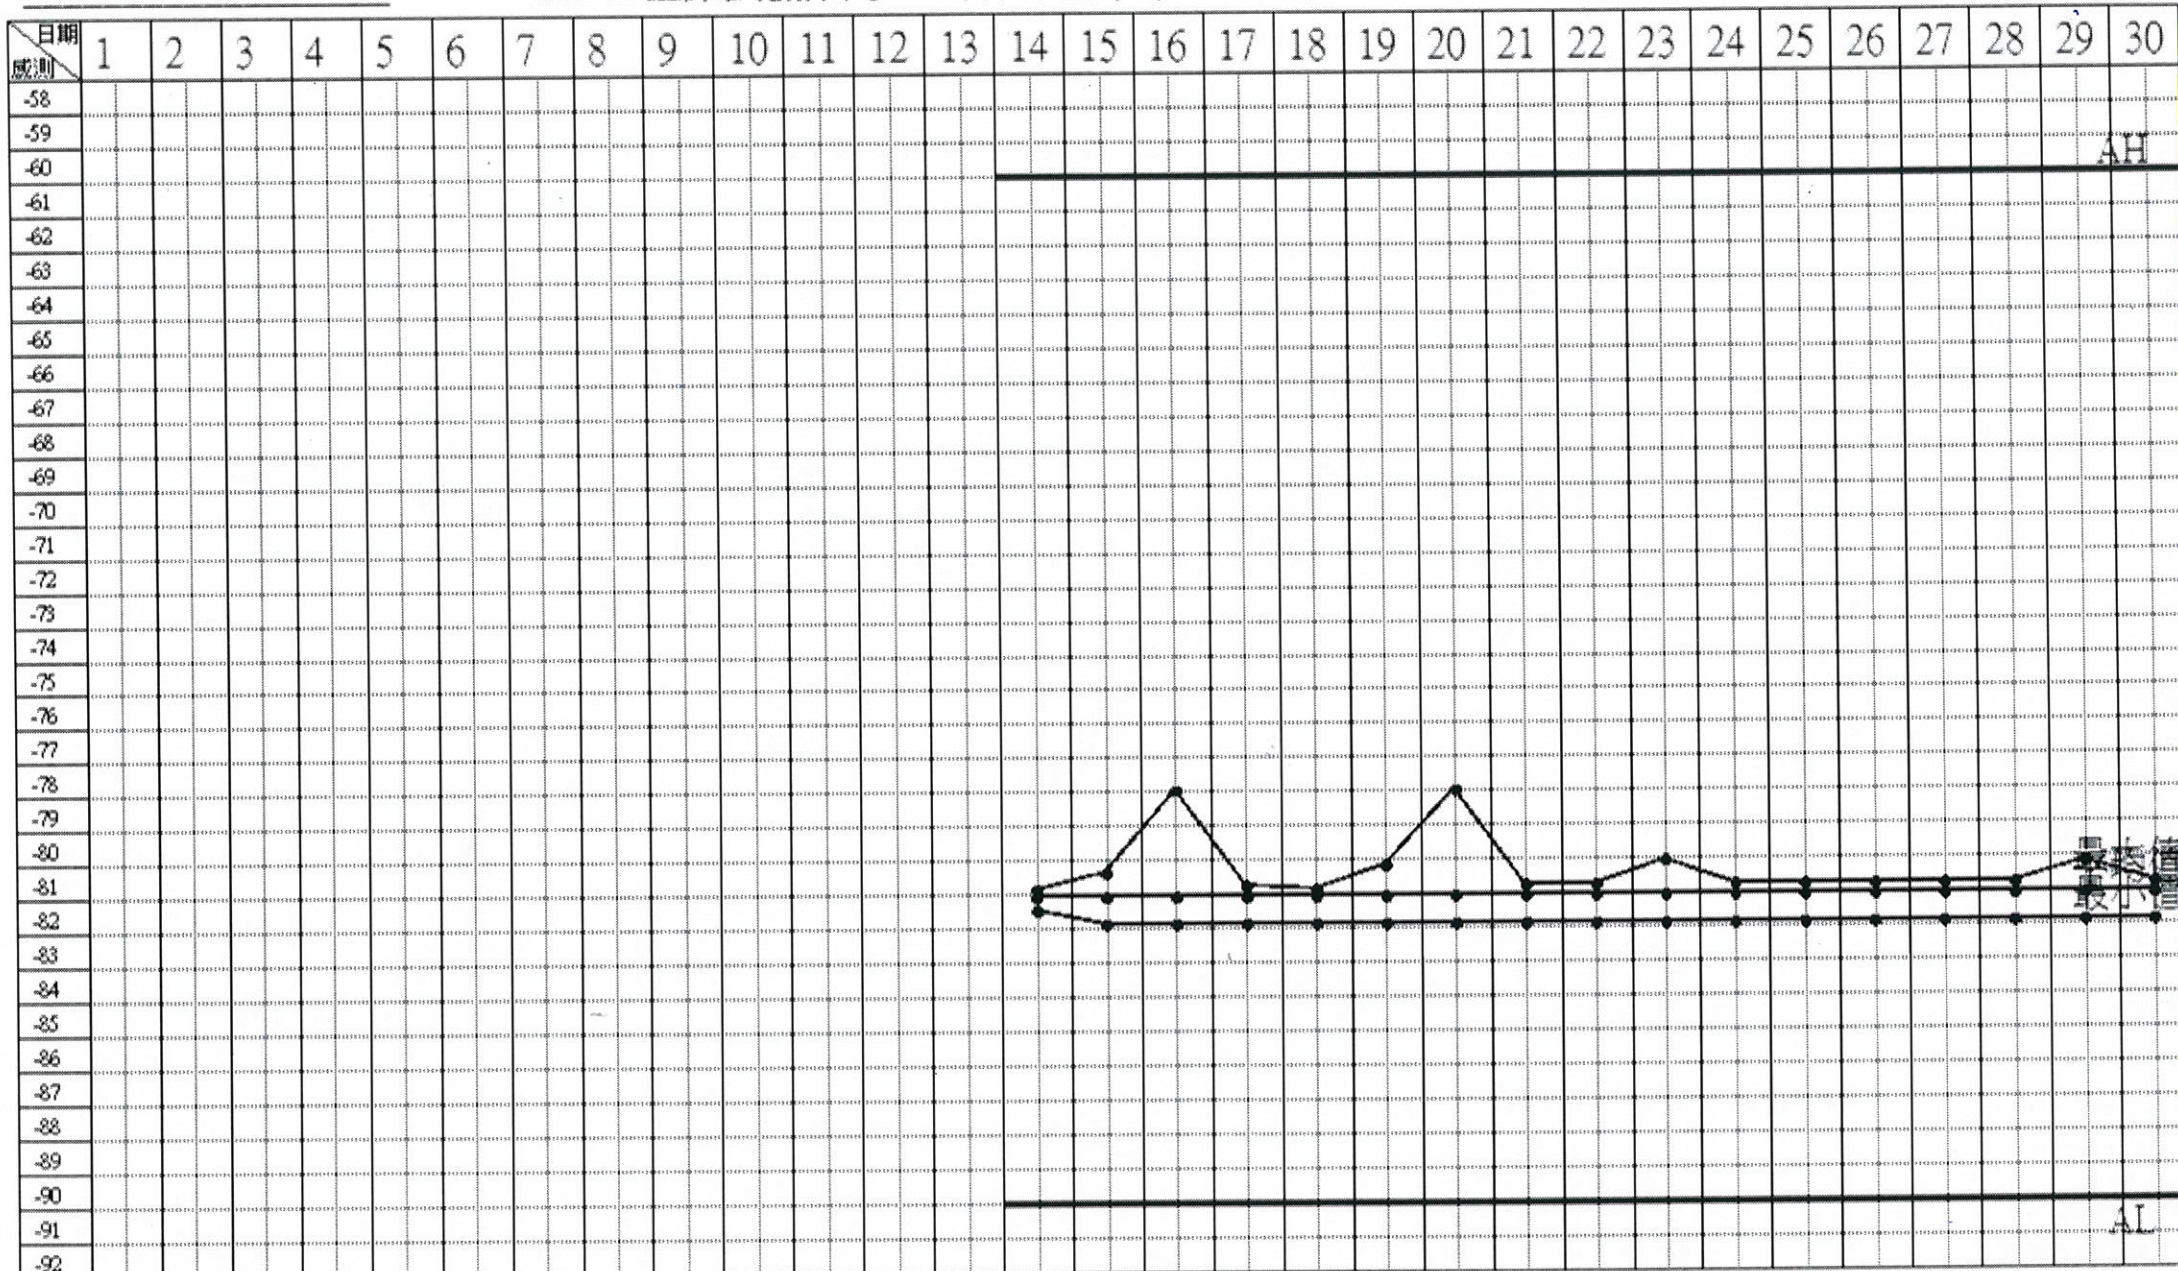

說明
 1. 感測單位：
 2. 黑點：運作正常,白點：異常警報,灰點：超出顯示範圍

備註
 2021/04/14 安裝-80°C冰箱。

單位主管: 

製表者: 