


607-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(上) 溫度紀錄表

月份: 2021/8

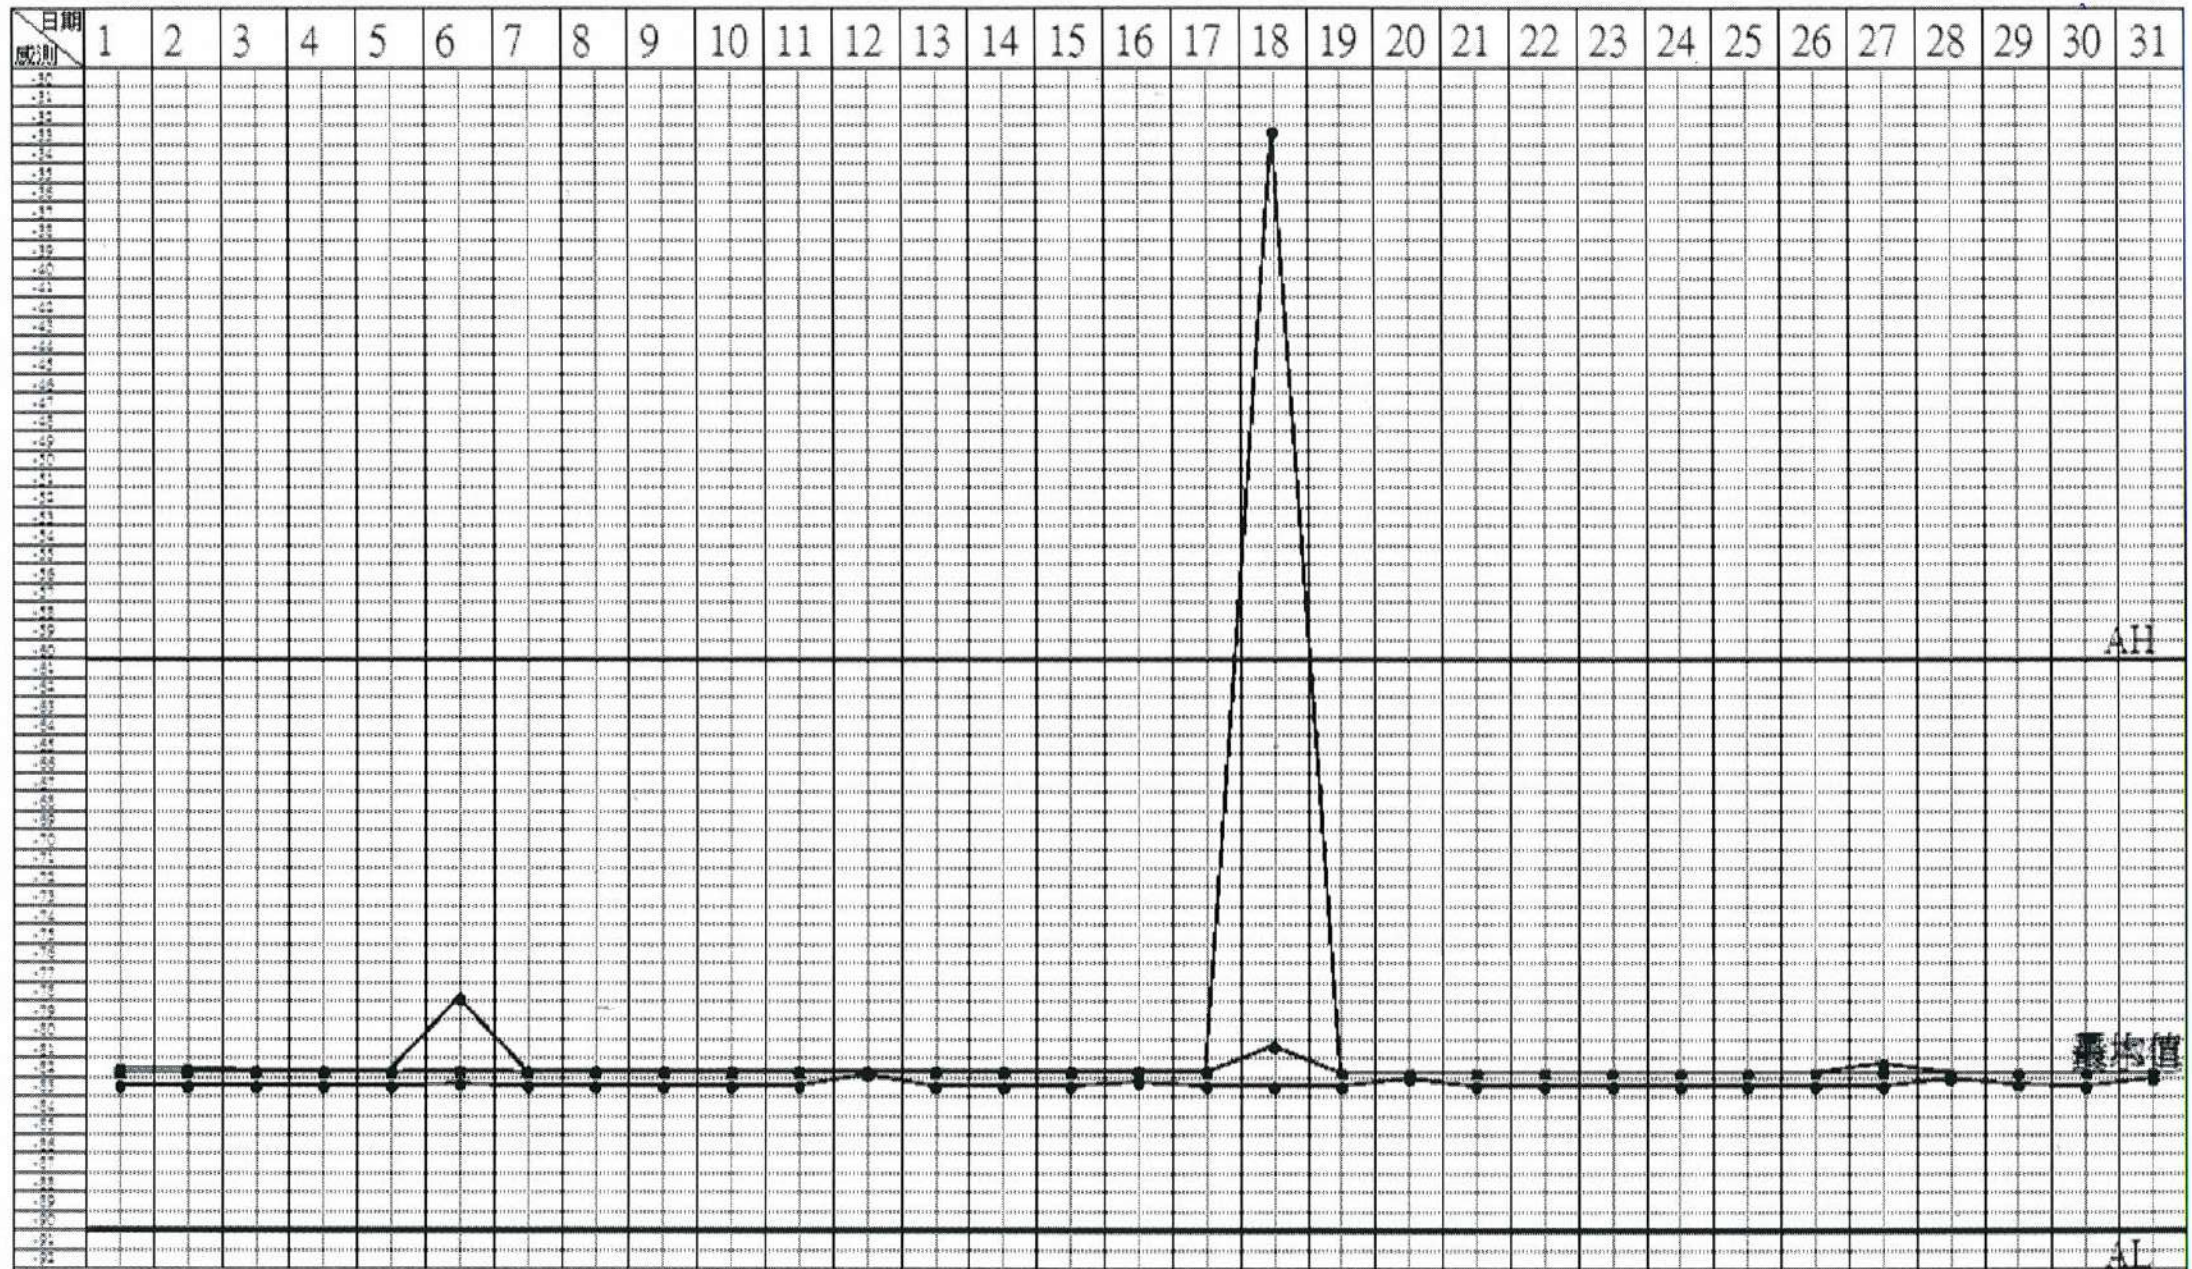

說明  
 1. 感測單位:  
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍


備註  
 2021/8/18 廠商裝設新的冰箱警報感應器





曲線顏色說明 感測器 1 AH AL

607-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(上)

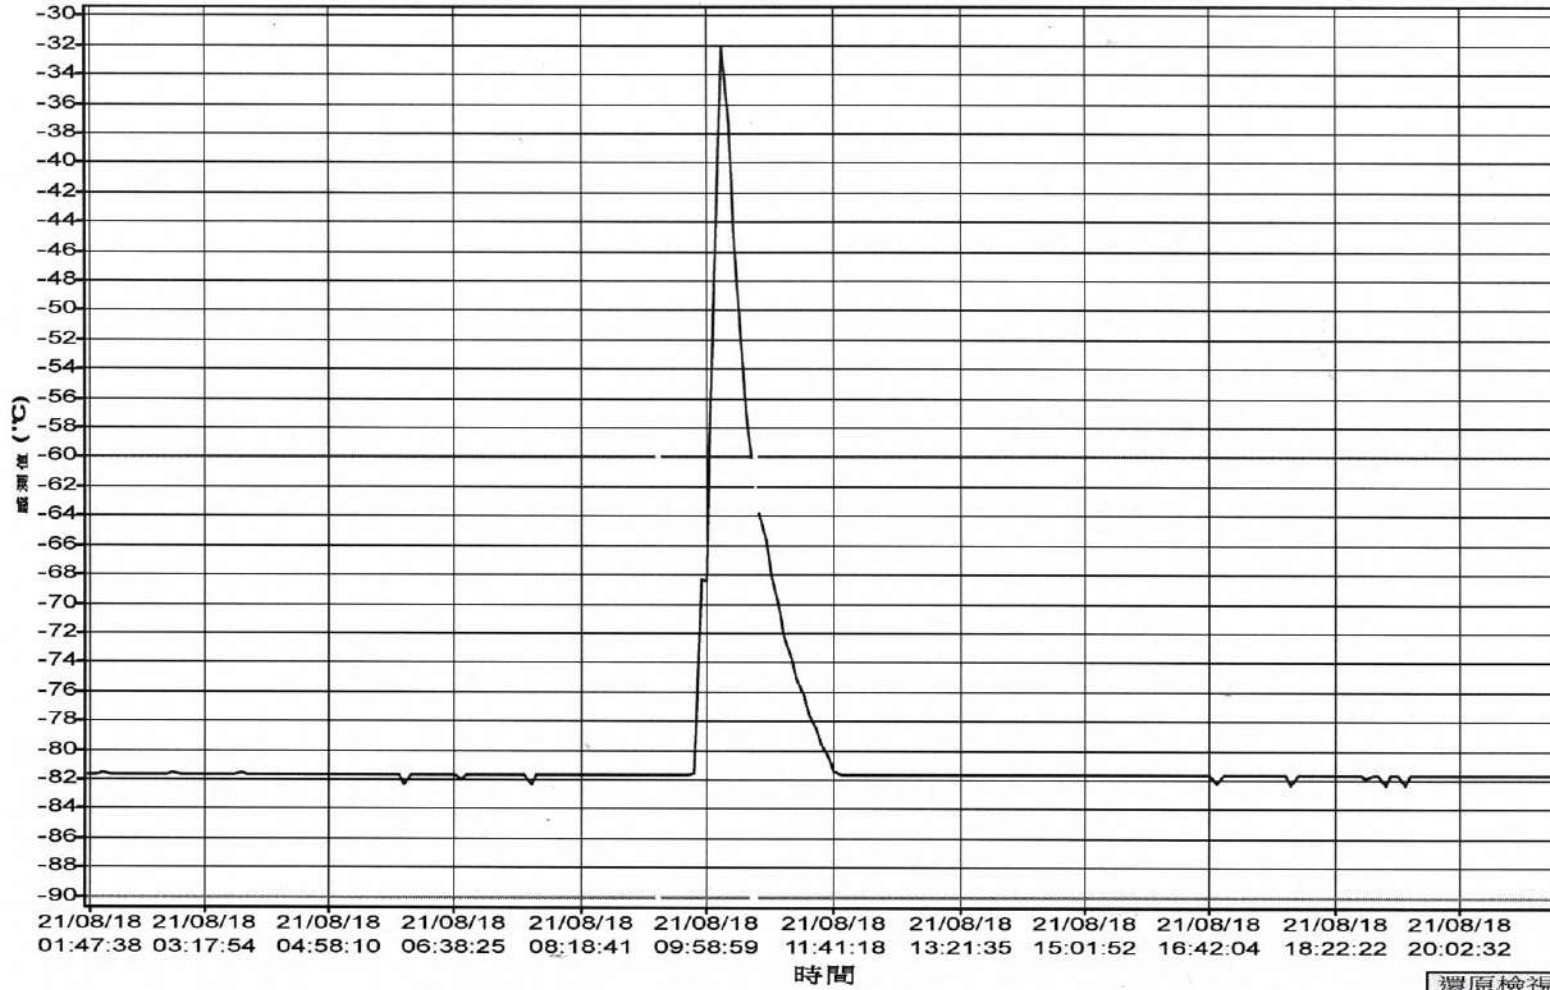

備註  
無

藥師王平宇  
藥師王平宇

藥師  
邱彥榕  
4033085