


608-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/5

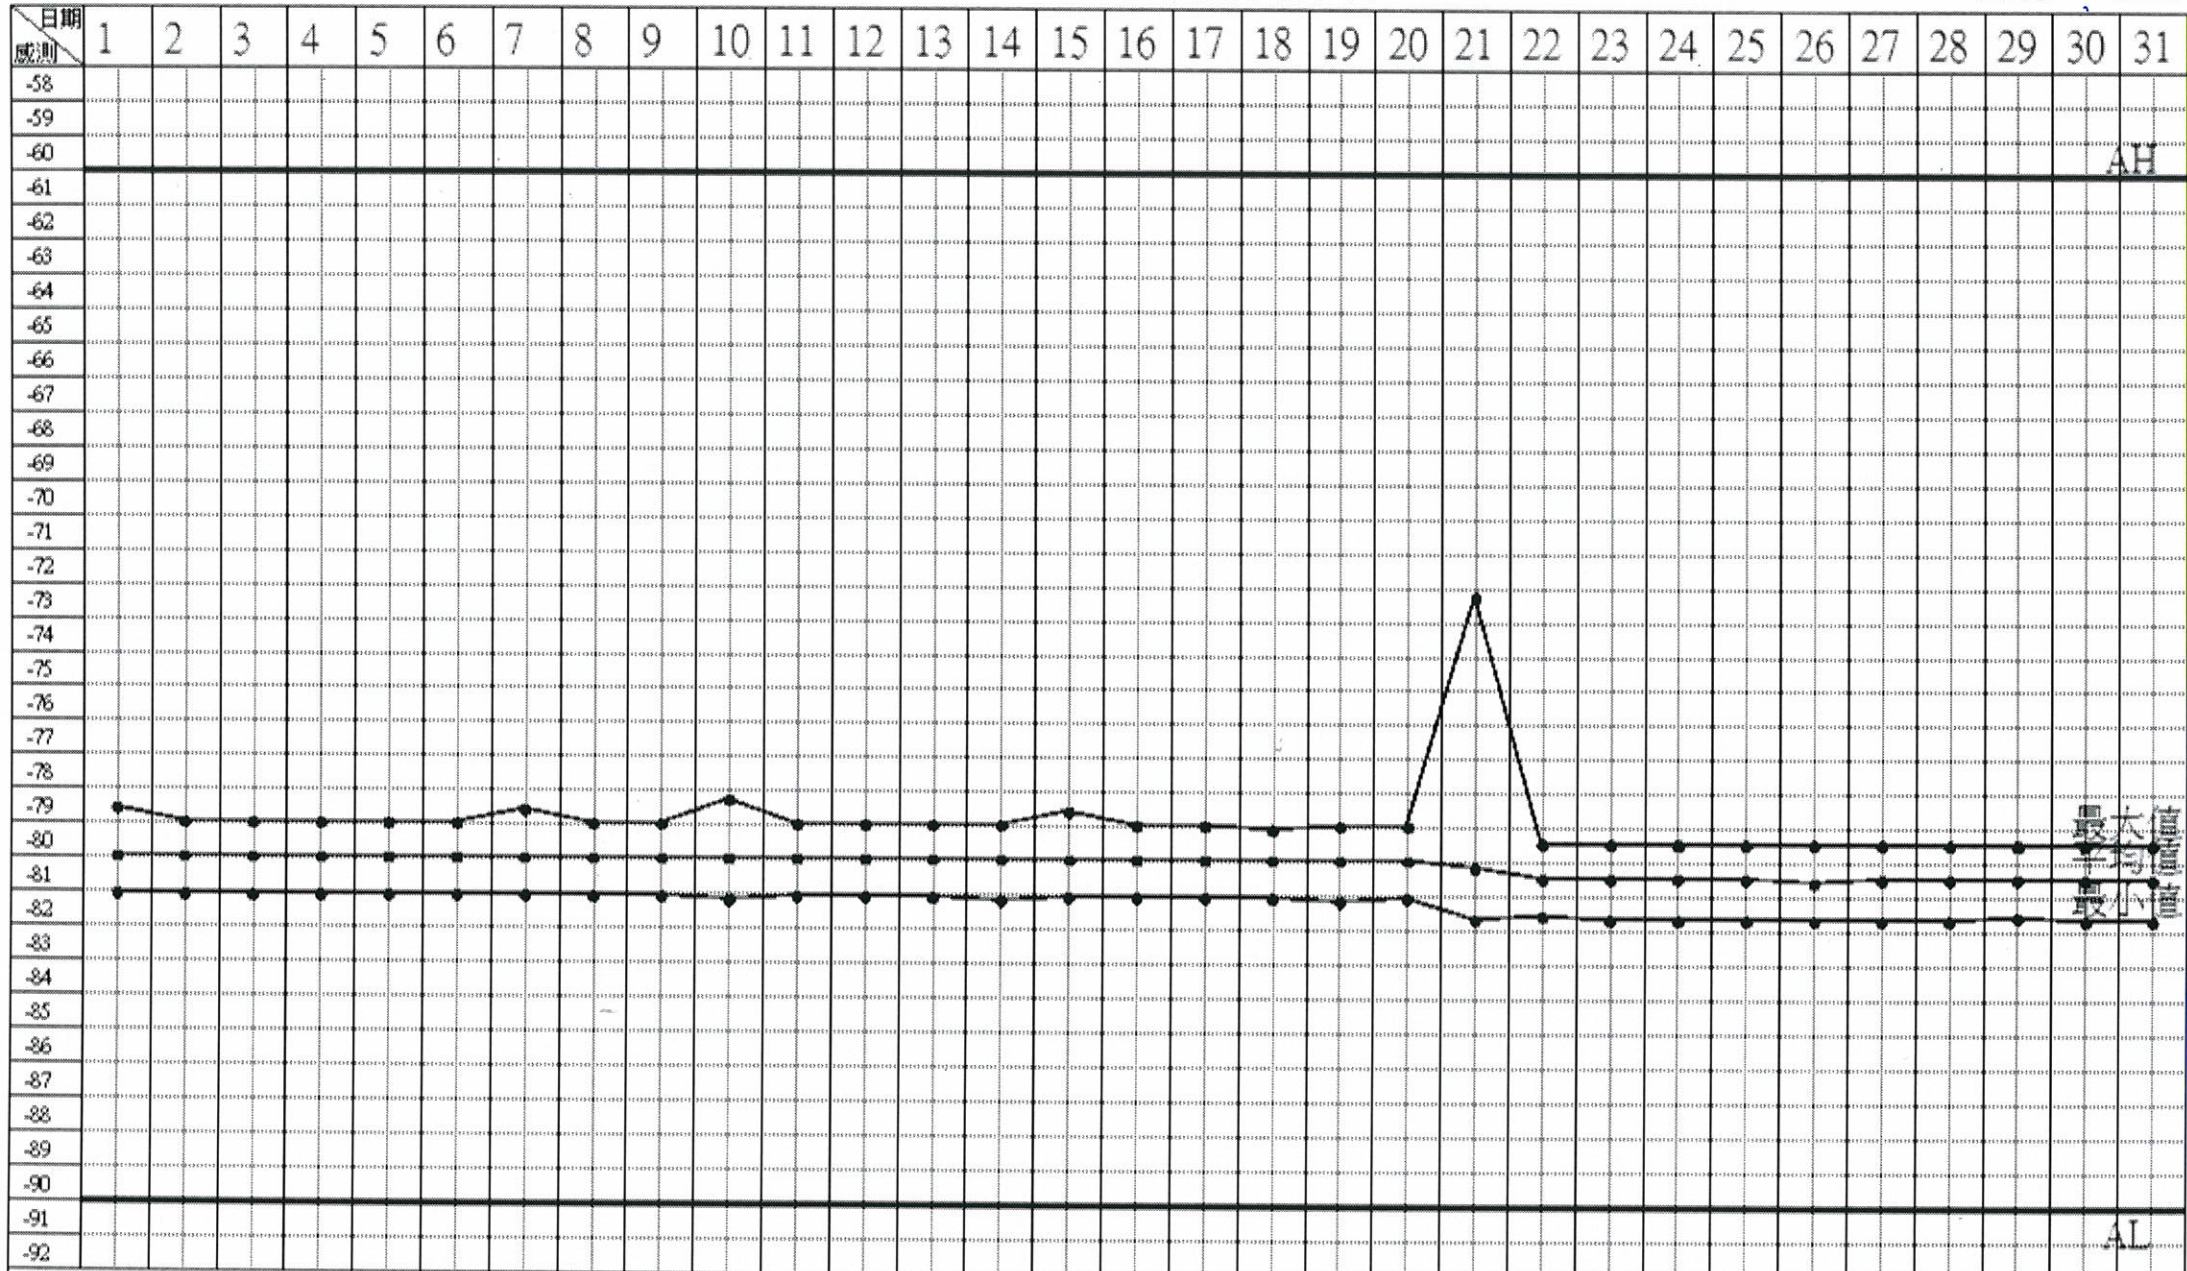

說明  
 1. 感測單位：  
 2. 黑點：運作正常, 白點：異常警報, 灰點：超出顯示範圍

備註  
 2021/05/21進行冰箱校正及測試。