

608-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/8




說明
 1. 感測單位：
 2. 黑點：運作正常, 白點：異常警報, 灰點：超出顯示範圍

備註
 2021/8/18 廠商裝設新的冰箱警報感應器

曲線顏色說明 感測器 1 AH AL

608-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(下)

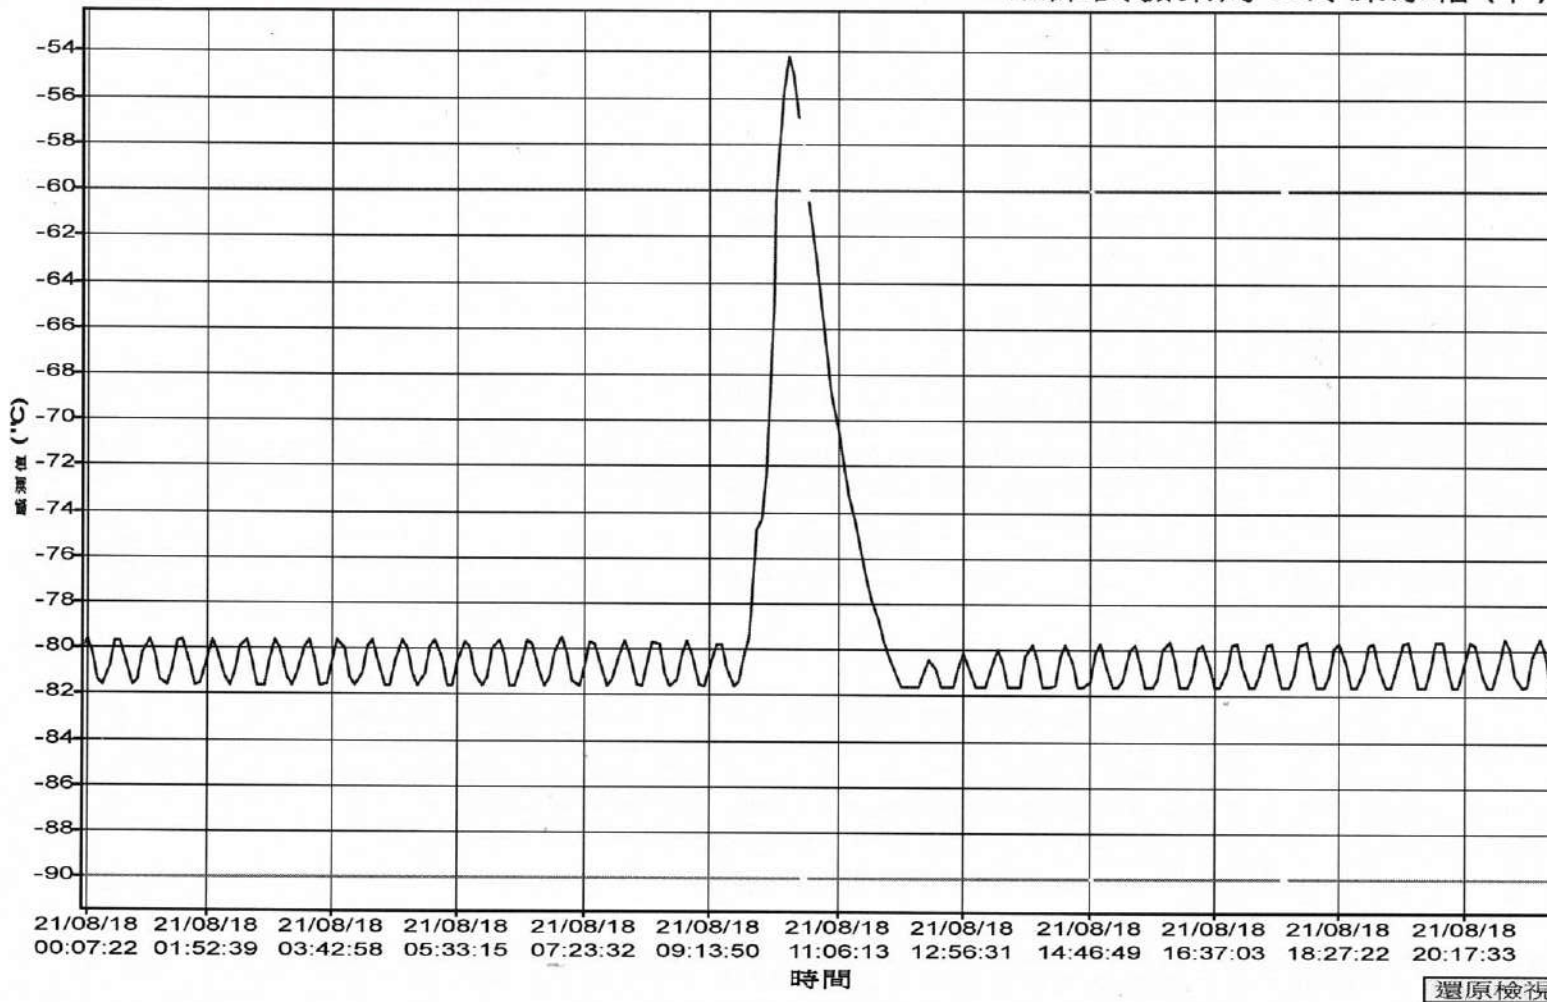

還原檢視



備註
無

