



608-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(下)溫度紀錄表

月份: 2021/12

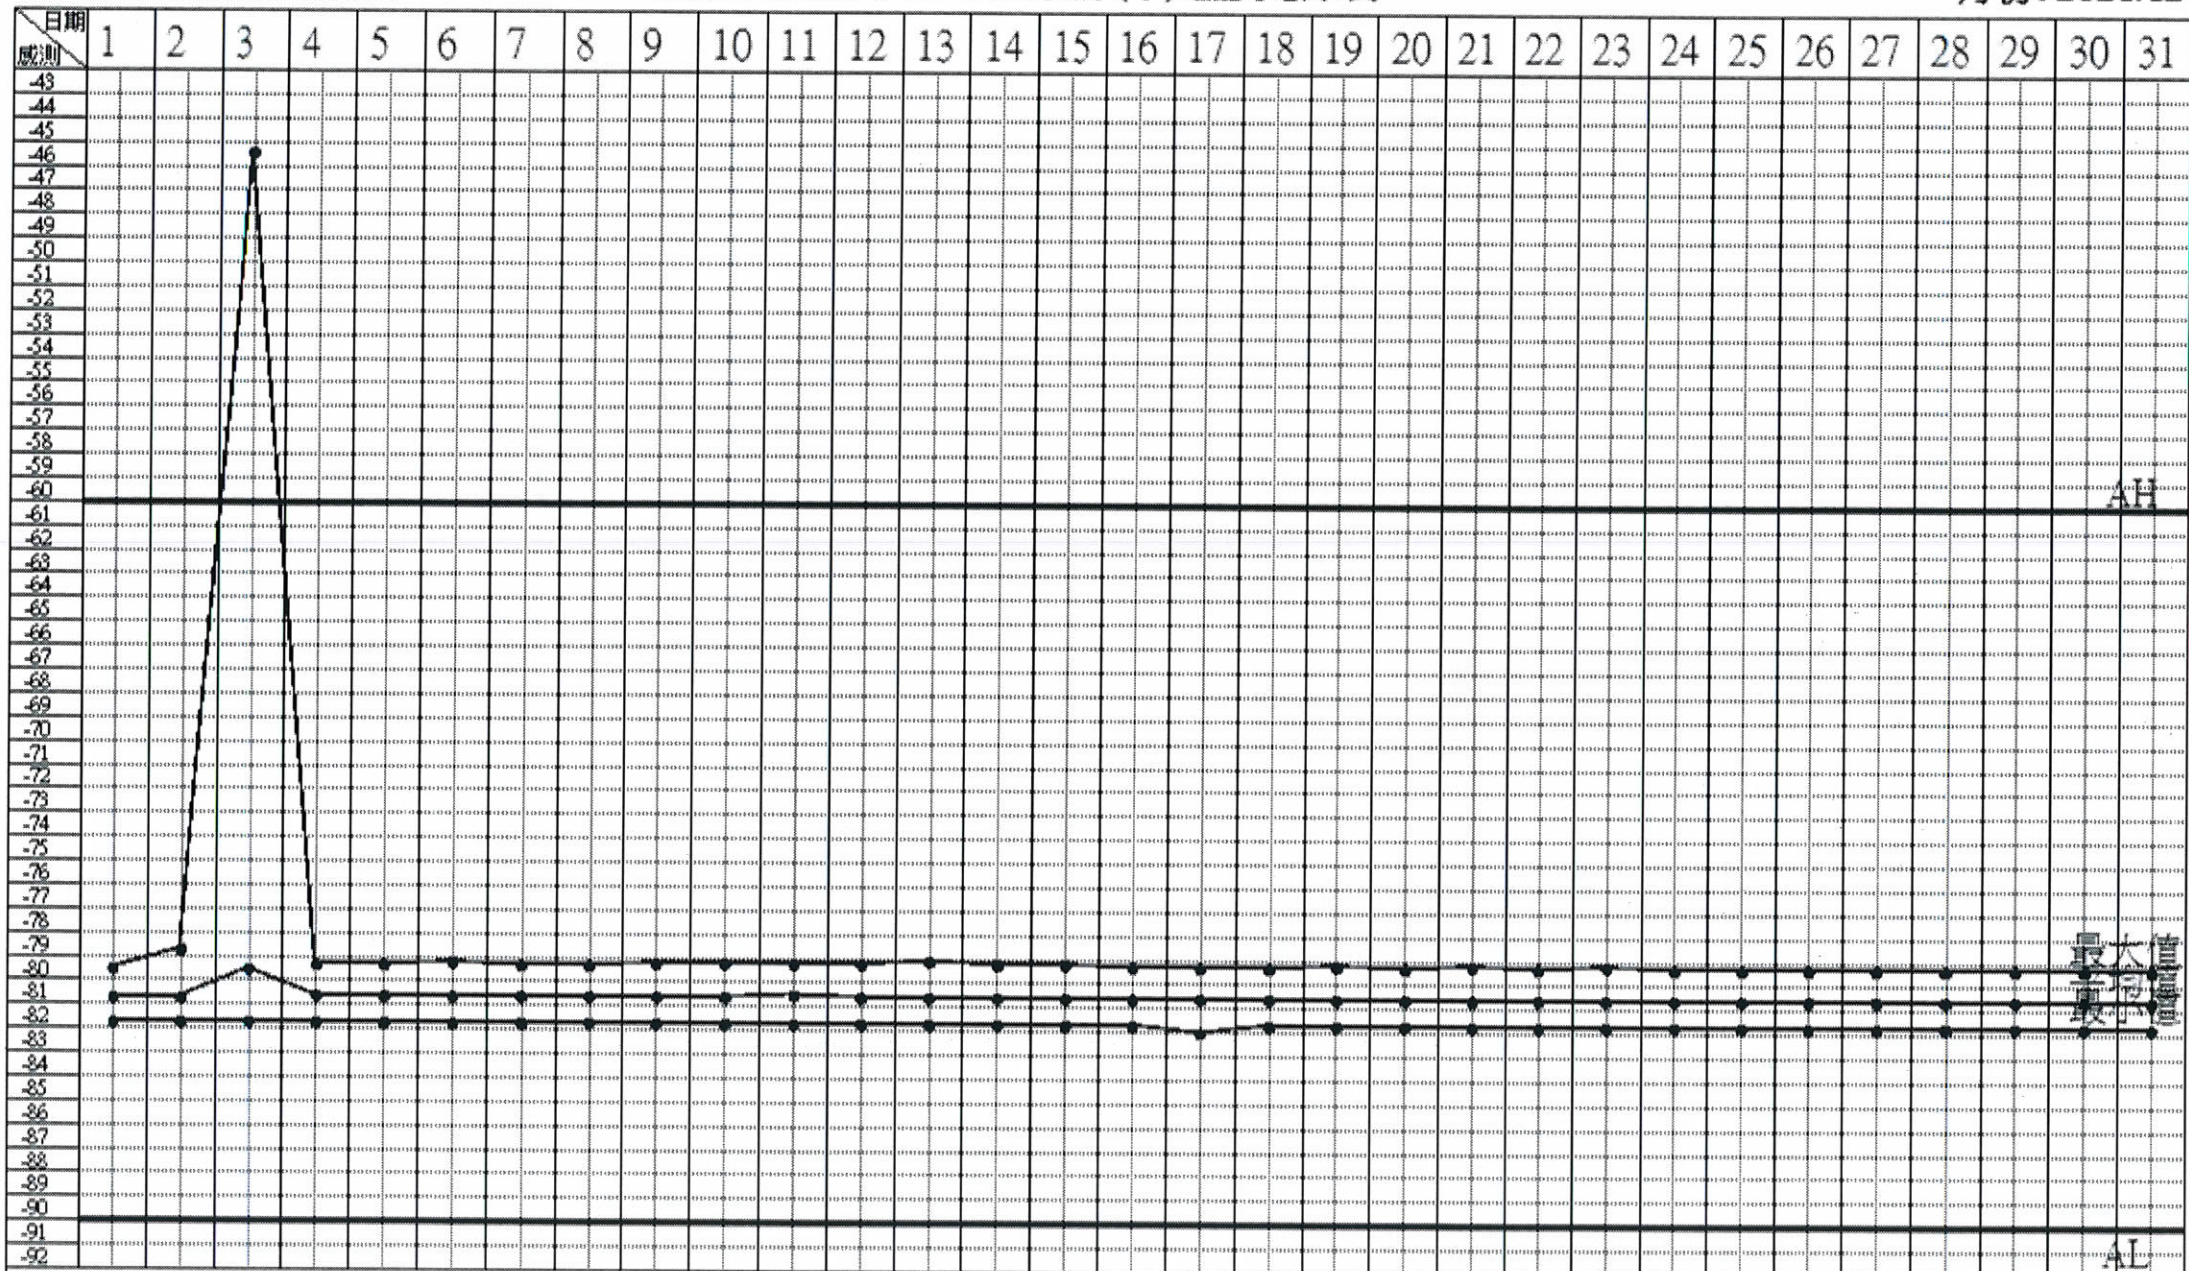

說明
 1. 感測單位：
 2. 黑點：運作正常,白點：異常警報,灰點：超出顯示範圍

備註
 12/3除霜，櫃內未放置任何藥品。

單位主管： 

製表者： 