

# 監控點圖表


監控點: 606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)

時間區間: 2023-09-01 00:00 ~ 2023-09-30 23:59

最大值: 6.1 °C

最小值: 4.5 °C

平均值: 5.1 °C

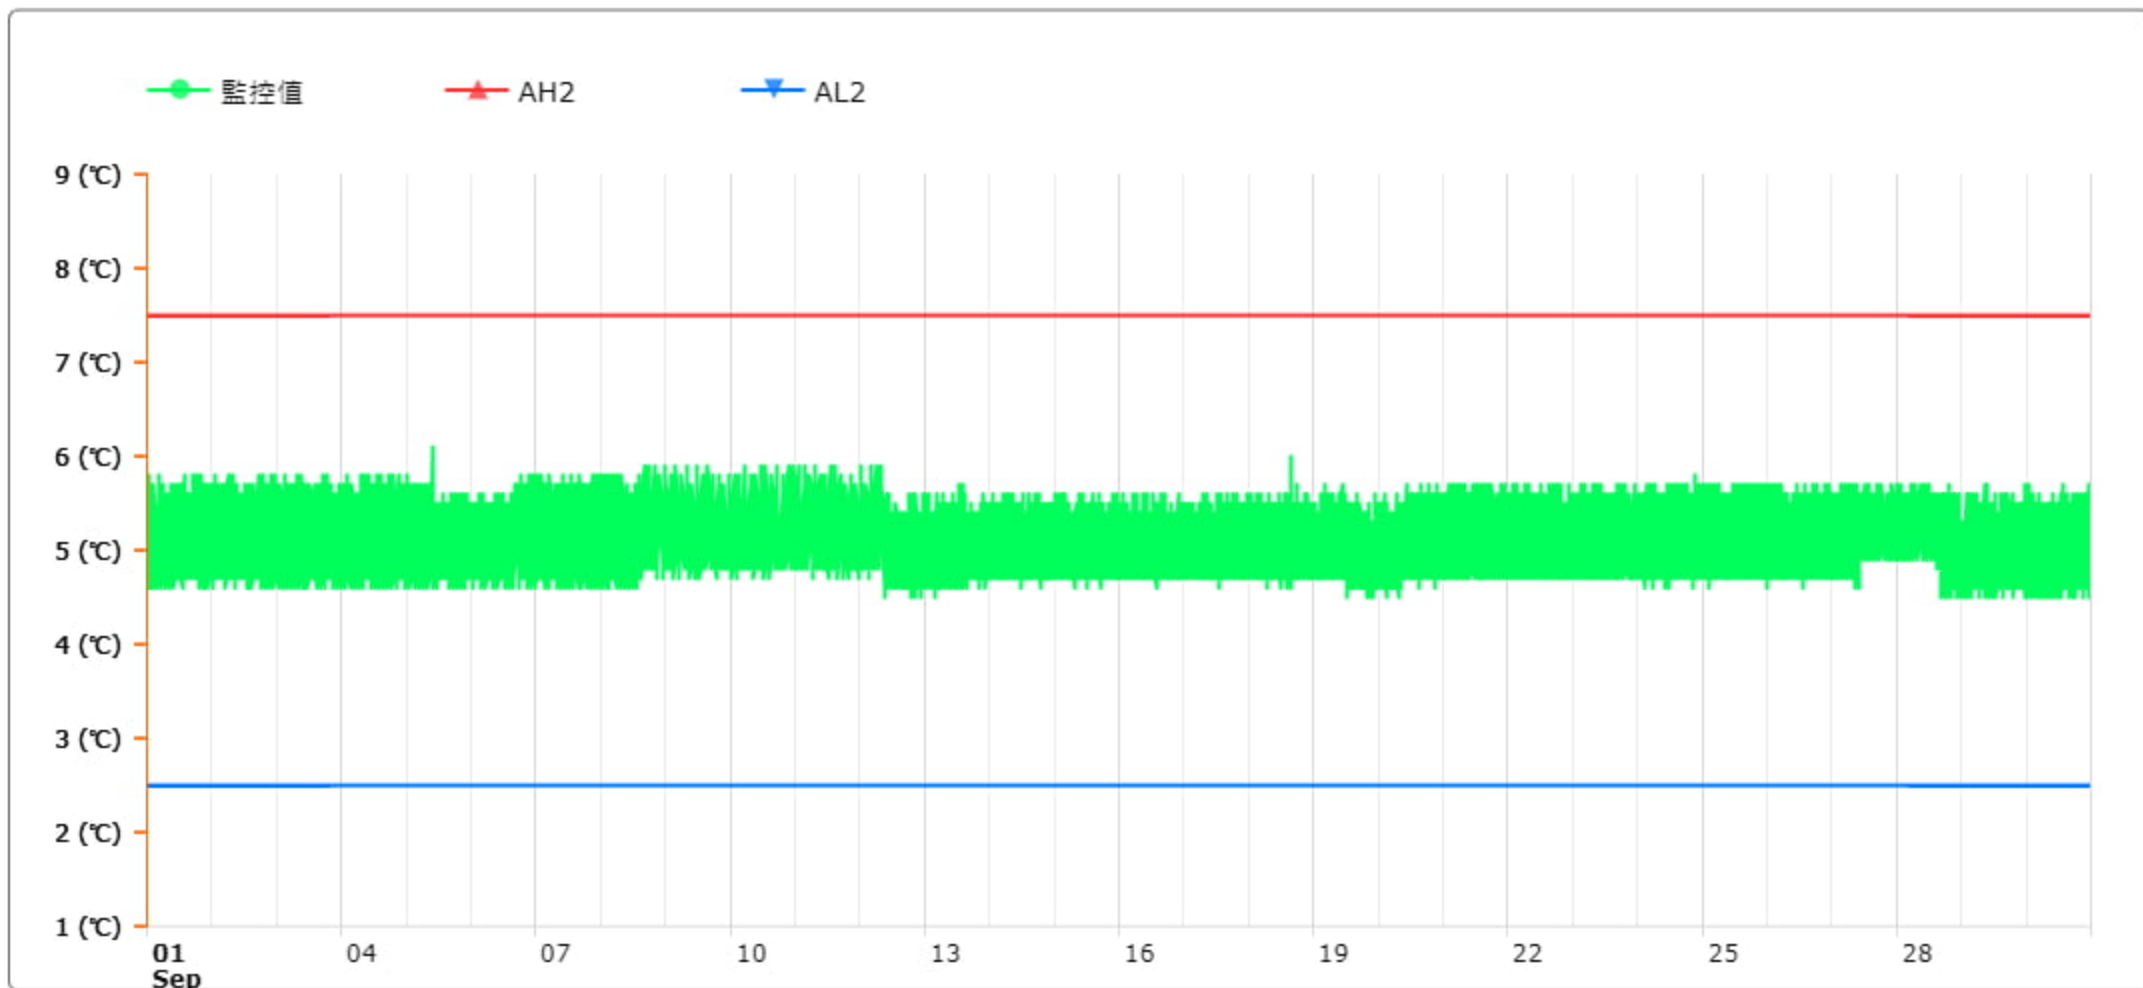

製表者: 王平宇

單位主管: