

監控點圖表


監控點: 622-IF臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2025-12-01 00:00:00 ~ 2025-12-31 23:59:59

最大值: 64.6 %RH

最小值: 44.1 %RH

平均值: 51.9 %RH

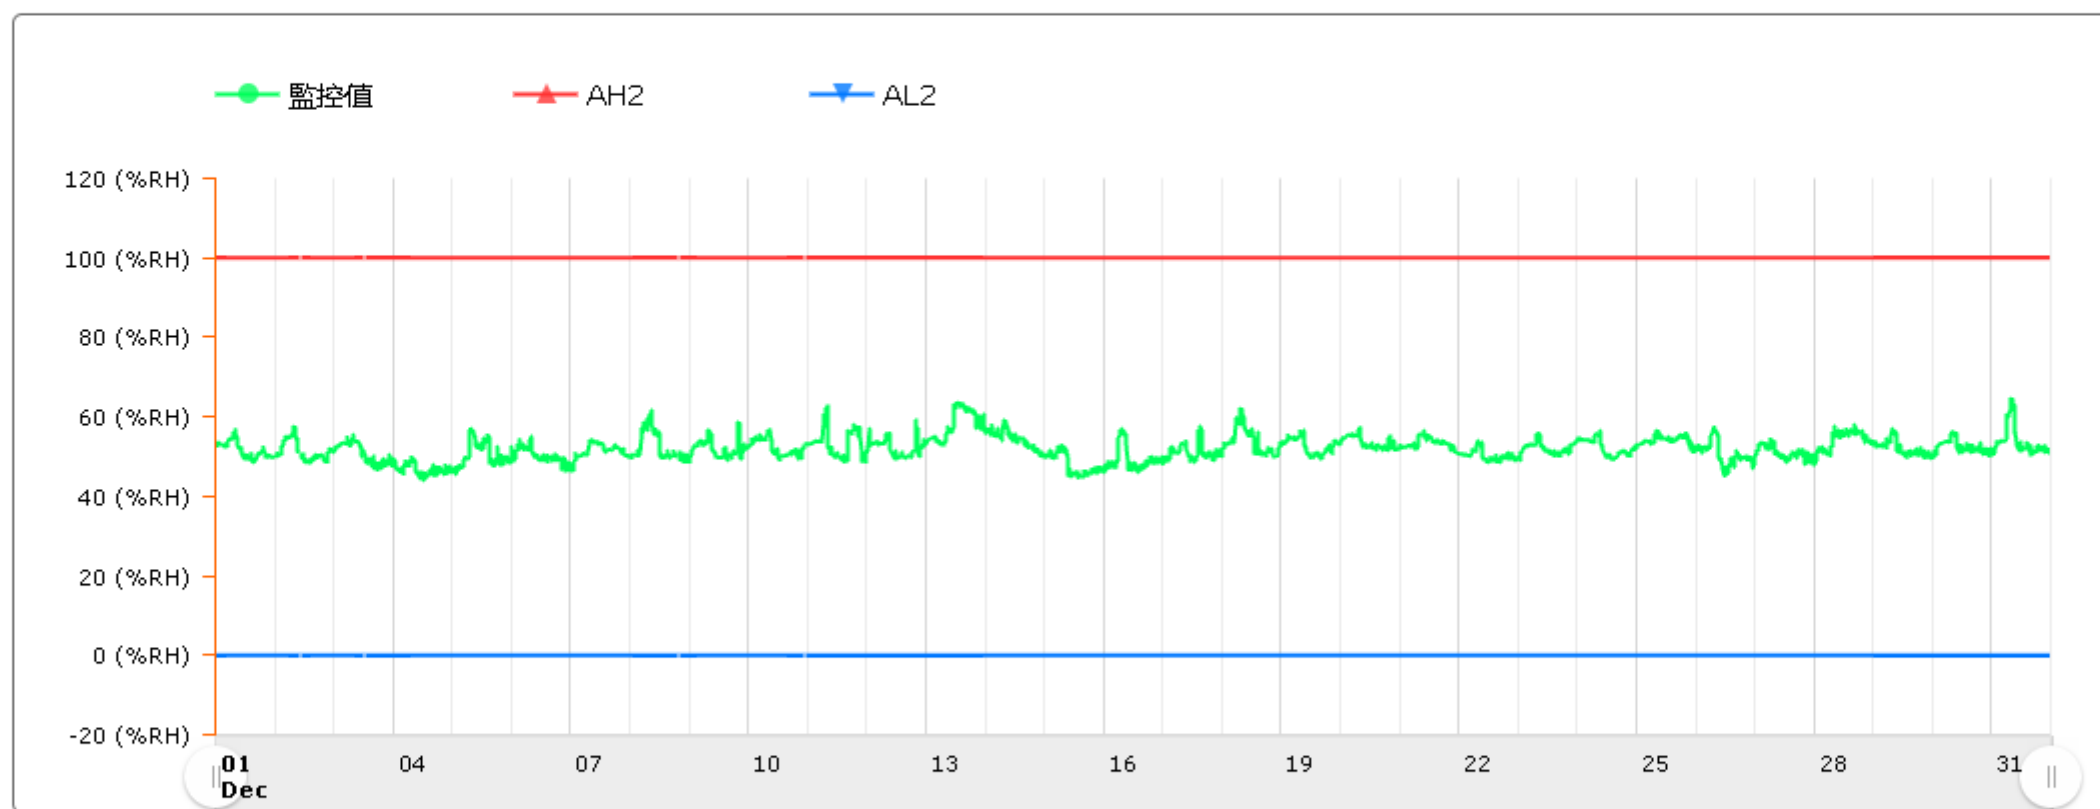

製表者:

單位主管: