

監控點圖表


監控點: 622-IF臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-01-01 00:00:00 ~ 2026-01-31 23:59:59

最大值: 63.9 %RH

最小值: 41.9 %RH

平均值: 51.3 %RH

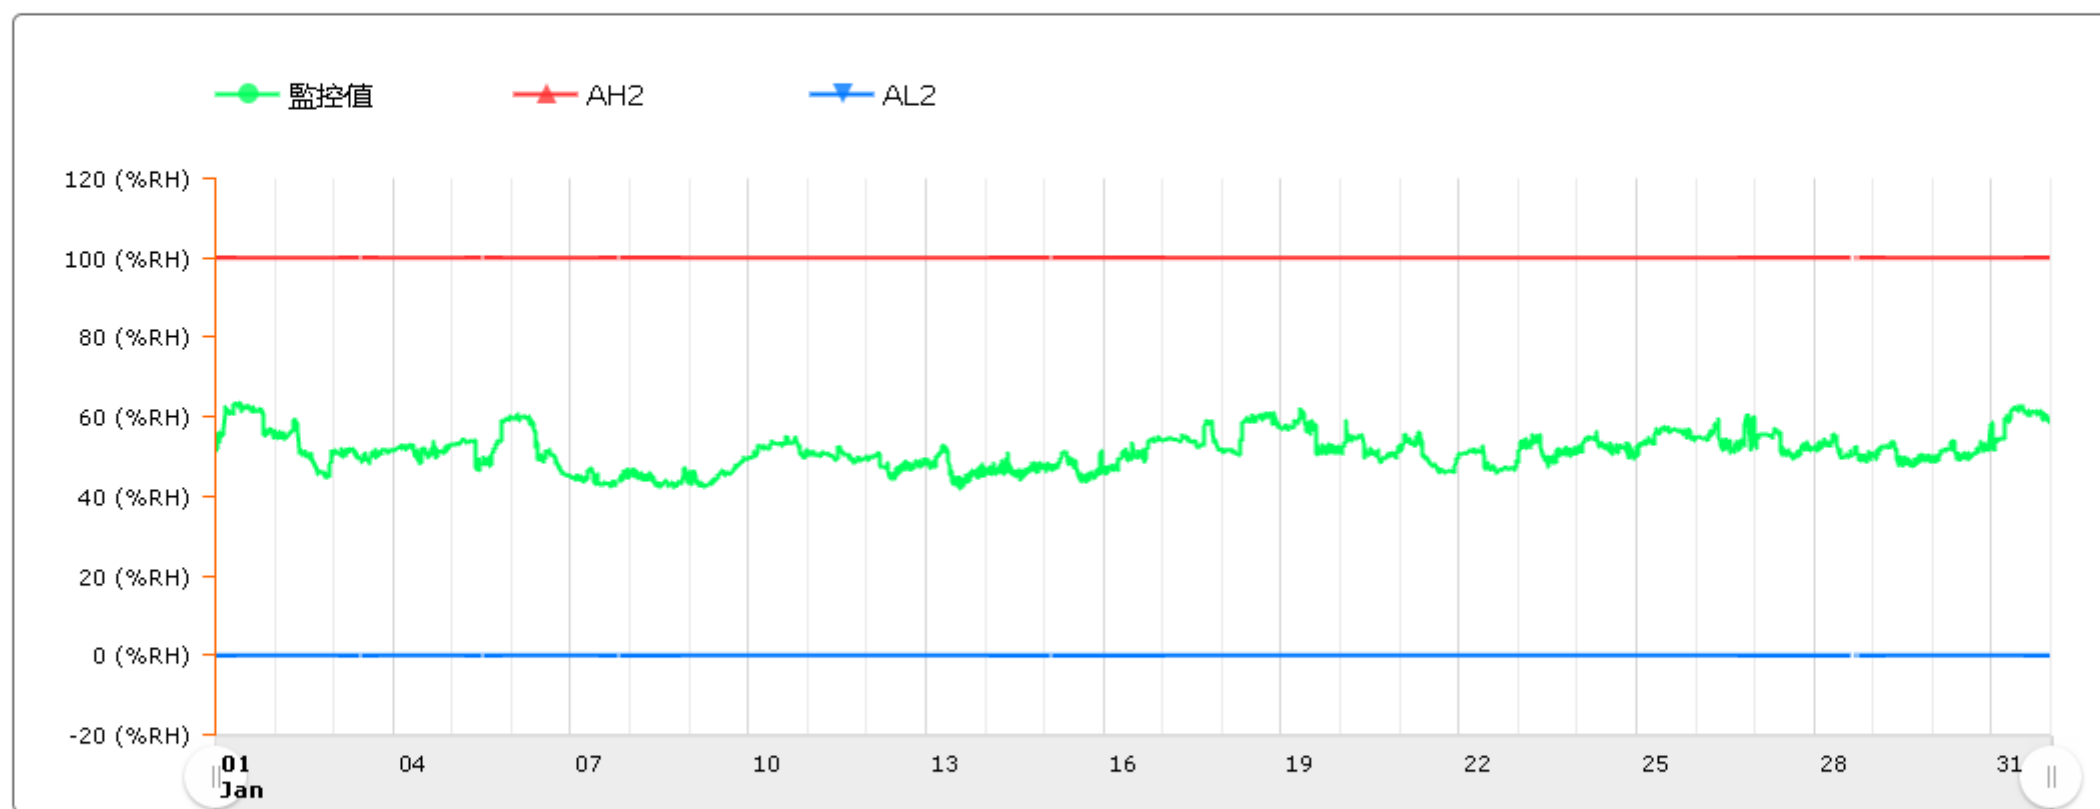

製表者:

單位主管: