

監控點圖表


監控點: 622-IF臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-04-01 00:00:00 ~ 2026-04-30 23:59:59

最大值: 76.6 %RH

最小值: 50.2 %RH

平均值: 58.9 %RH

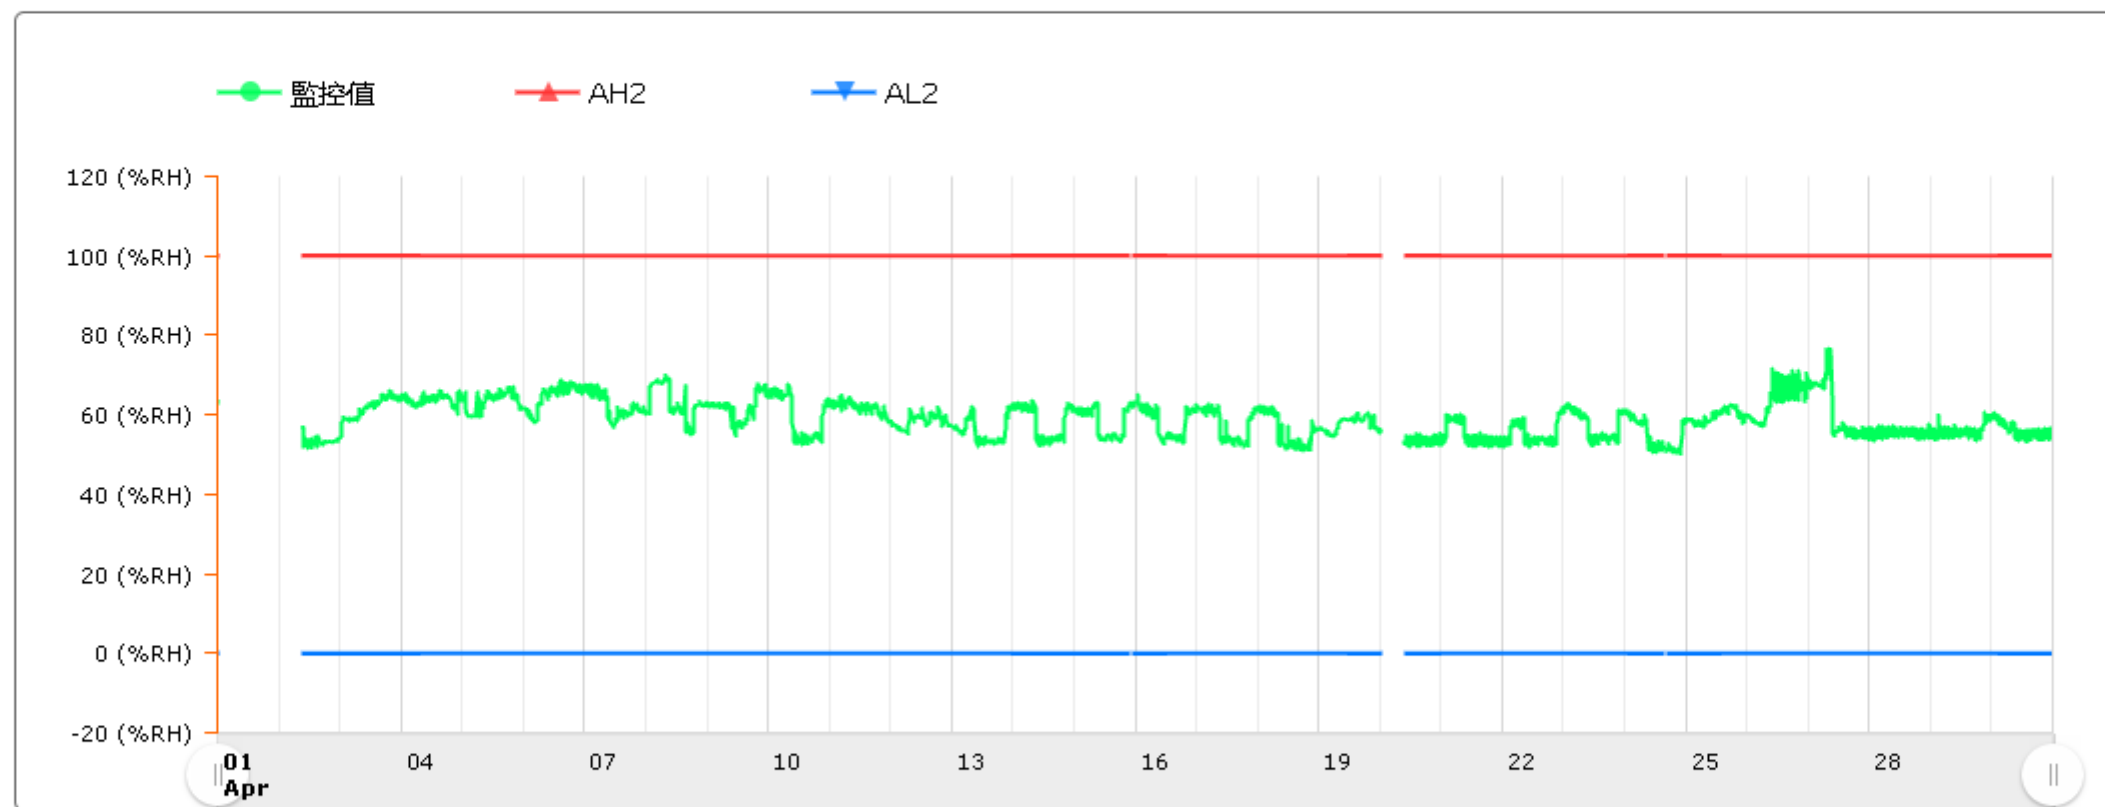

製表者:

單位主管: